

Neu ab:

2024-08




CEREC SW 5

Softwareversion 5.3.x

Handbuch für den Anwender

Deutsch

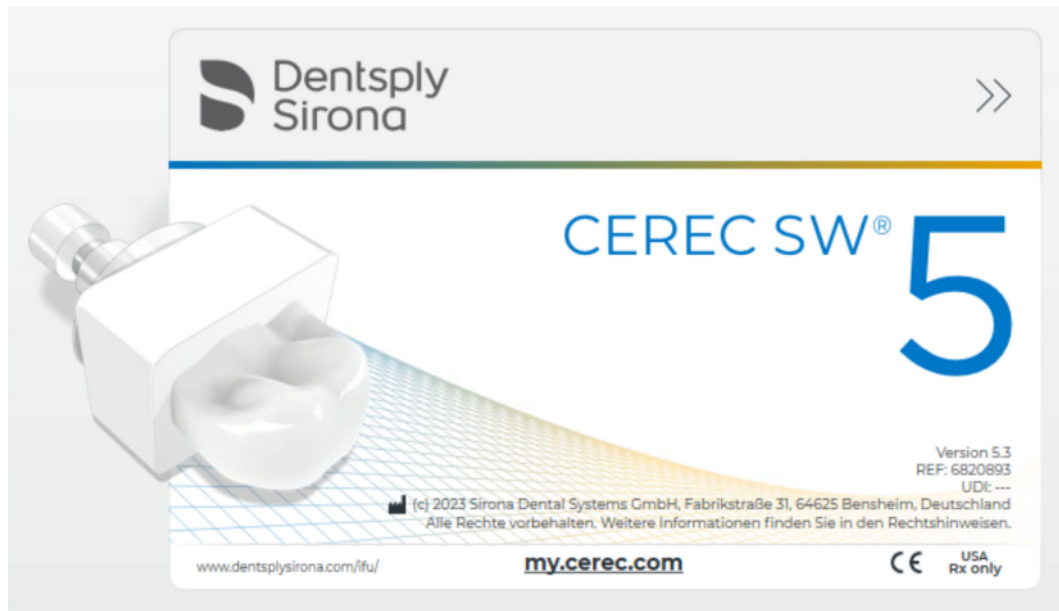

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	9
1.1	Sehr geehrte CEREC-Anwenderin, sehr geehrter CEREC-Anwender	9
1.2	Kontaktdaten	9
1.3	Copyright und Warenzeichen	10
1.4	Allgemeine Hinweise zum Handbuch für den Anwender	10
2	Allgemeine Angaben	11
2.1	Zertifizierung	11
2.2	Allgemeine Sicherheitshinweise	11
2.2.1	Bestimmungsgemäßer Gebrauch, Indikationen und Kontraindikationen	13
2.2.1.1	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	13
2.2.1.2	Indikationen	13
2.2.1.3	Kontraindikationen	13
2.3	Cybersicherheit	13
2.4	Zubehör	14
2.4.1	Zubehör zur Erfassung der Implantatposition	15
2.4.2	Hub	16
2.5	inLab-Apps	16
2.6	Struktur des Handbuches	16
2.6.1	Kennzeichnung der Gefahrenstufen	16
2.6.2	Verwendete Formatierungen und Zeichen	17
2.6.3	Bedienungskonventionen	17
2.6.4	Verwendetes Zahnschema	19
2.7	Die Bedienoberfläche	20
2.7.1	Neuerungen durch die neue Aufnahmeeinheit und die Software CEREC 5.x	21
2.7.1.1	Neues Bildschirmformat	21
2.7.1.2	Neue Bedienmöglichkeiten	21
2.7.1.3	Touchpad	21
2.7.1.4	Trackball	21
2.7.2	Phasenleiste	22
2.7.2.1	ADMINISTRATION	22
2.7.2.2	AUFNAHME	22
2.7.2.3	MODELL	23
2.7.2.4	DESIGN	23
2.7.2.5	HERSTELLUNG	23
2.7.3	Objektleiste	24
2.7.4	Seitenpalette	25
2.7.5	Werkzeug-Rad	26

2.7.6	Schrittmenü	27
2.7.7	Kontextleiste	28
3	Erste Schritte	29
3.1	Software installieren	29
3.1.1	Installation per USB-Stick	29
3.2	Software deinstallieren	30
3.3	Auslieferungszustand herstellen	31
3.4	Kopierschutz.....	31
3.5	Software herunterladen	31
3.6	Software starten	32
4	Designmodus	33
4.1	Allgemeine Informationen zu Biogenerik.....	33
4.2	Biogenerik individuell.....	33
4.3	Kopieren und Spiegeln	34
4.4	Biogenerik-Kopie	34
4.5	Bio-Kiefer.....	35
5	Konfiguration	36
5.1	Parameter.....	36
5.2	Geräte	44
5.2.1	Scanner.....	45
5.2.1.1	Scanner konfigurieren	45
5.2.1.2	Scannereinstellungen zurücksetzen	45
5.2.1.3	Scanner kalibrieren.....	46
5.2.1.4	Farbkalibrierung.....	49
5.2.1.5	Firmware aktualisieren.....	51
5.2.1.6	Einstellungen Scanner-Heizung (Omnica)	52
5.2.2	Fertigungseinheit	52
5.2.2.1	Einstellungen bearbeiten	52
5.2.2.2	Kalibrieren.....	53
5.2.2.3	Instrumente wechseln.....	53
5.2.2.4	Service.....	53
5.2.2.5	Fertigungseinheit entfernen (Gerät löschen)	53
5.2.3	Ofen	53
5.2.3.1	Einstellungen bearbeiten	53
5.3	Einstellungen.....	54
5.3.1	ADA/FDI Zahnschema	54
5.3.2	Benachrichtigungen	54
5.3.3	Sitzposition.....	55
5.3.4	Hub-Einstellungen.....	55
5.3.5	Patientendatenbank	56

5.3.6	Automatisch speichern.....	56
5.3.7	Sprache.....	56
5.3.8	Werkzeugrad.....	56
5.3.9	Handhabung von Blöcken.....	56
5.3.10	Automatischer Vorschlag für Präparationsrand	56
5.3.11	Abstichstelle voreinstellen.....	57
5.3.12	CEREC Primemill-Leistung.....	57
5.3.13	Vereinbarung zur Qualitätsverbesserung	57
5.4	App-Center (Anwendungen).....	57
6	Optionen.....	58
6.1	Artikulation.....	58
6.2	Smile-Design	59
7	Systemmenü	60
7.1	Fall speichern	61
7.2	Fall speichern unter	61
7.3	Fall importieren.....	61
7.4	Fall exportieren.....	62
7.5	Scandaten exportieren	62
7.6	Lizenzmanager.....	62
7.7	Konfiguration	62
7.8	Fenstermodus	63
7.9	Aktuelle Programmversion	63
7.10	Programm beenden.....	63
8	Startansicht	64
8.1	Neuen Patienten anlegen.....	65
8.2	Patienten suchen.....	66
8.3	Patientendaten bearbeiten	66
8.3.1	Patientenkarte bearbeiten.....	66
8.3.2	Patienten entfernen.....	66
8.3.3	Fall entfernen	67
8.3.4	Fall öffnen	67
8.3.5	Neuen Fall hinzufügen	67
8.4	Restorationstypen und Designmodus	68
8.4.1	Restorationstypen	68
8.4.2	Designmodus	71
9	Werkzeuge und Funktionen der Seitenpalette	72
9.1	Werkzeuge	72
9.1.1	Werkzeug-Rad	73
9.1.2	Bukkale Registrierung.....	74

9.1.3	Bukkale Bisswerkzeuge	75
9.1.4	Formen.....	75
9.1.4.1	Eigenschaften	76
9.1.5	Modellbereiche wegschneiden.....	77
9.1.6	Defekte korrigieren.....	78
9.1.7	Modell zurücksetzen	78
9.1.8	Trimmen.....	79
9.1.9	Präparationsrand zeichnen	80
9.1.10	Basislinie auf Gingiva eingeben	80
9.1.11	Gingivamaske verwenden.....	80
9.1.12	Positionieren und Rotieren.....	81
9.1.13	Restaurationen neu berechnen.....	82
9.1.14	Gestalten.....	83
9.1.14.1	Eigenschaften	83
9.1.15	Biogenerische Variation	84
9.1.16	Reduzieren.....	85
9.1.16.1	Komplett reduzieren.....	85
9.1.16.2	Teilweise Reduzieren	85
9.1.16.3	Eigenschaften	86
9.1.17	Kontakte anpassen	86
9.1.18	Abstichstelle anpassen	86
9.1.19	Block verschieben	87
9.1.20	Inzisale Variation.....	87
9.1.21	Teilen	88
9.1.22	Verbinder anpassen.....	88
9.1.23	Modell bereinigen.....	89
9.1.24	Modellhöhe festlegen.....	90
9.1.25	Modell ausstechen	90
9.1.26	Beschriftung	90
9.2	Objekte anzeigen	91
9.3	Analysewerkzeuge	93
9.4	Falldetails	97
10	Phase ADMINISTRATION	98
10.1	Indikationen	98
10.2	Smile-Design.....	102
10.2.1	Referenzbild laden	102
10.2.2	Referenzpunkte setzen	103
10.2.3	Abstand der Canthi anpassen.....	103
10.2.4	Kiefer ausrichten	103
10.2.5	Hilfsebenen	104
10.3	Artikulation.....	105

11	Phase AUFNAHME	107
11.1	Bildkataloge	107
11.2	3D-Vorschau	108
11.3	Aufnahme durchführen	108
11.3.1	Modus	108
11.3.2	CEREC Omnicam, Omnicam	109
11.3.2.1	Aufwärmzeit des Scanners	109
11.3.2.2	Scannerführung	110
11.3.2.3	Mit dem Scanner aufnehmen	116
11.3.3	CEREC Primescan, Primescan	118
11.3.3.1	Mit dem Scanner aufnehmen	118
11.3.3.2	Scannerführung	121
11.3.4	Modellbereiche wegschneiden	128
11.3.5	Nachträgliche Aufnahmen	128
11.3.6	Primescan™ 2	129
12	Phase MODELL	130
12.1	Modell bearbeiten	130
12.2	Bukkale Registrierung (optional)	130
12.3	Modellachse festlegen (optional)	133
12.4	Präparationsrand eingeben	135
12.5	Einschubachse oder Restaurationsachse festlegen (optional)	137
12.5.1	Die richtige Einschubachse vorbereiten	137
12.5.2	Einschubsachse neu definieren	138
12.5.3	Einschubachse für das Gingivaelement einstellen	139
12.5.4	Präparationsanalyse	139
12.6	Restaurationsachse bei Implantat-Abutment	140
12.7	Modell anzeigen	140
12.8	Phase abschließen	140
13	Phase DESIGN	141
13.1	Restaurationsparameter (optional)	141
13.2	Schritt Morphologie (optional)	141
13.3	Schritt Positionieren (optional)	142
13.4	Restauration bearbeiten	143
13.5	Arbeitsmodell, Abdrucklöffel und Schiene	143
13.6	Phase abschließen	143
14	Phase HERSTELLUNG	144
14.1	Farbe auswählen	144
14.1.1	CEREC SpeedFire	144
14.1.2	CEREC Blocs C In	144

14.2	Seitenpalette Herstellung/Export.....	145
14.2.1	Manuelles Firmware-Update.....	145
14.2.2	Bearbeitungseinstellungen ändern	145
14.2.2.1	Schleifen – Herstellungsoptionen	145
14.2.2.2	Fräsen – Herstellungsoptionen.....	146
14.2.2.3	Veneer-Modus.....	147
14.2.3	Restauration exportieren.....	148
14.3	Seitenpalette Blockgrößenwahl.....	148
14.4	Restauration im Block positionieren.....	149
14.5	Fertigungsprozess starten.....	149
14.6	Herstellungsprozess mit Primeprint.....	149
15	Konstruktionsbeispiele	150
15.1	Abutment mit Krone - Biogenerik Individuell	150
15.1.1	Neue Restauration anlegen	150
15.1.2	Präparation aufnehmen	151
15.1.3	Modell bearbeiten (optional)	151
15.1.4	Bissregistrierung (optional)	151
15.1.5	Modellachse festlegen (optional)	151
15.1.6	Bereiche ausblenden (optional)	152
15.1.7	Scanbody auswählen.....	152
15.1.8	Basislinie bearbeiten.....	153
15.1.9	Restaurationsachse definieren	153
15.1.10	Parameter anpassen.....	154
15.1.11	Restauration bearbeiten.....	154
15.1.12	Restaurationen herstellen	155
15.2	Verschraubte Krone - Biogenerik Individuell	156
15.2.1	Neue Restauration anlegen	156
15.2.2	Präparation aufnehmen	157
15.2.3	Modell bearbeiten (optional)	157
15.2.4	Bissregistrierung (optional)	157
15.2.5	Modellachse festlegen (optional)	157
15.2.6	Bereiche ausblenden (optional)	158
15.2.7	Scanbody auswählen.....	158
15.2.8	Basislinie bearbeiten.....	159
15.2.9	Restaurationsachse definieren	159
15.2.10	Parameter anpassen.....	159
15.2.11	Restauration bearbeiten.....	160
15.2.12	Restauration schleifen	160
16	Tastenkürzel.....	161

17	Portal Connect Case Center	164
17.1	Portal Connect Case Center starten	164
17.2	Registrierung und Funktionen des Portals Connect Case Center.....	164
17.3	Modell an das Portal Connect Case Center senden	165
17.4	Aus der Connect-Software am Portal anmelden	165
17.5	Restaurationsinformationen überprüfen	165
17.6	Bestelldaten eingeben.....	166
17.7	Zusätzliche Informationen hinzufügen.....	166
17.8	Warenkorb.....	166
17.9	Auftragsliste.....	167
18	Herstellung eines CEREC Guide 2	168
18.1	Optische Abformung.....	168
18.1.1	ADMINISTRATION	168
18.1.2	AUFNAHME	168
18.1.3	DESIGN	168
18.2	3D-Röntgen und Implantatplanung	169
18.3	Design und Ausarbeitung des CEREC Guide 2	171
18.3.1	Phase DESIGN	171
18.3.2	Phase HERSTELLUNG	172
18.4	Hinweise zur Anwendung.....	173
19	Herstellung eines CEREC Guide 3	174
19.1	Optische Abformung.....	174
19.1.1	ADMINISTRATION	174
19.1.2	AUFNAHME	174
19.1.3	DESIGN	174
19.2	3D-Röntgen und Implantatplanung	175
19.3	Design und Ausarbeitung des CEREC Guide 3	179
19.3.1	Phase DESIGN	179
19.3.2	Phase HERSTELLUNG	180
19.3.3	Nachbearbeitung.....	180
19.4	Hülsen einkleben.....	181
19.5	Hinweise zur Lagerung.....	181
	Stichwortverzeichnis.....	182

1 Einführung

1.1 Sehr geehrte CEREC-Anwenderin, sehr geehrter CEREC-Anwender

Wir bedanken uns für den Kauf Ihrer Software CEREC SW 5 aus dem Hause Dentsply Sirona.

Diese Software ermöglicht Ihnen in Verbindung mit der CEREC-Aufnahmeeinheit und einer Fertigungseinheit die computerunterstützte Herstellung von dentalen Restaurationen, z.B. aus natürlich wirkendem Keramikmaterial.

Unsachgemäßer Umgang und nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch können Gefahren und Schäden hervorrufen. Deshalb bitten wir Sie, dieses Handbuch sowie die entsprechende Gebrauchsanweisung durchzulesen und genau zu befolgen. Bewahren Sie sie immer griffbereit auf.

Zur Vermeidung von Personen- und Sachschäden beachten Sie dabei auch die Sicherheitshinweise in diesem Dokument, auf den Geräten, sowie innerhalb der Software.

Ihr
CEREC SW 5 – Team

1.2 Kontaktdaten

Dentsply Sirona Produktservice

Registrieren Sie sich, um Ihre Geräte anzumelden und Serviceanfragen zu stellen:

<https://dentsplysirona.service-pacemaker.com/>

Herstelleranschrift



SIRONA Dental Systems GmbH
Fabrikstraße 31
64625 Bensheim
Deutschland

Tel.: +49 (0) 6251/16-0
Fax: +49 (0) 6251/16-2591
E-Mail: contact@dentsplysirona.com
www.dentsplysirona.com

Repräsentant Schweiz



Maillefer Instruments Holding Sàrl
Chemin du verger 3
CH-1338 Ballaigues

Repräsentant Großbritannien / Nordirland



Dentsply IH Limited, Building 3.The Heights,
Brookland's, Surrey,
Weybridge,KT13 ONY
England, UK

1.3 Copyright und Warenzeichen

Copyright © Sirona Dental Systems GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen können ohne besondere Ankündigungen geändert werden.

Die Software, einschließlich der zugehörigen Dokumentation, ist urheberrechtlich geschützt. Sie ist daher von Ihnen wie jedes andere geschützte Material zu behandeln.

Wer diese Software außer zum Zweck des eigenen Gebrauchs auf jegliches Medium ohne die schriftliche Genehmigung der Sirona Dental Systems GmbH überträgt, macht sich strafbar.

1.4 Allgemeine Hinweise zum Handbuch für den Anwender

Bewahren Sie das Handbuch für den Anwender stets griffbereit auf, falls Sie oder ein anderer Benutzer Information zu einem späteren Zeitpunkt benötigen. Drucken Sie das Handbuch aus oder merken Sie sich, wo es auf dem Gerät oder online gespeichert ist.

Vergewissern Sie sich im Falle eines Verkaufs, dass dem Gerät das Handbuch in Papierform oder als elektronischer Datenträger beiliegt, damit sich der neue Besitzer über die Funktionsweise und die aufgeführten Warn- und Sicherheitshinweise informieren kann.

Online-Portal für Technische Unterlagen

Wir haben für Technische Unterlagen ein Online-Portal unter www.dentsplysirona.com/manuals eingerichtet. Dort können Sie das Handbuch sowie weitere Dokumente herunterladen. Sollten Sie ein Dokument in Papierform wünschen, so bitten wir Sie, das Webformular auszufüllen. Wir schicken Ihnen dann gerne kostenlos ein gedrucktes Exemplar zu.

Hilfe Sollten Sie trotz sorgfältigem Studium des Handbuchs noch weiter Hilfe benötigen, setzen Sie sich mit dem für Sie zuständigen Händler in Verbindung.

2 Allgemeine Angaben

Lesen Sie dieses Dokument vollständig durch und befolgen Sie es genau. Bewahren Sie es immer griffbereit auf.

Ursprungssprache dieses Dokuments: Deutsch

2.1 Zertifizierung

CE-Kennzeichnung



Dieses Produkt trägt das CE-Kennzeichen in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Richtlinie 93/42/EWG des Rates vom 14. Juni 1993 über Medizinprodukte.

2.2 Allgemeine Sicherheitshinweise

Datenzugriffe einschränken

Um Datenzugriffe einzuschränken, richten Sie entsprechend Ihrer Praxisgegebenheiten eine Benutzerverwaltung ein. Hierzu können Sie auf die Funktionalitäten des Betriebssystems Microsoft Windows 10 zurückgreifen. Anleitungen und Support finden Sie unter support.microsoft.com / "Erstellen eines lokalen Benutzer- oder Administratorkontos in Windows 10".

Nur Originalsoftware verwenden

Verwenden Sie ausschließlich Originalsoftware oder von Dentsply Sirona freigegebene Software. Zur Herstellung von Restaurationen und Apparaturen dürfen keine manipulierten oder nicht freigegebenen Softwarekomponenten verwendet werden.


Es dürfen keine Software und Softwarekomponenten unter Verwendung falscher Angaben installiert werden.


Prüfen Sie, ob für jede installierte Komponente die Zulassung für ihr Land besteht. Fragen Sie dazu Ihren Händler.

Installierte Softwareversion überprüfen

Welche Version installiert ist, können Sie im laufenden Betrieb überprüfen.

1. Tippen oder klicken Sie in der Phasenleiste auf den Schriftzug "CEREC".
2. Tippen oder klicken Sie auf den Doppelpfeil (A) des geöffneten Fensters.
3. Das erweiterte Fenster zeigt alle relevanten Informationen der Software CEREC SW 5 an.

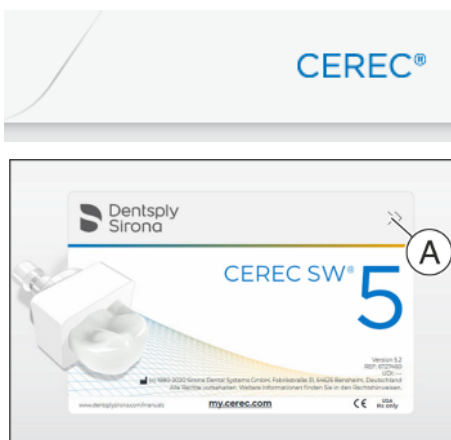

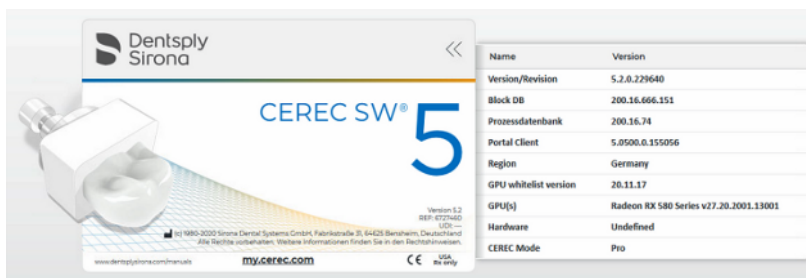

Restauration durch geschultes Personal überprüfen

Jede mit der vorliegenden Software erstellte Restauration muss von einer geschulten Person (z. B. Zahntechniker oder Zahnarzt) auf Eignung überprüft werden.

Angaben der Materialhersteller beachten

Beachten Sie die Verarbeitungshinweise und Kombinationsmöglichkeiten der Material-/Implantat-Hersteller, die in Ihrem Land gelten.

Nur für USA

VORSICHT: Laut Bundesgesetz der USA darf dieses Produkt nur an Ärzte, Zahnärzte oder lizenzierte Fachleute bzw. in deren Auftrag verkauft werden.

2.2.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch, Indikationen und Kontraindikationen

2.2.1.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Software CEREC SW 5 dient der Erstellung optischer Abdrücke von bezahnten, teilweise oder komplett unbezahnten Kiefersituationen. Anhand der optischen Abdrücke werden in der CEREC SW 5 digitale Modelle der Kiefersituationen erstellt. Mithilfe der CEREC SW 5 können folgende Konstruktionen erstellt werden:

- Zahngetragenen Restaurationen
- Implantatgetragenen Restaurationen
- Bohrschablonen
- Kieferorthopädische Apparaturen
- Zubehörapparaturen

Die Konstruktionen können zur Ausarbeitung aus dentalen Materialien exportiert werden.

Optische Abdrücke, digitale Modelle und Konstruktionen können zur Weiterverarbeitung sowohl importiert als auch exportiert werden.

2.2.1.2 Indikationen

Indikationen des folgenden Teilbereichs der Zahnheilkunde:

- Restaurative Zahnheilkunde
- Implantologie
- Kieferorthopädie

2.2.1.3 Kontraindikationen

Alle Indikationen, die nicht Teil der restaurativen Zahnheilkunde, der Implantologie oder Kieferorthopädie sind, sind Kontraindikationen.

2.3 Cybersicherheit

Die Sicherheit der CEREC-Software hängt von der physischen Sicherheit Ihrer Praxis oder Klinik und der Sicherheit Ihres internen Netzwerks ab. Daher empfehlen wir dringend:

- Beschränkung des physischen Zugriffs auf die IT-Infrastruktur Ihrer Praxis oder Klinik auf Mitarbeiter und Personen, die den Zugriff tatsächlich benötigen.
- Bei der Nutzung eines drahtlosen Netzwerks sollten Sie die neuesten IT-Sicherheitsstandards verwenden, einschließlich einer starken Verschlüsselung Ihres drahtlosen Netzwerks.
- Verwendung eines starken Passworts, um den Zugang zu den Geräten, auf denen CEREC installiert ist, für Personen zu verwehren, die keinen Zugriff benötigen.
- Einen aktuellen Virenschutz und aktuelle Firewall-Einstellungen auf den Geräten, auf denen CEREC installiert ist, sowie auf allen anderen Geräten, die sich im selben Netzwerk befinden.
- Lassen Sie die Informationssicherheit Ihres internen Netzes von einem Sicherheitsspezialisten überprüfen.

2.4 Zubehör

Um die Produktsicherheit zu gewährleisten, darf das Produkt nur mit Original-Zubehör von Dentsply Sirona oder von Dentsply Sirona freigegebenem Zubehör Dritter betrieben werden. Der Benutzer trägt das Risiko bei Verwendung von nicht freigegebenem Zubehör.

2.4.1 Zubehör zur Erfassung der Implantatposition

Hersteller / Implantat	Implantat-Durchmesser	Plattform	ScanPost	REF	Anschluss	Abutment Screw	REF
Dentsply Sirona Implants							
PrimeTaper EV	3,6	S	AT EV 3.6 S	6586361	S	AT EV 3.6	6586270
	4,2	M	AT EV 4.2 L	6586379	L	AT EV 4.2	6586288
	4,8 / 5,4	L	AT EV 4.8 L	6586387	L	AT EV 4.8	6586296
AstraTech Implant EV	3,0	XS	AT EV 3.0 S	6586353	S	AT EV 3.0	6586262
	3,6	S	AT EV 3.6 S	6586361	S	AT EV 3.6	6586270
	4,2	M	AT EV 4.2 L	6586379	L	AT EV 4.2	6586288
	4,8	L	AT EV 4.8 L	6586387	L	AT EV 4.8	6586296
	5,4	XL	AT EV 5.4 L	6586395	L	AT EV 5.4	6593714
Ankylos	A, B, C, D	C/X	ANK S	6586569	S	nicht erhältlich	
AstraTech OsseoSpeed TX	3.5 S / 4.0 S	3.5 / 4.0	AT OS 3.5/4.0 L	6431055	L	AT OS 3.5/4.0	6460344
	4.5 / 5.0 / 5.0 S	4.5 / 5.0	AT OS 4.5/5.0 L	6431063	L	AT OS 4.5/5.0	6460443
Frialit	3,4	3,4	FX 3.4 S	6430891	S	FX 3.4, 3.8, 4.5, 5.5	6460476
	3,8	3,8	FX 3.8 S	6430909	S		
	4,5	4,5	FX 4.5 L	6430917	L		
	5,5	5,5	FX 5.5 L	6430925	L		
Biomet 3i							
Certain® (Innenverbindung)	3,4	3,4	B C 3.4 S	6431212	S	B C 3.4, 4.1, 5.0	6460450
	4,1	4,1	B C 4.1 L	6431220	L		
	5	5,0	B C 5.0 L	6431238	L		
Außen Sechskant	3,4	3,4	B O 3.4 L	6431089	L	B O 3.4, 4.1, 5.0	6460468
	4,1	4,1	B O 4.1 L	6431105			
	5	5,0	B O 5.0 L	6431113			
BioHorizons							
(Innenverbindung) tapered internal, tapered internal tissue level, tapered plus, internal dental implant, single stage dental implants	3,0 / 3,8	3,0	BH 3.0 S	6532761	S	BH 3.0	6561240
	3,0/3,5/3,8/4,0/4,6	3,5	BH 3.5 L	6532886	L		
	4,0/4,6/5,0/5,8	4,5	BH 4.5 L	6532944	L		
	5,0/5,8/6,0	5,7	BH 5.7 L	6536234	L		
Osstem							
Osstem TS	3,5	Mini	O TS 3.5 L	6534197	L	O TS 3.5	6561208
	4,0/4,5/5,0/6,0/7,0	Regular	O TS 4.0 L	6536846		O TS 4.0	6561232
Nobel Biocare							
Replace (Drei-Kanal Innenverbindung)	3,5	NP	NB RS 3.5 L	6430933	L	NB RS 3.5	6460526
	4,3	RP	NB RS 4.3 L	6430941			
	5	WP	NB RS 5.0 L	6430958			
	6	6,0	NB RS 6.0 L	6430982			
Nobel Active (conical connection)	3,5	NP	NB A 4.5 L	6431279	L	NB A 4.5	6460484
	4,3 / 5,0	RP	NB A 5.0 L	6431287		NB A 5.0	6460492
Branemark® (Außen Sechskant)	3,3	NP	NB B 3.4 L	6431006	L	NB B 3.4	6460500
	3,75 / 4,0	RP	NB B 4.1 L	6431022		NB B 4.1	6460518
Straumann							
Bone Level	3,3	NC (3.3 mm)	S BL 3.3 L	6431246	L	S BL 3.3, 4.1	6460542
	4,1 / 4,8	RC (4.1 mm / 4.8 mm)	S BL 4.1 L	6431253			
Standard (Tissue Level)	3,3 / 4,1 / 4,8	RN (4.8 mm)	S SO 4.8 L	6431170	L	S SO 4.8, 6.5	6460567
	4,8	WN (6.5 mm)	S SO 6.5 L	6431196			
Thommen Medical							
SPI Element, SPI Contact, SPI Element Inicell, SPI Contact Inicell	3,5	3,5	TM 3.5 S	6544386	S	TM 3.5	6561265
	4	4	TM 4 S	6544394			
	4,5	4,5	TM 4.5 S	6544402			
	5	5	TM 5 S	6544410			
	6	6	TM 6 S	6544428			
Zimmer							
Tapered Screw-Vent	3,7 / 4,1	3,5	Z TSV 3.5 L	6431139	L	Z TSV 3.5, 4.5, 5.7	6460575
	4,7	4,5	Z TSV 4.5 L	6431147			
	6	5,7	Z TSV 5.7 L	6431154			

Für APOLLO DI können beide Scanbodytypen verwendet werden, da sie mit APOLLO DI-SpeedSpray beschichtet werden müssen.

2.4.2 Hub

Hub ist ein netzwerkbasierendes Datencenter für CAD/CAM-Daten in der Praxis. Hub sichert die Daten der CEREC SW 5 und ermöglicht den Datenaustausch zwischen CEREC-Geräten.

Es erscheint in der Kontextleiste der CEREC SW 5 das Logo des Hub.

Die CEREC SW 5 muss eingestellt werden, um Daten auf den Hub speichern zu können. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch für den Anwender des Hub.

1. Wählen Sie im Systemmenü *"Konfiguration"* unter *"Einstellungen"* das Menü *"Patientendatenbank"*.
↳ Das Menü *"Datenbankeinstellungen"* erscheint.
2. Aktivieren Sie die Option *"Hub-Patientendatenbank"*.

Die Aufstellung und die Inbetriebnahme des Hub ist im Handbuch für den Anwender des Hub beschrieben. Weitere Infos finden Sie im Service-Handbuch des Hub.

2.5 inLab-Apps

Für die Indikationen Modell, Schiene und Löffel sind zusätzliche inLab-Apps notwendig. Diese Installation erfolgt separat zur CEREC SW 5. Die Installation und Bedienung der Apps ist in einem gesonderten Handbuch beschrieben.

2.6 Struktur des Handbuches

2.6.1 Kennzeichnung der Gefahrenstufen

Zur Vermeidung von Personen- und Sachschäden beachten Sie die in diesem Dokument aufgeführten Warn- und Sicherheitshinweise. Diese sind besonders gekennzeichnet:

GEFAHR

Unmittelbar drohende Gefahr, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führt.

WARNUNG

Möglicherweise gefährliche Situation, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führen könnte.

VORSICHT

Möglicherweise gefährliche Situation, die zu leichten und mittleren Körperverletzungen führen könnte.

ACHTUNG

Möglicherweise schädliche Situation, bei der das Produkt oder eine Sache in seiner Umgebung beschädigt werden könnte.

WICHTIG

Anwendungshinweise und andere wichtige Informationen.

Tipp: Informationen zur Arbeitserleichterung.

2.6.2 Verwendete Formatierungen und Zeichen

Die in diesem Dokument verwendeten Formatierungen und Zeichen haben folgende Bedeutung:

<ul style="list-style-type: none"> ✓ Voraussetzung 1. Erster Handlungsschritt 2. Zweiter Handlungsschritt oder ➤ Alternative Handlung ↔ Ergebnis ➤ Einzelner Handlungsschritt 	Kennzeichnet eine Handlungssequenz mit Voraussetzung und Ergebnis.
siehe „Verwendete Formatierungen und Zeichen [→ 17]“	Kennzeichnet einen Bezug zu einer anderen Textstelle und gibt deren Seitenzahl an.
• Aufzählung	Kennzeichnet eine Aufzählung.
„Befehl / Menüpunkt“	Kennzeichnet Befehle / Menüpunkte oder ein Zitat.

2.6.3 Bedienungskonventionen

Beispiel	Bedeutung
Tippen	Einmaliges Drücken und wieder Loslassen des Fingers oder der linken Trackball/Touchpad-Taste an der Aufnahmeeinheit.
Doppeltippen	Zweifaches, schnell aufeinanderfolgendes Drücken und Loslassen des Fingers oder der linken Trackball/Touchpad-Taste an der Aufnahmeeinheit.
Maus in eine Richtung bewegen	Bei der Aufnahmeeinheit: Trackball/Finger in die entsprechende Richtung bewegen.
Punkt anfassen	Linke Maustaste (linke Trackball/Touchpad-Taste an der Aufnahmeeinheit) drücken und gedrückt halten.
"Strg+N"	Auf der Tastatur: Tasten Strg und N gleichzeitig drücken.
Drag & Drop	Ziehen und Fallenlassen. Ein Element (z. B. Piktogramm) anwählen, halten und über einem möglichen Ziel loslassen/fallenlassen.

Multi-Touch-Technologie (nur bei Systemen mit Touch-Monitor)


Der Bildschirm ist mit Multi-Touch-Technologie ausgerüstet. Sie können mithilfe der Finger navigieren und Inhalte eingeben. Symbole werden geöffnet, wenn Sie die Symbole mit einem Finger antippen.

In der Software navigieren

Beispiel	Bedeutung
Antippen	Einmaliges Antippen mit dem Finger auf den Bildschirm. Um Funktionen in der Software auszuführen, müssen Sie einmal die entsprechende Schaltfläche antippen.
Doppeltippen	Zweifaches, schnell aufeinanderfolgendes Antippen mit dem Finger auf den Bildschirm. Tipp: Um unter Windows Programme zu öffnen, müssen Sie die entsprechende Schaltfläche doppelt antippen (doppelklicken).
Kontextmenüs aufrufen	Tippen Sie die entsprechende Stelle an und halten Sie den Finger lange auf dem Bildschirm. An dieser Stelle öffnet sich ein Kontextmenü.
Drag & Drop	Ziehen und Fallenlassen. Ein Element (z. B. Piktogramm) antippen, halten und über einem möglichen Ziel loslassen/fallenlassen.

3D-Modell mit Multi-Touch bearbeiten

Sie können das 3D-Modell mithilfe von Multi-Touch bearbeiten.

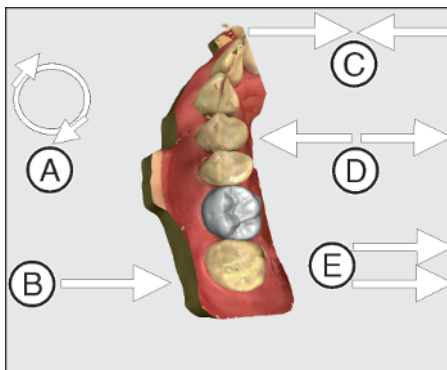

Position	Funktion
A	➤ Führen Sie eine Drehbewegung mit 2 Fingern durch. ↻ Das Objekt wird in der Ebene gedreht.
B	➤ Ziehen Sie mit 1 Finger. ↻ Das Modell wird aus seiner aktuellen Ebene gedreht.
C	➤ Ziehen Sie 2 Finger zusammen. ↻ Das Objekt wird verkleinert.
D	➤ Ziehen Sie die Finger auseinander. ↻ Das Objekt wird vergrößert.
E	➤ Ziehen Sie mit 2 Fingern. ↻ Das Modell wird gezogen.


2.6.4 Verwendetes Zahnschema

Die Software kann auf das internationale Zahnschema (FDI) oder das USA-Zahnschema (ADA) eingestellt werden (Zahnschema).

In dieser Dokumentation werden Zähne wie folgt benannt:

Prinzip:	FDI	(#ADA)
Beispiel:	13	(#6)

2.7 Die Bedienoberfläche

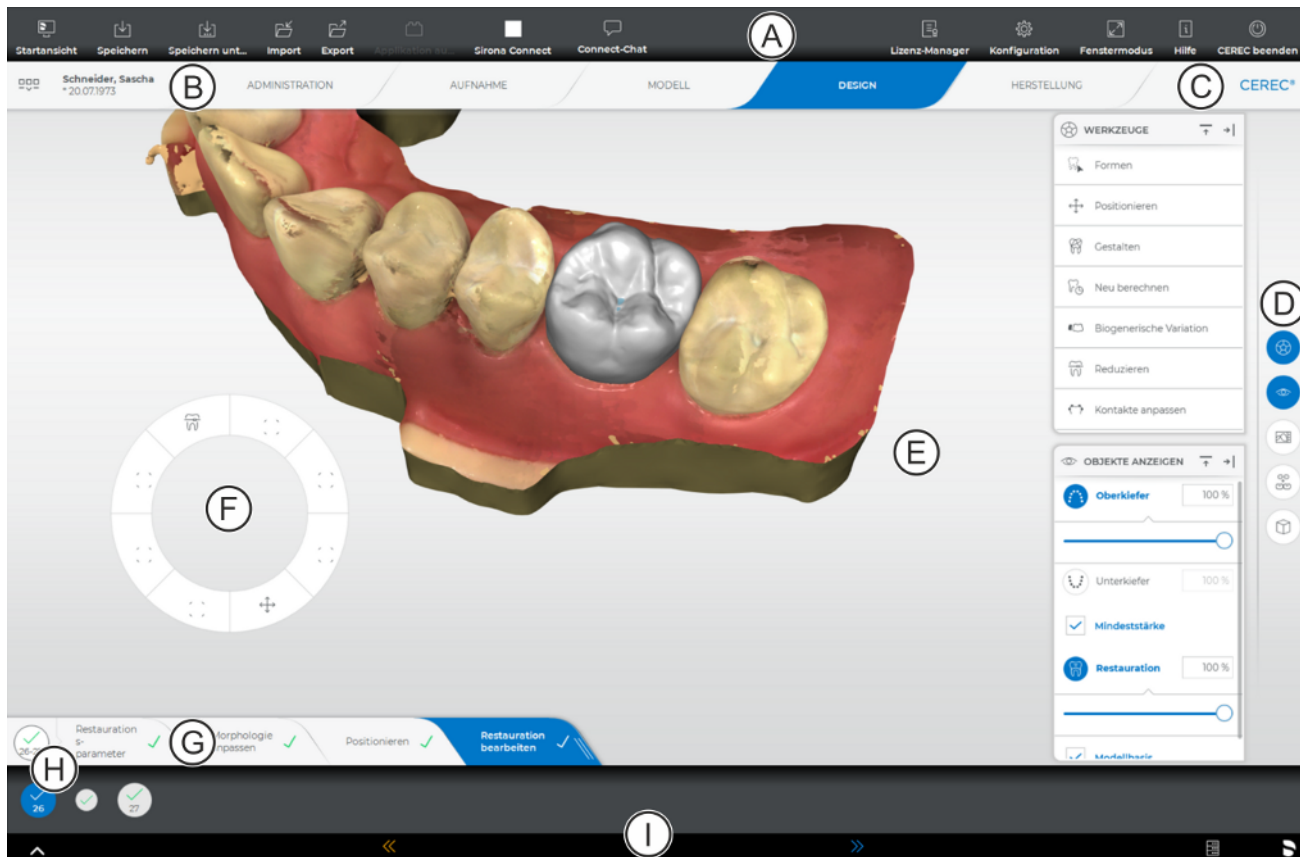

Übersicht über die Bedienoberfläche

A	Systemmenü	F	Werkzeugrad
B	Phasenleiste	G	Schrittmnü
C	Info-Dialog	H	Objektleiste
D	Seitenpalette	I	Kontextleiste
E	Hauptfenster		

2.7.1 Neuerungen durch die neue Aufnahmeeinheit und die Software CEREC 5.x

2.7.1.1 Neues Bildschirmformat

Mit der neuen Aufnahmeeinheit CEREC Primescan AC / Primescan AC / CEREC Omnicam AC / Omnicam AC bekommen Sie eine neue Bildschirmauflösung. Das Breitbildformat in 16:9 bietet Ihnen mehr Platz für ein präziseres Arbeiten an Modell und Restaurationen. Werkzeugfenster können großzügiger platziert werden, zeitgleich kann die 3D-Vorschau besonders groß dargestellt werden.

2.7.1.2 Neue Bedienmöglichkeiten

Touch-Funktionalität


Die Software CEREC SW 5 ist touch-kompatibel. Dies bedeutet, dass Sie mit ihrem Finger direkt auf dem Bildschirm interagieren können.

Die Bedienung der Anwendung kann bedingungslos im Wechsel zwischen Touch und Verwendung eines Touchpads oder Trackballs kombiniert erfolgen.

Einige Funktionen sind ausschließlich per Trackball ausführbar. Ist dies der Fall, wird in den entsprechenden Kapiteln darauf hingewiesen.

3D-Modell mit Multi-Touch bearbeiten

Sie können das 3D-Modell mithilfe von Multi-Touch bearbeiten.

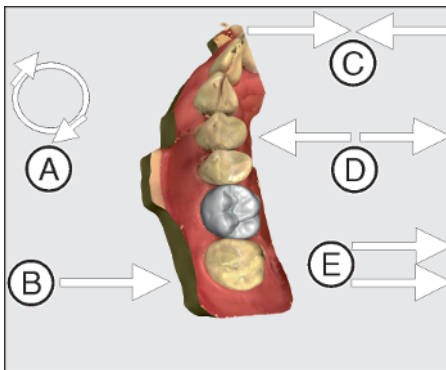

Position	Funktion
A	➤ Führen Sie eine Drehbewegung mit 2 Fingern durch. ☞ Das Objekt wird in der Ebene gedreht.
B	➤ Ziehen Sie mit 1 Finger. ☞ Das Modell wird aus seiner aktuellen Ebene gedreht.
C	➤ Ziehen Sie 2 Finger zusammen. ☞ Das Objekt wird verkleinert.
D	➤ Ziehen Sie die Finger auseinander. ☞ Das Objekt wird vergrößert.
E	➤ Ziehen Sie mit 2 Fingern. ☞ Das Modell wird gezogen.

2.7.1.3 Touchpad

Standardmäßig ist in der Aufnahmeeinheit CEREC Primescan AC / Primescan AC / CEREC Omnicam AC / Omnicam AC ein Touchpad verbaut. Auf der eingelassenen horizontalen Fläche können Sie mit dem Finger einen Mauszeiger auf dem Bildschirm bewegen. Alle gewohnten Interaktionen einer herkömmlichen Maus sind möglich.

2.7.1.4 Trackball

Alternativ kann ein Gerätemodell mit integriertem Trackball bestellt werden. Dieser ermöglicht ebenfalls die Verwendung eines Mauszeigers und stellt eine alternative Eingabemöglichkeit zur direkten Touch-Bedienung mit dem Finger auf dem Display dar.

2.7.2 Phasenleiste


Der Arbeitsablauf ist in der Software durch 5 Phasen abgebildet.



Phasenleiste

- ADMINISTRATION
- AUFNAHME
- MODELL
- DESIGN
- HERSTELLUNG

2.7.2.1 ADMINISTRATION



In dieser Phase können Sie Folgendes ausführen:

- Restaurationen anlegen und deren Art bestimmen,
- eine Fertigungseinheit festlegen,
- Material auswählen.

2.7.2.2 AUFNAHME



In dieser Phase können Sie Folgendes ausführen:

- Aufnahmen mit dem Scanner erstellen
 - Unterkiefer,
 - Oberkiefer,
 - Bukkale Bissregistrierung
- 3D-Vorschau der Aufnahmen ansehen
- Weitere Bildkataloge hinzufügen
 - BioKopie UK
 - BioKopie OK
 - Gingivamaske UK
 - Gingivamaske OK
 - Scanbody UK
 - Scanbody OK

2.7.2.3 MODELL



In dieser Phase können Sie Folgendes ausführen:

- Das Modell bearbeiten
- die Biss-Situation überprüfen oder neu festlegen
- die Modelle ausrichten
- das getrimmte Modell überprüfen oder neu manuell trimmen
- den Präparationsrand überprüfen, korrigieren oder neu eingeben.
- Einschubachsen festlegen
- Kieferlinie und Restaurationspositionen festlegen
- gegebenenfalls Restaurationsachsen festlegen (nur Abutments)
- Bei bestimmten Indikationen erfolgt hier der Wechsel in die entsprechende inLab-App.

2.7.2.4 DESIGN



In dieser Phase können Sie Folgendes ausführen:

- Zahnform auswählen,
- Restaurationen positionieren und skalieren,
- Restaurationsparameter individuell verändern,
- Initiale Restaurationsvorschläge erstellen lassen,
- Restaurationen individuell gestalten.


2.7.2.5 HERSTELLUNG



In dieser Phase können Sie Folgendes für jede Restauration ausführen:


- Die Farbe des Blocks festlegen, der mit einem angeschlossenen Sinterofen CEREC SpeedFire gesintert werden soll,
- Eine Fertigungseinheit festlegen,
- Den CEREC SpeedFire auswählen (wenn angeschlossen),
- Herstellungsoptionen festlegen (nicht bei allen Materialien möglich),
- Die Blockgröße bestimmen,
- Die Positionierung der Restauration im Block prüfen und anpassen,
- Die Abstichstelle der Restauration festlegen,
- Den Herstellungsprozess starten,
- Restaurationen/Modelle exportieren für die inLab CAM SW.

2.7.3 Objektleiste



In der Objektleiste befinden sich die Schaltflächen für die Restaurationsauswahl.

Jede Restauration wird durch ein Zahn- bzw. Brücken-Symbol mit der entsprechenden Zahnnummer repräsentiert. Sie können zwischen den Zähnen hin- und herspringen, indem Sie jeweils auf das entsprechende Symbol klicken.

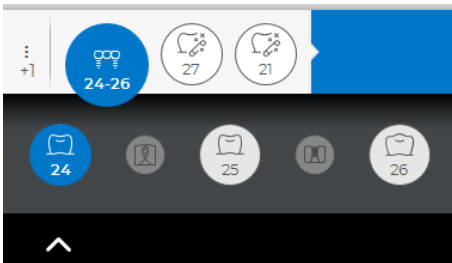

Aktive Elemente werden auf einem blauen Hintergrund dargestellt.


Sobald ein Fall mehr als fünf Restaurationen beinhaltet, werden maximal fünf Restaurationen direkt angezeigt und jede weitere hinter einer Schaltfläche verborgen.

Wenn sich Restaurationen über mehrere Zahnpositionen erstrecken oder bei Multilayer zwei Objekte pro Zahnposition auswählbar sind, wird die Objektleiste nach unten erweitert. Sie können zwischen verschiedenen aktiven Element im erweiterten Bereich wechseln.

Bei der Restauration mehrerer Zähne oder Zahngruppen (z. B. Brücke) ist es notwendig, obligatorische Schritte (z. B. Präparationsrand zeichnen) für alle Objekte zu absolvieren, um fortzufahren.

Entsprechende Hinweise an den Objekten geben Information über den Status.

2.7.4 Seitenpalette

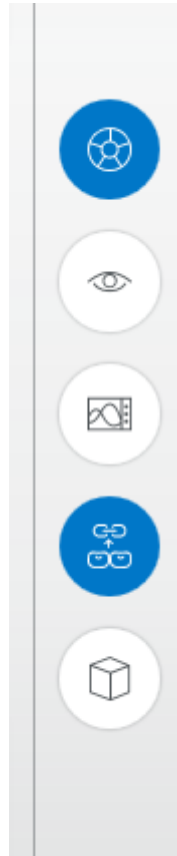

In der Seitenpalette werden Ihnen verschiedene Funktionen und Optionen angeboten, abhängig von der aktuell aktiven Phase.

Sie können mehrere Seitenpaletten gleichzeitig öffnen. Initial sind alle Seitenpaletten geschlossen. Obligatorische Paletten werden pro Eintritt in den jeweiligen Schritt automatisch geöffnet dargestellt. Geöffnete Paletten teilen sich die dort verfügbare Höhe.

Wenn Ihnen diese Darstellung nicht ausreicht, können Sie jede beliebige Seitenpalette aus dem angehefteten Zustand der Magnetleiste herausziehen. Hierfür halten Sie Ihren Finger auf dem Kopfteil der Seitenpalette gedrückt und ziehen jetzt die Palette an die gewünschte Position innerhalb des Hauptfensters.

Tipp: Wenn Sie die Software CEREC SW 5 im Fenstermodus oder auf mehreren Bildschirmen verwenden, so können Sie die Seitenpaletten auch aus dem Anwendungsfenster herausziehen und an einer beliebigen Stelle ihres Bildschirms positionieren.

Alle Änderungen an einer Seitenpalette (Größe und Position) werden für jeden Schritt separat gespeichert. Sie können sich somit jeden Arbeitsschritt nach Ihren Vorstellungen konfigurieren.

WICHTIG

Wird eine Seitenpalette geschlossen, bleiben Größe und Position beim erneuten Öffnen erhalten. Wird eine Seitenpalette aber wieder an die Magnetleiste geheftet, so gehen die gespeicherte Größe und Position verloren.

Um eine Seitenpalette wieder an die Magnetleiste auf der rechten Seite anzuheften, ziehen Sie eine beliebige Seitenpalette über die Magnetleiste auf der rechten Seite. Die Magnetleiste leuchtet auf, sodass verschiedene Positionen für das Fenster vorgeschlagen werden. Das Fenster schnappt dann an der angezeigten Stelle ein, sobald Sie Ihren Finger loslassen. Die Seitenpalette wird sich jetzt automatisch wieder zwischen den anderen Seitenpaletten einordnen.


Zum Schließen einer Seitenpalette klicken Sie auf die Schaltfläche rechts im Kopf der Seitenpalette oder erneut auf die jeweilige Schaltfläche rechts in der Magnetleiste.

Minimieren und Maximieren

Für Seitenpaletten mit einer Vielzahl von Funktionen gibt es eine kompakte Ansicht. In dieser werden nur noch die am häufigsten verwendeten Werkzeuge und Funktionen dargestellt. Sie können zwischen beiden Ansichten hin- und herwechseln, indem Sie auf die entsprechende Schaltfläche tippen (links neben Schließen).



2.7.5 Werkzeug-Rad

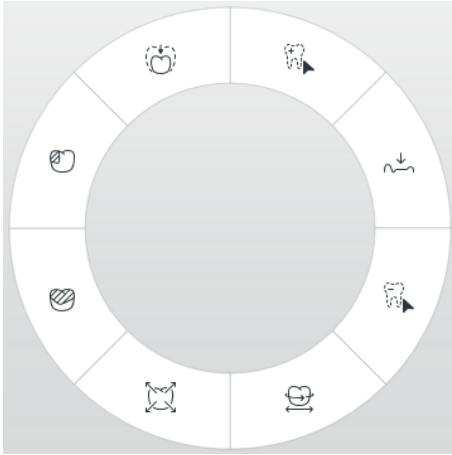

Das Werkzeug-Rad stellt in den Phasen ADMINISTRATION, MODELL, DESIGN oder HERSTELLUNG die gängigsten Werkzeuge zur Verfügung, um die Zugriffe zu vereinfachen. Die zur Verfügung stehenden Werkzeuge sind abhängig vom aktuellen Schritt.

1. Drücken Sie lange mit dem Finger oder klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Arbeitsbereich.
 - ↳ Das Werkzeug-Rad wird geöffnet.
2. Drücken Sie erneut lange mit dem Finger oder klicken Sie mit der rechten Maustaste an eine beliebige Stelle im Arbeitsbereich.
 - ↳ Das Werkzeug-Rad wird an die Position des Mauszeigers/Fingers verschoben.
3. Wählen Sie ein Werkzeug.
 - ↳ Das Werkzeug steht zur Verfügung. Das Werkzeug-Rad schließt automatisch.

Sie können das Werkzeug-Rad auch schließen, indem Sie kurz in den Arbeitsbereich tippen oder klicken.

2.7.6 Schrittmenü

Jede Phase ist in Schritte unterteilt. Diese werden im Schrittmenü am unteren Bildschirmrand abgebildet. Das Schrittmenü ändert sich abhängig davon, in welcher Phase sich der aktuelle Fall gerade befindet.


Das Menü hilft Ihnen Schritt für Schritt durch den Prozess. Alle obligatorischen Schritte einer Phase werden automatisiert oder manuell durchlaufen. Änderungen in den einzelnen Schritten werden beim Klicken auf den nächsten Schritt übernommen.



Mit den Pfeiltasten in der Kontextleiste können Sie zwischen den obligatorischen Schritten wechseln.

Statussymbole

Alle Schritte sind mit einem Statussymbol versehen. Sternchen weisen auf obligatorische Schritte hin.



Orangefarbenes
Sternchen / kein
Haken:

Der Schritt ist obligatorisch und wurde noch nicht begonnen.



Weißes Sternchen / kein Haken:

Der Schritt wurde noch nicht vollständig absolviert.



Kein Sternchen /
Haken:

Der Schritt wurde erfolgreich absolviert.

Pflicht- und optionale Schritte



Über die Schaltfläche rechts im Schrittmenü können optionale Schritte ein- oder ausgeblendet werden. Tippen Sie dafür in den rechten Bereich nahe der Kante des letzten Schrittes.



Optionale Schritte werden automatisch ausgeführt und haben sofort einen grünen Haken. Die verwendeten Standards können allerdings modifiziert werden. Auch obligatorische Schritte werden von der Software weitestgehend automatisch durchgeführt. Der automatische Prozess stoppt beim nächsten Pflichtschritt, bei dem eigenes Durchführen notwendig ist. Pro Phase gibt es nur einen obligatorischen Schritt.

2.7.7 Kontextleiste

Im unteren Bildschirmbereich befindet sich eine schwarze Leiste.

In diesem Bereich befinden sich kontextabhängig Funktionsschaltflächen, wie beispielsweise die Pfeiltasten zum Wechseln in die nächste Phase.

Einige Schritte müssen mit einem "OK" bestätigt werden oder können abgebrochen werden.

Des Weiteren enthält die Kontextleiste auf der rechten Seite Statusinformationen und Funktionen:



- Hub-Konnektivität



- Batteriestatus



- Hinweise ein-/ausblenden

3 Erste Schritte

3.1 Software installieren

Die Software benötigt mindestens die Firmware 2.00 des USB-Lizenzsticks. Aktualisieren Sie gegebenenfalls die Firmware-Version. Weitere Informationen finden Sie dazu im Abschnitt „Lizenzmanager“.

Für die Software wird mindestens eine Aufnahmeeinheit CEREC AC mit einem Betriebssystem Windows 10 benötigt. Sollten Sie eine Aufnahmeeinheit mit Betriebssystem Windows 7 besitzen, informieren Sie sich bezüglich der Umstellung auf Windows 10 über Ihren Handelspartner.

Die Software ist für den Betrieb auf einem inLab PC (HW-Stand 7.0.1 oder neuer) freigegeben. Die Software ist für den Betrieb mit den Betriebssystemen Windows 10 und Windows 11 freigegeben.

Verwenden Sie die mit dieser Version ausgelieferte Version des Lizenzmanagers, um Lizenzen vom beigefügten Lizenzgutschein aufzuspielen.

3.1.1 Installation per USB-Stick

Installation vorbereiten

- ✓ Die Firmware des USB-Lizenzsticks ist mindestens in der Version 2.00 vorhanden.
- ✓ Der PC ist hochgefahren und alle Programme sind geschlossen.
- 1. Stecken Sie den USB-Stick in den entsprechenden USB-Anschluss in die Aufnahmeeinheit.
 - ↳ Das Installationsprogramm startet automatisch.
- 2. Sollte dies nicht der Fall sein, führen Sie die Datei *"Setup.exe"* im Hauptverzeichnis des Sticks aus.
 - ↳ Das Installationsprogramm wird gestartet.

Anwendung installieren

1. Wählen Sie die Sprache für die folgende Installation aus und betätigen Sie anschließend die Schaltfläche *"Weiter"*.
2. Lesen Sie die Hinweise zum Urheberrecht sorgfältig durch und betätigen Sie anschließend die Schaltfläche *"Weiter"*.
3. Wählen Sie im nächsten Schritt die Sprache und Anwendungsregion für die Anwendung aus und betätigen Sie anschließend die Schaltfläche *"Weiter"*.
4. Im nächsten Schritt können Sie optional einen anderen Ordner für die Installation der Anwendung und gegebenenfalls einen alternativen Ordner für den Patientendatenordner definieren. Anschließend betätigen Sie die Schaltfläche *"Weiter"*. Der Pfad zum Patientendatenordner kann auch nach der Installation über das Konfigurationsmenü noch geändert werden.
5. Im nächsten Schritt erscheint der Lizenzvertrag. Lesen Sie die Lizenzvereinbarung sorgfältig durch. Wenn Sie der Lizenzvereinbarung zustimmen, dann markieren Sie das Optionsfeld *"Ich stimme den Bedingungen der Lizenzvereinbarung zu"* und betätigen Sie dann die Schaltfläche *"Weiter"*.
6. Im nächsten Schritt wird Ihre Lizenz auf dem USB-Lizenzstick überprüft. Stellen Sie dafür sicher, dass der USB-Lizenzstick korrekt eingesteckt ist, bevor Sie die Schaltfläche *"Weiter"* betätigen.
Tipp: Sie können diesen Schritt auch überspringen. Markieren Sie dafür das Optionsfeld *"Lizenzprüfung überspringen und mit der Installation der Anwendung fortfahren"* und betätigen Sie anschließend die Schaltfläche *"Weiter"*. Wird die Lizenzüberprüfung übersprungen, läuft die Software in einem Demo-Modus.
☞ Die Anwendung wird jetzt installiert. Dies kann einige Minuten dauern.
7. Betätigen Sie nach der erfolgreichen Installation auf die Schaltfläche *"Start"* um die Installation zu beenden und die Anwendung im Anschluss direkt zu starten. Sie erhalten an dieser Stelle die Möglichkeit, sich für einen Dentsply Sirona-Newsletter anzumelden.
Tipp: Falls Sie die Anwendung nicht direkt starten möchten, entfernen Sie den Haken aus dem Kontrollkästchen *"Anwendung direkt starten"* und betätigen Sie anschließend die Schaltfläche *"Beenden"*. Das Installationsprogramm wird geschlossen.

3.2 Software deinstallieren

- ✓ Das Programm ist geschlossen.
1. Öffnen Sie das Startmenü und klicken auf das Zahnrad für *"Einstellungen"*.
 2. Klicken Sie auf die Kachel *"Apps"*.
 3. Klicken Sie links auf *"Apps & Features"*.
 4. Suchen Sie den Eintrag der Dentsply Sirona-Software und klicken Sie auf diesen.
☞ Der Eintrag der Software wird geöffnet, darin befinden sich mehrere graue Schaltflächen.
 5. Klicken Sie auf die Schaltfläche *"Deinstallieren"* und folgen den erscheinenden Anweisungen.

3.3 Auslieferungszustand herstellen

- ✓ Das Programm ist geschlossen.
- 1. Deinstallieren Sie die Software (siehe „Software deinstallieren [→ 30]“).
- 2. Installieren Sie die Software (siehe „Software installieren [→ 29]“).
 - ↳ Der ursprüngliche Auslieferungszustand ist wieder hergestellt.

3.4 Kopierschutz

Die Software kann nur gestartet werden, wenn der USB-Lizenz-Stick eingesteckt ist. Der USB-Lizenz-Stick ist im Lieferumfang der Geräte enthalten. Wenn Sie zusätzliche Lizenzen benötigen, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

Bewahren Sie den USB-Lizenz-Stick am Gerät auf.

Alle Berechtigungen (Software-Lizenzen) lassen sich als elektronische Lizenzen auf dem USB-Lizenz-Stick installieren. Dazu müssen Sie den 25-stelligen Lizenzschlüssel eingeben.

Den Lizenzschlüssel erhalten Sie mit dem Gerät. Alternativ können Sie ihn über Ihren Fachhändler separat bestellen.

Nach einer Aktualisierung benötigen Sie eventuell eine neue Lizenz, die Sie nicht auf Ihrem USB-Lizenz-Stick haben. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Lizenzmanager“.

3.5 Software herunterladen

Auto-Update, Case Connect Center

WICHTIG
Um die Funktion Auto-Update zu nutzen, muss der PC mit dem Internet verbunden sein.

Bei der Installation von CEREC SW 5 wird die Funktion Auto-Update als Teil des Case Connect Centers mit installiert. Zukünftige Softwareaktualisierungen in Form von Servicepacks der CEREC SW 5 können Sie so komfortabel über das Internet herunterladen und installieren.

Sobald eine Aktualisierung zum Download bereit steht, werden Sie automatisch über ein Dialogfenster darüber benachrichtigt.

Update

Größere Softwareaktualisierungen (Updates) sind kostenpflichtig und setzen eine neue Lizenz voraus.

3.6 Software starten

- ✓ Die Software CEREC SW 5 ist installiert. Auf dem Desktop befindet sich das Startsymbol.
- ✓ Der USB-Lizenz-Stick mit einer gültigen, aktuellen Lizenz ist eingesteckt.
- > Betätigen Sie doppelt das Startsymbol von CEREC SW 5.
oder
- > Betätigen Sie „Start / Alle Programme / Sirona Dental Systems/ CEREC SW 5 / CEREC SW 5“.
- ↳ Die Software wird gestartet.

4 Designmodus

4.1 Allgemeine Informationen zu Biogenerik

Die Biogenerik ermöglicht es der CEREC-Software Zähne naturgetreu zu rekonstruieren. Bei der Biogenerik handelt es sich um ein biogenerisches Verfahren, welches auf der wissenschaftlichen Erkenntnis basiert, dass zwischen den Zähnen morphologische Zusammenhänge bestehen, die sich in mathematischen Funktionen ausdrücken lassen.

Mit CEREC SW 5 hat das Vorschlagswesen der Biogenerik eine grundlegende Überarbeitung erfahren, so werden nun auch die Aufstellung und gesamte Morphologie in Analyse und Vorschlag einbezogen. Dadurch wurde die Qualität der Erstvorschläge nochmals deutlich verbessert. Dies gilt sowohl für Einzelzähne aber insbesondere auch für Mehrfachrestaurationen und Frontzähne.

Es werden alle mit der Kamera erfassten Zähne bezüglich ihrer Aufstellung und Morphologie analysiert. Basierend auf dieser Analyse kann die entsprechende Restauration vollautomatisch hergestellt werden.

Damit die Biogenerik ideale Vorschläge liefern kann, ist es wichtig, dass Eingaben korrekt und vollständig sind. Insbesondere gilt dies für folgende Schritte:

- **Aufnahme**
Die Aufnahme sollte gut und vollständig sein. Bei Einzelzahnversorgung sollten zumindest die Nachbarzähne mit erfasst werden. Scanlöcher in den Bereichen der Präparation und der proximalen Kontakte sollten vermieden werden (siehe „Aufnahme durchführen“).
- **Modellachse**
Die Modellachse sollte präzise ausgerichtet sein (siehe „Modellachse festlegen“).

4.2 Biogenerik individuell

Im Konstruktionsverfahren *"Biogenerik individuell"* wird die gemachte Aufnahme analysiert und auf Basis dieser Information der Restaurationsvorschlag berechnet. Je mehr Informationen vorliegen, desto besser kann die Berechnung erfolgen. Es sollte daher mindestens ein Nachbarzahn von okklusal/inzisal vollständig aufgenommen werden. Bei Front und Eckzähnen sollte auch die Labialfläche mit aufgenommen werden.

Bei Prämolaren oder Molaren wird hauptsächlich der distale Nachbar zur Berechnung herangezogen, bei Frontzähnen der mesiale Nachbar.

4.3 Kopieren und Spiegeln

Wählen Sie das Konstruktionsverfahren *"Kopieren & Spiegeln"* aus, um selbst zu bestimmen, welcher Zahn als Referenz für die Berechnung des Restaurationsvorschlags verwendet werden soll. Der Referenzzahn kann ein beliebiger Zahn gleicher Klasse (Front-/Seitenzahn) sein, z. B. der Antagonist oder der kontralaterale Zahn.

4.4 Biogenerik-Kopie

Wählen Sie das Konstruktionsverfahren *"Biogenerik-Kopie"* in der Falladministration in den Falldetails aus, um Teile einer bestehenden Kaufläche in die Restauration zu übertragen und den Rest mittels des patentierten Verfahrens der Biogenerik zu ergänzen.

Nehmen Sie dazu den Zustand vor dem Präparieren im Bildfeld *"BioKopie OK"* oder *"BioKopie UK"* separat auf.

Das Verfahren ist für Inlays, Onlays, Teilkronen, Kronen und Brücken anwendbar.

4.5 Bio-Kiefer

Das Vorschlagssystem für Restaurationen "*Bio Kiefer*" bietet die Option an, die Aufstellung und Morphologie (nur für Frontzähne und Prämolaren) vor dem eigentlichen Erstvorschlag anzupassen, das heißt, in diesem Schritt ist die Restauration noch nicht an den Präparationsrand und nur sehr grob an die Kontakte zu Nachbarn und Antagonisten angepasst. Die Anpassungen werden erst mit der Berechnung des Erstvorschlags vorgenommen.

Sollte der Erstvorschlag bezüglich seiner Position oder Form nicht Ihren Vorstellungen entsprechen, besteht die Möglichkeit, dies über einen der beiden optionalen Schritte Morphologie und Positionieren anzupassen.

Schritt Morphologie



Im Schrittmü steht Ihnen der optionale Schritt "*Morphologie*" zur Verfügung. In diesem haben Sie die Möglichkeit zu wählen, ob die Zähne vollständig von der Biogenerik berechnet werden sollen (Standard) oder ob Sie die Zahnform vorgeben möchten. Dann berechnet Ihnen die Biogenerik einen biogenerischen Erstvorschlag mit der definierten Zahnform. Klicken Sie dafür auf Zahnform und wählen Sie die entsprechende Zahnform.

Schritt Positionieren



Im Schritt "*Positionieren*" können Sie die Aufstellung der Zähne verändern. Dafür stehen Ihnen die Werkzeuge "*Positionieren und Rotieren*" und "*Skalieren*" zur Verfügung. Die Neupositionierung kann für jeden Zahn einzeln erfolgen oder Sie können benachbarte Restaurationen gruppieren und somit mehrere Zähne gleichzeitig bearbeiten. Wenn Sie die Zähne gruppieren, berücksichtigt die Software die Kontaktsituation der markierten Zähne, das heißt, wird beispielsweise ein Zahn der Gruppe vergrößert, werden die anderen verkleinert. Der gleiche Mechanismus wirkt beim Positionieren der Zähne. Auch hier werden die Zähne in ihrer Größe den veränderten Gegebenheiten angepasst.

5 Konfiguration



Das Menü "Konfiguration" besteht aus folgenden Untermenüs:

- Parameter
- Geräte
- Einstellungen
- Anwendungen

5.1 Parameter



Das Menü "Parameter" ist nach Restaurationstypen gegliedert. Sie können die Einstellungen für jeden der folgenden Restaurationstypen vornehmen.

Die Änderungen an den Werten werden grafisch dargestellt.

Die hier eingestellten Parameterwerte werden als Standardwerte für alle Erstvorschläge verwendet.

Tipp: Wollen Sie nur für eine Restauration Parameterwerte verändern, tun Sie dies in der Phase DESIGN im Schritt "Restaurationsparameter".

Parameter-Profile

Sie können Parameter-Profile definieren. Hiermit können Sie für alle Restaurationstypen unterschiedliche Parametersets definieren und abspeichern.

1. Duplizieren Sie die Werkeinstellungen mit den Herstellervorgaben, indem Sie auf das Plus-Symbol klicken.
2. Geben Sie dem Profil einen individuellen Namen und bestätigen Sie die Eingabe über das Haken-Symbol.
3. Passen Sie die Parameter nach ihren Wünschen an und speichern Sie sie ab.
 - ↳ Diese Voreinstellungen können Sie dann sowohl als globale Parameter als auch als lokale Parameter verwenden.
4. Sie können das neu erstellte Profil als Favoriten auswählen, indem Sie auf das Stern-Symbol klicken.

Einstellungen übernehmen

- > Betätigen Sie die Schaltfläche "Ok".

Einstellungen verwerfen

- > Betätigen Sie die Schaltfläche "Abbrechen".

Einstellungen zurücksetzen

- > Betätigen Sie die Schaltfläche "Alle Gruppenparameter zurücksetzen".
 - ↳ Die Einstellungen für diesen Restaurationstyp werden auf die Werkeinstellungen zurückgesetzt.

Krone, Inlay, Onlay und Veneer

Parameter	Beschreibung	Standard-Wert		
		Krone	Inlay/ Onlay	Veneer
Spacer (radial)	<ul style="list-style-type: none"> Einstellungsmöglichkeit des Raums für das Befestigungsmaterial unter der Restauration. Wirkt bis zur Präparationsgrenze. Bei Kronen kann ein unterschiedlicher Spacer für radial und okklusal eingestellt werden. 	120 µm	120 µm	120 µm
Spacer (okklusal)		120 µm	-	-
Klebefuge	<ul style="list-style-type: none"> Breite des Zwischenraums am Präparationsrand einstellen. Der Wert der Klebefuge kann nie größer als der Spacer-Wert sein. 	-	60 µm	-
Veneerstärke	<ul style="list-style-type: none"> Mindeststärke einstellen. Die Software versucht bei der Berechnung der Restaurationsvorschläge, diese Stärke nicht zu unterschreiten. Phasen DESIGN und HERSTELLUNG: Der Wert wird als halbtransparente Geometrie auf der Präparation angezeigt. Dadurch werden Bereiche sichtbar, in denen die Mindeststärke beim Konstruieren unterschritten werden. 	-	-	500 µm
Okklusaler Schleifoffset (Parameter kann in der Phase HERSTELLUNG gesetzt werden)	<ul style="list-style-type: none"> Material auf der gesamten Kaufläche in Okklusalrichtung auf- oder abtragen. Dieser Wert betrifft nur das Schleifergebnis. Phasen DESIGN und HERSTELLUNG: Die Auswirkungen sind nicht sichtbar. 	0 µm	0 µm	0 µm
Approximale Kontaktstärke	<ul style="list-style-type: none"> Stärke der approximalen Kontakte einstellen. Die Software versucht bei den Restaurationsvorschlägen, diese hinterlegte Stärke zu erreichen. 	25 µm	25 µm	-
Okklusale Kontaktstärke	<ul style="list-style-type: none"> Stärke der okklusalen Kontakte einstellen. Die Software versucht bei den Restaurationsvorschlägen, diese hinterlegte Stärke zu erreichen. 	25 µm	25 µm	-
Dynamische Kontaktstärke	<ul style="list-style-type: none"> Stärke der dynamischen okklusalen Kontakte definieren; wirkt nur bei Verwendung des virtuellen Artikulators. 	25 µm	25 µm	-

Parameter	Beschreibung	Standard-Wert		
		Krone	Inlay/ Onlay	Veneer
<p>Mindeststärke (radial) (Materialabhängiger Parameter, kann nur im Schritt "Restaurationsparameter" der Phase DESIGN geändert werden)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mindestwandstärke in horizontaler Richtung einstellen. • Die Software versucht bei der Berechnung der Restaurationsvorschläge, diese Stärke nicht zu unterschreiten. • Phasen DESIGN und HERSTELLUNG: Der Wert wird zusammen mit der okklusalen Mindeststärke und der Einstellung zur Instrumentengeometrie als halbtransparente Geometrie auf der Präparation angezeigt. Dadurch werden Bereiche sichtbar, in denen die Mindeststärke beim Konstruieren unterschritten wird. • Beachten Sie bei der Einstellung der Mindeststärke die Empfehlungen des jeweiligen Materialherstellers. • Kann ein- bzw. ausgeschaltet werden 	Vorgabe des Materialherstellers		
<p>Mindeststärke (okklusal) (Materialabhängiger Parameter, kann nur im Schritt "Restaurationsparameter" der Phase DESIGN geändert werden)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mindestwandstärke in okklusaler Richtung einstellen. • Die Software versucht bei der Berechnung der Restaurationsvorschläge, diese Stärke nicht zu unterschreiten. • Phasen DESIGN und HERSTELLUNG: Der Wert wird zusammen mit der radialen Mindeststärke und der Einstellung zur Instrumentengeometrie als halbtransparente Geometrie auf der Präparation angezeigt. Dadurch werden Bereiche sichtbar, in denen die Mindeststärke beim Konstruieren unterschritten wird. • Beachten Sie bei der Einstellung der Mindeststärke die Empfehlungen des jeweiligen Materialherstellers. • Kann ein- bzw. ausgeschaltet werden 	Vorgabe des Materialherstellers		
<p>Randverstärkung (Materialabhängiger Parameter, kann nur im Schritt "Restaurationsparameter" der Phase DESIGN geändert werden)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Restaurationsränder mit zusätzlichem Material verstärken. <ul style="list-style-type: none"> – Vereinfacht den Umgang mit der Restauration – Verhindert Splittern des Materials • Das zusätzliche Material kann vor dem Einsetzen der Restauration händig weggeschliffen werden. • Kann ein- bzw. ausgeschaltet werden 	Vorgabe des Materialherstellers		
<p>"Flankenwinkel des Randes"</p>	Bestimmt den Winkel, mit dem die Restauration vom Rand ansteigt.	60°	60°	60°

Parameter	Beschreibung	Standard-Wert		
		Krone	Inlay/ Onlay	Veneer
<i>"Flankenbreite des Randes"</i> (Materialabhängiger Parameter, kann nur im Schritt <i>"Restaurationsparameter"</i> der Phase DESIGN geändert werden)	Bestimmt die Länge des Randes, mit der die Restauration vom Präparationsrand aufsteigt.	Vorgabe des Materialherstellers		
Fräserradiuskorrektur	Berücksichtigt die Instrumentengeometrie im Boden der Restauration. Bereiche der Präparation, die kleiner als der Durchmesser der Instrumentengeometrie sind, werden im Boden der Restauration so berechnet, dass sie mit der Instrumentengeometrie vergrößert werden.	YES	YES	YES
Unterschnitte entfernen	Hinterschnitte innerhalb der Präparationsgrenze werden im Restaurationsboden ausgeblockt.	YES	YES	YES
<i>"Unterschnitte virtuell ausblenden"</i>	Wenn aktiv, wird der Präparationsrand im Falle von Unterschnitten abgehoben.	-	YES	-

Krone mit Schraubbefestigung

Parameter	Beschreibung	Standardwerte
Approximale Kontaktstärke	<ul style="list-style-type: none"> Stärke der approximalen Kontakte einstellen. Die Software versucht bei den Restaurationsvorschlägen, diese hinterlegte Stärke zu erreichen. 	25µm
Okklusale Kontaktstärke	<ul style="list-style-type: none"> Stärke der okklusalen Kontakte einstellen. Die Software versucht bei den Restaurationsvorschlägen, diese hinterlegte Stärke zu erreichen. 	25µm
Dynamische Kontaktstärke	<ul style="list-style-type: none"> Die Software versucht, falls in den Optionen (siehe „Artikulation [→ 58]“) aktiviert, bei den Restaurationsvorschlägen diese hinterlegte Stärke zu erreichen. 	25µm
Gingivale Tiefe	<ul style="list-style-type: none"> Bestimmt, wie weit unterhalb oder oberhalb der Präparationsrand die Gingiva in Bezug auf die Gingivalinie liegt. 	0µm
Druck auf Gingiva	<ul style="list-style-type: none"> Bestimmt, wie stark der Erstvorschlag des Abutments die Gingiva durchdringt, um Druck auf die Gingiva aufzubauen. 	0µm
Okklusaler Schleifoffset (Parameter kann in der Phase HERSTELLUNG gesetzt werden)	<ul style="list-style-type: none"> Material auf der gesamten Kaufläche in okklusaler Richtung auf- oder abtragen. Dieser Wert betrifft nur das Schleifergebnis. Die Auswirkungen sind in der Phase DESIGN und bei der Vorschau nicht sichtbar. Ändern Sie diesen Parameter als Ausgleich, wenn die Okklusalfächen Ihrer Restaurationen in der Praxis grundsätzlich zu hoch oder zu niedrig sind. 	0µm

Parameter	Beschreibung	Standardwerte
Mindeststärke (radial) (Materialabhängiger Parameter, kann nur im Schritt " <i>Restaurationsparameter</i> " der Phase DESIGN geändert werden)	<ul style="list-style-type: none"> Bestimmt die radiale Mindestwandstärke in horizontaler Richtung. Herstellervorgaben können geändert werden. 	Vorgabe des Materialherstellers
Mindeststärke (okklusal) (Materialabhängiger Parameter, kann nur im Schritt " <i>Restaurationsparameter</i> " der Phase DESIGN geändert werden)	<ul style="list-style-type: none"> Bestimmt die radiale Mindestwandstärke in okklusaler Richtung. Herstellervorgaben können geändert werden. 	Vorgabe des Materialherstellers

Abutment

Parameter	Beschreibung	Standardwerte
Gingivale Tiefe	<ul style="list-style-type: none"> Bestimmt, wie weit unterhalb oder oberhalb der Präparationsrand die Gingiva in Bezug auf die Gingivalinie liegt. 	0µm
Druck auf Gingiva	<ul style="list-style-type: none"> Bestimmt, wie stark der Erstvorschlag des Abutments die Gingiva durchdringt, um Druck auf die Gingiva aufzubauen. 	0µm
Schulterbreite	<ul style="list-style-type: none"> Breite der Schulter eines Abutments oder Teleskops. 	1000µm
Teleskopwinkel	<ul style="list-style-type: none"> Teleskopwinkel eines Abutments oder Teleskops. 	7°
Mindeststärke (radial) (Materialabhängiger Parameter, kann nur im Schritt " <i>Restaurationsparameter</i> " der Phase DESIGN geändert werden)	<ul style="list-style-type: none"> Bestimmt die radiale Mindestwandstärke in horizontaler Richtung. Herstellervorgaben können geändert werden. 	Vorgabe des Materialherstellers
Mindeststärke (okklusal) (Materialabhängiger Parameter, kann nur im Schritt " <i>Restaurationsparameter</i> " der Phase DESIGN geändert werden)	<ul style="list-style-type: none"> Bestimmt die radiale Mindestwandstärke in okklusaler Richtung. Herstellervorgaben können geändert werden. 	Vorgabe des Materialherstellers

Abutment mit Krone

Parameter	Beschreibung	Standardwerte
Spacer	<ul style="list-style-type: none"> • Raum für das Adhäsiv unter der Krone vergrößern oder verkleinern (nicht an der Präparationsgrenze). 	120 µm
Okklusaler Schleifoffset (Parameter kann in der Phase HERSTELLUNG gesetzt werden)	<ul style="list-style-type: none"> • Material auf der gesamten Kaufläche in okklusaler Richtung auf- oder abtragen. • Dieser Wert betrifft nur das Schleifergebnis. • Die Auswirkungen sind in der Phase DESIGN und bei der Vorschau nicht sichtbar. • Ändern Sie diesen Parameter als Ausgleich, wenn die Okklusalfächen Ihrer Restaurationen in der Praxis grundsätzlich zu hoch oder zu niedrig sind. 	0 µm
Approximale Kontaktstärke	<ul style="list-style-type: none"> • Stärke der approximalen Kontakte einstellen. • Die Software versucht bei den Restaurationsvorschlägen, diese hinterlegte Stärke zu erreichen. 	25 µm
Okklusale Kontaktstärke	<ul style="list-style-type: none"> • Stärke der okklusalen Kontakte einstellen. • Die Software versucht bei den Restaurationsvorschlägen, diese hinterlegte Stärke zu erreichen. 	25 µm
Dynamische Kontaktstärke	<ul style="list-style-type: none"> • Die Software versucht, falls in den Optionen (siehe „Artikulation [→ 58]“) aktiviert, bei den Restaurationsvorschlägen diese hinterlegte Stärke zu erreichen. 	25 µm
Mindeststärke (radial) (Materialabhängiger Parameter, kann nur im Schritt "Restaurationsparameter" der Phase DESIGN geändert werden)	<ul style="list-style-type: none"> • Die minimale Materialstärke an steilen Präparationswänden einstellen. • Die Software versucht bei der Berechnung der Restaurationsvorschläge, diese Materialstärke nicht zu unterschreiten. • Der Wert wird zusammen mit der okklusalen Mindeststärke in der Phase DESIGN als halbtransparente Haube auf der Präparation angezeigt. Dadurch werden Bereiche sichtbar, in denen die Mindeststärke beim Konstruieren unterschritten wird. 	Vorgabe des Materialherstellers
Mindeststärke (okkusal) (Materialabhängiger Parameter, kann nur im Schritt "Restaurationsparameter" der Phase DESIGN geändert werden)	<ul style="list-style-type: none"> • Die minimale Materialstärke an den nach okkusal gerichteten Flächen der Präparation einstellen. • Die Software versucht bei der Berechnung der Restaurationsvorschläge, diese Materialstärke nicht zu unterschreiten. • Ein hoher Wert kann zu einer flachen Morphologie führen, wenn tiefe Fissuren die Mindeststärke stark verletzen würden. • Beachten Sie bei der Einstellung der Mindeststärke die Empfehlungen des jeweiligen Materialherstellers. 	Vorgabe des Materialherstellers

Zwischenglied (Anatomisch)

Parameter	Beschreibung	Standard-Wert
Gingivaler Abstand	<ul style="list-style-type: none"> Raum zwischen Zwischenglied und Präparationsgeometrie/Gingiva. 	0
Lingualer Öffnungswinkel	<ul style="list-style-type: none"> Anstieg für den basalen Bereich des Zwischenglied in orale Richtung. 	0
Approximale Kontaktstärke	<ul style="list-style-type: none"> Stärke der approximalen Kontakte einstellen. Die Software versucht bei den Restaurationsvorschlägen, diese hinterlegte Stärke zu erreichen. 	25µm
Okklusale Kontaktstärke	<ul style="list-style-type: none"> Stärke der okklusalen Kontakte einstellen. Die Software versucht bei den Restaurationsvorschlägen, diese hinterlegte Stärke zu erreichen. 	25µm
Dynamische Kontaktstärke	<ul style="list-style-type: none"> Stärke der dynamischen okklusalen Kontakte definieren; wirkt nur bei Verwendung des virtuellen Artikulators. 	25µm
Durchdringungen außerhalb der Basislinie berücksichtigen	<ul style="list-style-type: none"> Zwischenglied-Gestaltung auch außerhalb der Basislinie an die Gingiva anpassen. 	-

Artikulator

Die voreingestellten Parameter sind Mittelwerte, die unverändert für eine mittelwertige Artikulation verwendet werden können. *"Full Range Dynamic Occlusion"* ist standardmäßig vorausgewählt und die aufgeführten Parameter sind ausgeblendet. Sollten Sie individuelle Parameter einstellen wollen, so deaktivieren Sie *"Full Range Dynamic Occlusion"*.

Parameter	Einstellung	Mittelwert
"Schenkel"	Schenkel des Bonwilldreiecks	105mm
"Basis"	Interkondylarabstand	100mm
"Balkwill-Winkel"	Balkwill-Winkel	23°
"Sagittale Gelenkbahnneigung links" und "Sagittale Gelenkbahnneigung rechts"	Sagittale Gelenkbahnneigung	35°
"Bennettwinkel links" und "Bennettwinkel rechts"	Bennett-Winkel	15°

Parameter	Einstellung	Mittelwert
"Unmittelbare Seitenverschiebung links" und "Unmittelbare Seitenverschiebung rechts"	Initiale Bennett-Bewegung	0 µm
"Restorationen einschließen"	Falls aktiviert, werden vorhandene Restaurationen so für die Berechnung des FGPs berücksichtigt, als wären sie bereits eingesetzt worden. Damit kann beispielsweise eine neu konstruierte Eckzahnführung für die anderen Restaurationen des Falls berücksichtigt werden.	YES

CEREC Guide-Bohrschablone

Parameter	Beschreibung	Standardwerte
Spacer	Abstand zwischen Auflagefläche auf der Restbeziehung und Innenseite des Schablonenkörpers.	60 µm

Präparationsanalyse

Parameter	Einstellung	Standardwerte
Toleranz	Distanz zwischen präpariertem Stumpf und Antagonist. Die Toleranz gibt den Bereich zwischen der Mindestmaterialstärke und dem eingestellten Standardwert an.	200 µm

3D-Modell

Parameter	Beschreibung	Standardwerte
Basishöhe	Höhe der Modellbasis	3 mm
Wandstärke	Mindestwandstärke	1 mm

5.2 Geräte



Über den Menüpunkt *"Geräte"* können alle angeschlossenen Geräte angezeigt und konfiguriert werden.

Ist ein Gerät unerreichbar, wird ein Warnsymbol anstatt eines Miniaturbildes angezeigt.

Geräte automatisch hinzufügen

Sie können mit der Funktion *"Nach neuen Geräten suchen"* weitere Geräte hinzufügen.



✓ Das Gerät ist am PC angeschlossen.

1. Betätigen Sie die Schaltfläche *"Nach neuen Geräten suchen"*.

↳ Alle am PC angeschlossene Geräte werden erkannt. Für neue Geräte werden Sie aufgefordert, einen Namen einzugeben.

2. Geben Sie für das neue Gerät einen Namen ein.

Geräte hinzufügen (manuell)

Sie können mit der Funktion *"Gerät hinzufügen (manuell)"* Geräte manuell hinzufügen. Dies ist zwingend notwendig bei Geräten, die nicht mit der maximalen Geschwindigkeit von 115200 Baud betrieben werden können. Dies betrifft Geräte mit langen Kabelverbindungen bzw. bei der Verwendung einiger Funkmodule (z.B. Futaba, 19200 Baud).



1. Betätigen Sie die Schaltfläche *"Gerät hinzufügen (manuell)"*.

2. Wählen Sie, ob das Gerät im Netzwerk oder seriell angeschlossen ist.

3. Netzwerk: Geben Sie die Netzwerkadresse ein.

Seriell: Geben Sie den COM-Port und die Baudrate ein.

4. Betätigen Sie die Schaltfläche *"Ok"*.

↳ Die Software versucht das Gerät zu kontaktieren.

Wenn die Verbindung fehlschlägt, überprüfen Sie die Verbindung. Fragen Sie gegebenenfalls einen qualifizierten Techniker.

5.2.1 Scanner

5.2.1.1 Scanner konfigurieren

Akustische Rückmeldung

Über die Auswahlbox "Ton:" können Sie die akustische Rückmeldung zur Aufnahme ein- oder ausschalten. Die Lautstärke können Sie über den Schieberegler einstellen. Sie haben die Möglichkeit zwischen 5 verschiedenen Tonvarianten auszuwählen.

Farbanalyse einschalten

1. Gehen Sie in der Software in das Systemmenü und klicken Sie auf die Schaltfläche "Konfiguration".
2. Betätigen Sie die Schaltfläche "Geräte".
3. Betätigen Sie die Schaltfläche "Omnicam" / "Primescan".
4. Wählen Sie die Option "Farberkennung" aus.
 - Sie können zwischen verschiedenen Farbsystemen ("Wahl des Shade Guide") wählen.
 - Sie können entscheiden, ob Sie in 14 Tagen benachrichtigt werden wollen, wenn die Farbkalibrierung erneut nötig ist.
 - Ist die Farbanalyse mit ihrem Scanner nicht möglich, erscheint eine entsprechende Meldung, die Farbkalibrierung ist dann ebenfalls nicht verfügbar.
5. Bestätigen Sie die Änderung unten mit "Ok".
6. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Farbkalibrierung" und führen Sie die Farbkalibrierung durch.

5.2.1.2 Scannereinstellungen zurücksetzen



- > Betätigen Sie die Schaltfläche "Scanner-Einstellungen zurücksetzen".
 - ↳ Die Einstellungen werden auf die Werkeinstellungen zurückgesetzt.

5.2.1.3 Scanner kalibrieren

Kalibrierten Scanner verwenden

Für das vom System angewendete Messverfahren muss ein kalibrierter Scanner verwendet werden. Der Scanner ist werkseitig kalibriert. Kalibrieren Sie dennoch den Scanner bei jeder Neuinstallation und nach jedem Transport.

Für die Kalibrierung steht Ihnen das mitgelieferte 3D-Kalibrierset zur Verfügung.

CEREC Omnicam / Omnicam: Um optimale Ergebnisse zu erzielen, muss der Scanner vor der Kalibrierung **15-20 Minuten** aufwärmen.

CEREC Primescan / Primescan : Um optimale Ergebnisse zu erzielen, muss der Scanner vor der Kalibrierung **2 Minuten** aufwärmen.

Kalibrieren Sie den Scanner in folgenden Fällen neu:

- nach Transport (Rüttelbelastung) beziehungsweise bei Erstinbetriebnahme,
- nach Lagerung in ungeheizten oder unklimatisierten Räumen (Temperaturunterschiede über 30°C / 85°F),
- bei Temperaturunterschieden über 15°C / 60°F zwischen der letzten Kalibrierung und dem Betrieb.
- Generell ist es richtig, bei Fehlern, die im Aufnahmeprozess auftreten (wie mangelhafte Bildqualität oder das Fehlen einer 3D-Vorschau), eine Kalibrierung durchzuführen. In vielen Fällen kann der Fehler bereits damit behoben werden.
- Da es sein kann, dass das System einmal unbewusst einer Schüttelbelastung ausgesetzt worden ist, sollte einmal im Monat eine Kalibrierung durchgeführt werden.

Kalibrierung starten

1. Gehen Sie in der Software in das Systemmenü und betätigen Sie die Schaltfläche "*Konfiguration*".
2. Betätigen Sie die Schaltfläche "*Geräte*".
3. Betätigen Sie die Schaltfläche "*Omnicam*" / "*Primescan*".
4. Betätigen Sie die Schaltfläche "*Kalibrieren*".
↳ Die Kameraansicht wird in einem Fenster dargestellt.
5. Geben Sie die 8-stellige Sirona-ID ein. Sie finden diese ID auf dem Aufkleber auf dem Kalibrierset (nicht für CEREC Primescan / Primescan erforderlich).

Scanner kalibrieren



1. Nehmen Sie die Schutzkappe vom Kalibrierset ab.
2. Montieren Sie das Kalibrierset bis zum Anschlag auf die Scannerspitze.
3. Fixieren Sie den Scanner mit einer Hand fest im Kalibrierset. Stellen Sie sicher, dass die äußere Schraube des Kalibriersets komplett nach rechts bis zu einem leichten Einrasten eingeschraubt ist.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche "OK".
 - ↳ Der Messvorgang wird gestartet.
 - ↳ Die Software fordert Sie auf, in die nächste Rastung zu drehen.



5. Drehen Sie die Schraube gegen den Uhrzeigersinn bis zur nächsten Einrast-Position.
6. Halten Sie den Scanner dabei still.
 - ↳ Die Software fordert Sie auf, in die nächste Rastung zu drehen.
7. CEREC Omnicam / Omnicam: Führen Sie die Schritte 5 und 6 insgesamt 11 Mal durch.
CEREC Primescan / Primescan: Führen Sie die Schritte 5 und 6 insgesamt 17 Mal durch.
 - ↳ Die Software teilt Ihnen den Fortschritt der Kalibrierung mit und informiert Sie, wenn der Vorgang abgeschlossen ist.
 - ↳ Sie werden aufgefordert, die Lage des Austrittsfensters zu messen.



Lage des Austrittsfensters messen

1. Montieren Sie die Unterseite des Kalibriersets auf die Scannerspitze.
 - ↳ Der Kalibriervorgang wird fortgesetzt.
 - ↳ Wenn die Kalibrierung abgeschlossen ist, wird die Meldung angezeigt, dass die Kalibrierung komplett ist.
3. Bestätigen Sie die Meldung mit der Schaltfläche "OK".
 - ↳ Der Scanner ist kalibriert.

Fehlermeldung beim Kalibrieren

Die Software teilt Ihnen mit, falls beim Kalibrieren ein Fehler aufgetreten ist. Wenn der Kalibriervorgang fehlerhaft war, starten Sie ihn neu.

Kalibrierung beenden

- ✓ Die Software meldet, dass die Kalibrierung erfolgreich abgeschlossen ist.
- > Betätigen Sie die Schaltfläche "OK".
 - ↳ Der Scanner ist kalibriert.

5.2.1.4 Farbkalibrierung

Allgemeine Hinweise

ACHTUNG

Fehlerhafte Farbanalyse

Die Farbanalyse kann durch starken Lichteinfall negativ beeinflusst werden und es kann zu abweichenden Ergebnissen führen.

- > Halten Sie den Scanner so, dass er sich nicht im direkten Strahlungsbereich einer extremen Lichtquelle (z. B. Behandlungsleuchte) befindet, bzw. nicht dem direkten Einfall von Sonnenstrahlen ausgesetzt ist.

Für die Farbanalyse muss ein farbkalibrierter Scanner verwendet werden.

ACHTUNG

Zur Farbkalibrierung beachten

Eine Farbkalibrierung darf erst mindestens 20 Minuten nach Systemstart / Aufbereitung durchgeführt werden.

Die Farbkalibrierung muss regelmäßig durchgeführt werden.

Der Scanner muss alle 2 Wochen farbkalibriert werden, um eine verlässliche Farbanalyse durchführen zu können. Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn der Scanner direkt vor der Aufnahme eines neuen Falles farbkalibriert wird.

Führen Sie eine Farbkalibrierung auch nach dem Wechsel einer Hülse/ Spiegelhülse durch.

Ein stark verkratztes Hülsenfenster darf für eine Farbanalyse nicht genutzt werden.

Farbkalibriereset lagern

Das Farbkalibriereset muss an einem trockenen und lichtgeschützten Ort in seiner Verpackung aufbewahrt werden. Es muss ein desinfizierter Scanner verwendet werden, da das Farbkalibriereset selbst nicht desinfiziert werden darf. Wenn sich Staub auf der Innenseite des Farbkalibrieresets ansammelt, so entfernen Sie diesen vorsichtig mit Hilfe von Druckluft.

Farbanalyse einschalten

1. Gehen Sie in der Software in das Systemmenü und klicken Sie auf die Schaltfläche "Konfiguration".
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Geräte".
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Omnicam" / "Primescan".
4. Wählen Sie die Option "Farberkennung" aus.
 - Sie können zwischen verschiedenen Farbsystemen ("Wahl des Shade Guide") wählen.
 - Sie können entscheiden, ob Sie in 14 Tagen benachrichtigt werden wollen, wenn die Farbkalibrierung erneut nötig ist.
5. Bestätigen Sie die Änderung unten mit "Ok".
6. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Farbkalibrierung" und führen Sie die Farbkalibrierung durch.

Scanner farbkalibrieren



ACHTUNG

Farbkalibriereset nur mit sauberem, trockenem Scanner CEREC Primescan / Primescan / CEREC Omnicam / Omnicam verwenden

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, muss der Scanner CEREC Primescan / Primescan / CEREC Omnicam / Omnicam vor der Farbkalibrierung sauber, desinfiziert und trocken sein.

- > Stellen Sie sicher, dass der Scanner CEREC Primescan / Primescan / CEREC Omnicam / Omnicam sauber, desinfiziert und trocken ist.

1. Nehmen Sie das Farbkalibriereset aus der Verpackung.
2. Scannen Sie mit dem Scanner CEREC Primescan / Primescan / CEREC Omnicam / Omnicam den QR-Code auf der Unterseite Ihres Farbkalibrieresets. Halten Sie dafür den Scanner CEREC Primescan / Primescan / CEREC Omnicam / Omnicam ruhig vor den QR-Code so, dass dieser vollständig im Bild zu sehen ist. Sollte der QR-Code etwas glänzend sein, dann halten Sie den Scanner etwas schräger, um Glanzlicht zu vermeiden und das Scannen des Codes zu vereinfachen. Ist der QR-Code erkannt worden, erscheint der nächste Schritt *"Bitte installieren Sie das Farbkalibrier-Set"*. Dieser Schritt des QR-Code-Scans wird bei der nächsten Farbkalibrierung übersprungen, dafür wird die Seriennummer des Farbkalibrieresets angezeigt. Stimmt diese nicht mit der Seriennummer überein, die auf Ihr Farbkalibriereset gedruckt ist, klicken Sie auf die Schaltfläche *"QR-Code erneut scannen"* und scannen Sie den neuen QR-Code ein.
3. Montieren Sie das Farbkalibriereset bis zum Anschlag auf die Scannerspitze.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche *"Ok"*.
 - ↳ Der Messvorgang wird gestartet. Bewegen Sie in dieser Zeit den Scanner CEREC Primescan / Primescan / CEREC Omnicam / Omnicam und das Farbkalibriereset nicht.
 - ↳ Die Software teilt Ihnen den Fortschritt der Kalibrierung mit und informiert Sie, wenn der Vorgang abgeschlossen ist.

Farbkalibrierung beenden

- ✓ Die Software meldet, dass die Farbkalibrierung erfolgreich abgeschlossen ist.
1. Klicken Sie auf die Schaltfläche *"Ok"*.
 - ↳ Der Scanner CEREC Primescan / Primescan / CEREC Omnicam / Omnicam ist jetzt farbkalibriert.
 2. Nehmen Sie das Farbkalibriereset von dem Scanner und legen Sie dies wieder in seine Verpackung zurück.

Fehlermeldung bei der Farbkalibrierung

Die Software teilt Ihnen mit, falls bei der Farbkalibrierung ein Fehler aufgetreten ist. Wenn die Farbkalibrierung fehlerhaft war, stellen Sie Folgendes sicher:

- das Farbkalibrierset ist staubfrei,
 - das Farbkalibrierset wurde richtig montiert,
 - das Austrittsfenster des Scanners CEREC Primescan / Primescan / CEREC Omnicam / Omnicam ist sauber.
- > Starten Sie danach die Farbkalibrierung erneut.

Verwenden Sie ein beschädigtes Farbkalibrierset nicht weiter, wenden Sie sich in diesem Fall an ihren Händler, um ein neues zu erwerben.

Austausch des Farbkalibriersets

ACHTUNG

Farbkalibrierset regelmäßig ersetzen

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, muss das Farbkalibrierset regelmäßig ersetzt werden.

- > Beachten Sie folgende Hinweise.

Beachten Sie, dass das Farbkalibrierset

- nur im Zusammenhang mit der Nutzung der Software CEREC 5 ≥ 5.x oder der Connect SW ≥ 5 verwendet werden kann.
- nur maximal 2 Jahre haltbar ist. Sie sehen das Ablaufdatum auf dem Boden des Farbkalibrierset-Behälters. Durch vorhergehende Lagerhaltung kann es sein, dass sich der Zeitraum für Ihre Verwendung auf unter 2 Jahre verkürzt hat.
- nach Anbruch des Behälters nur ein Jahr verwendet werden kann. Schreiben Sie das Datum des Anbruchs mit einem wasserfesten Stift auf den Deckel des Behälters hinter „Opened on _____“ und verwenden Sie es nach einem Jahr nicht mehr.

Nach Ablauf eines der beiden Zeiträume ist das Farbkalibrierset nicht mehr zu verwenden.

Vor Ablauf des Farbkalibriersets gibt Ihnen die Software die Information, dass das Farbkalibrierset mit einem neuen Set ausgetauscht werden muss.

Nach Ablauf des Farbkalibriersets gibt Ihnen die Software die Information, dass eine Farbanalyse nur auf Basis alter Kalibrierdaten durchgeführt wird.

Wenden Sie sich für den Ersatz des Farbkalibriersets an Ihren Händler.

5.2.1.5 Firmware aktualisieren

Über die Schaltfläche *"Firmware aktualisieren"* können Sie das Update der Scannersoftware direkt starten.

ACHTUNG

Das Firmware-Update ist für den Betrieb des Scanners in Verbindung mit der Software CEREC SW 5 zwingend notwendig. Wenn Sie die Phase AUFNAHME betreten, muss die Firmware aktualisiert werden. Das Firmware-Update dauert ca. zwei Minuten.

5.2.1.6 Einstellungen Scanner-Heizung (Omnicam)

Über die Schaltfläche *"Einstellungen Kamera-Heizung"* gelangen Sie in den Dialog für die Temperatureinstellungen des Scanners. Mit dem Schieber können Sie die Temperatur, mit der die Spiegelhülse des Scanners vorgeheizt wird, in fünf Stufen einstellen, um einem eventuellen Beschlagen der Optik entgegenzuwirken. Bestätigen Sie die Einstellung mit *"Ok"* oder verwerfen sie mit *"Abbrechen"*.



⚠ VORSICHT

Heiße Oberfläche!

Die beschichtete Saphirscheibe des Scanners wird in der Scannerablage vorgeheizt. Die Oberflächentemperatur der Spiegelhülse kann bei Entnahme des Scanners aus der Ablage bis zu 51°C betragen. Bei Berührung mit Haut oder Schleimhaut kann dies zu einem unangenehmen Wärmeempfinden führen. Haut und Schleimhäute erleiden bei diesen Temperaturen keine Schädigung.

Nach Entnahme des Scanners aus der Scannerablage sinkt die Temperatur der Spiegelhülse innerhalb weniger Minuten (< 5 Minuten) auf weniger als 43°C. Der Scanner ist daher für eine zeitlich unbegrenzte Anwendungsdauer im Patientenmund geeignet.

Wählen Sie ab einer Umgebungstemperatur von 30°C nur die drei unteren Stufen der Heizereinstellung.

5.2.2 Fertigungseinheit

5.2.2.1 Einstellungen bearbeiten

CEREC Primemill

Alle Einstellungen werden direkt am Gerät über die Touch-Schnittstelle vorgenommen.

CEREC MC / CEREC MC X / CEREC MC XL / CEREC MC XL Premium Package

Über den jeweiligen Menüpunkt können Sie folgende Einstellungen nachträglich ändern:

- Beschreibung (Namen)
- Verbindungseinstellungen
 - IP Einstellungen automatisch holen
 - IP Einstellungen manuell angeben
- Absaugung
 - Haken setzen, falls Trockenfräsen gewünscht wird. Hierfür muss eine separate Absaugeinheit angeschlossen sein.
- Set 1 aktiviert
 - Bei Fertigungseinheiten mit vier Motoren kann der erste Motorsatz durch Platzieren oder Entfernen des Hakens aktiviert oder deaktiviert werden.
- Set 2 aktiviert
 - Wenn der zweite, optionale Motorsatz eingebaut ist, muss der Haken hier gesetzt sein. Dieser zweite Satz kann auch durch Entfernen des Hakens deaktiviert werden.
- Barcode-Leser
 - Bei der Fertigungseinheit mit eingebautem Scanner (Option) muss

der Haken vor *"Barcode-Leser"* gesetzt sein.

- Bei einem nachträglichen Einbau des Scanners, muss Ihr Service-Techniker den Haken vor *"Barcode-Leser"* setzen.

- Externer Wassertank
 - Wenn der 25-Liter-Kanister (Option, Bestell-Nr. 60 56 217) angeschlossen ist und der Haken gesetzt ist, werden Sie erst zu einem späteren Zeitpunkt zum Wasserwechseln erinnert.
 - Diese Option ist nur für CEREC MC XL oder CEREC MC XL Premium Package verfügbar (nicht für CEREC MC und CEREC MC X).
 - Bei einem nachträglichen Einbau des 25-Liter-Kanisters, muss Ihr Service-Techniker den Haken vor *"Externer Wassertank"* setzen.
- Firmware-Aktualisierung
 - Die Schaltfläche ist nur sichtbar, falls die Firmware nicht aktuell ist.
 - Startet manuellen Upload der Firmware auf die Fertigungseinheit.

5.2.2.2 Kalibrieren

1. Betätigen Sie die Schaltfläche *"Kalibrieren"*.
2. Folgen Sie den Anweisungen der Software.

5.2.2.3 Instrumente wechseln

1. Betätigen Sie die Schaltfläche *"Instrumente wechseln"*.
2. Folgen Sie den Anweisungen der Software.

5.2.2.4 Service

- *"Starten Sie einen Reinigungsprozess."*
Mit dieser Option kann die Bearbeitungskammer des Geräts gereinigt werden.
- *"Wasserpumpe"*
Hier kann die Wasserpumpe aktiviert werden.
- *"Absaugung"*
Hier kann die Absaugung aktiviert werden.

5.2.2.5 Fertigungseinheit entfernen (Gerät löschen)

1. Betätigen Sie die Schaltfläche *"Gerät löschen"*.
2. Folgen Sie den Anweisungen der Software.

5.2.3 Ofen

5.2.3.1 Einstellungen bearbeiten

CEREC SpeedFire

Über diesen Menüpunkt können Sie folgende Einstellungen nachträglich ändern:

- Namen
- Verbindungseinstellungen
 - IP Einstellungen automatisch holen
 - IP Einstellungen manuell angeben

5.3 Einstellungen



Der Menüpunkt *"Einstellungen"* hat folgende Unterpunkte:

- *"ADA/FDI-Zahnschema"*
- *"Benachrichtigungen"*
- *"Sitzposition"*
- *"Hub-Einstellungen"*
- *"Patientendatenbank"*
- *"Automatisch speichern"*
- *"Sprache"*
- *"Werkzeuggrad"*
- *"Handhabung von Blöcken"*
- *"Automatischer Vorschlag für Präparations- rand"*
- *"Anfängliche Position Abstichstelle"*
- *"CEREC Primemill – Leistung"*
- *"Vereinbarung zur Qualitätsverbesserung"*

5.3.1 ADA/FDI Zahnschema



Über *"ADA/FDI-Zahnschema"* können Sie das Zahnschema einstellen:

- International (*"FDI-Zahnschema"*)
- USA (*"ADA-Zahnschema"*)

5.3.2 Benachrichtigungen



Bei der Nutzung der Software können Hinweise in Pop-Up-Fenstern erscheinen. Viele dieser Meldungen können deaktiviert werden durch Anklicken des Kontrollkästchens *"Diese Meldung nicht mehr anzeigen"*. Wenn dieses Kontrollkästchen bereits angewählt ist oder wenn ein neuer Nutzer die Software verwendet, können hier alle Benachrichtigungen zurückgesetzt werden. Durch Betätigen der Schaltfläche *"Zurücksetzen"* werden alle Hinweise wieder angezeigt.

5.3.3 Sitzposition



Hier können Sie die Position des Anwenders an die Sitzposition des Patienten anpassen.

Dabei wird die Ausrichtung von Oberkiefer und Unterkiefer auf dem Bildschirm und die Bewegungsrichtung der Kameraansicht festgelegt. Diese müssen mit der Sicht des Anwenders auf Oberkiefer und Unterkiefer des Patienten übereinstimmen.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- *"Immer daneben oder gegenüber"*
Der Anwender befindet sich beim Scannen von Oberkiefer und Unterkiefer neben oder gegenüber dem Patienten.
- *"Gegenüber für Unterkiefer, dahinter für Oberkiefer"*
Beim Scannen des Unterkiefers befindet sich der Anwender dem Patienten gegenüber. Beim Scannen des Oberkiefers befindet sich der Anwender hinter dem Patienten.
- *"Immer dahinter"*
Der Anwender befindet sich beim Scannen von Oberkiefer und Unterkiefer hinter dem Patienten.

5.3.4 Hub-Einstellungen



Im Menüpunkt *"Hub-Einstellungen"* können Sie Einstellungen zur Verbindung zum Server vornehmen. Die IP-Einstellungen können automatisch erfolgen oder manuell mit entsprechender IP-Adresse und -Port eingegeben werden.

Auf der rechten Bildschirmhälfte wird Auskunft über den Verbindungsstatus gegeben.

5.3.5 Patientendatenbank



Im Menüpunkt *"Patientendatenbank"* können Sie festlegen, wo Patientendaten und Fälle abgespeichert werden.

Sie haben die Möglichkeit Patienten und Fälle in der tabellarischen Patientenübersicht (erreichbar über die Startansicht) umzubenennen.

Sie können für diese Daten ein Verzeichnis festlegen. Dadurch können Sie zum Beispiel alle Daten auf einem gesicherten Server im Praxisnetzwerk sichern.

Sie können alternativ die Patientendaten mit der Sirona-SIDEXIS-Software verwalten und Fälle in der von SIDEXIS angelegten Datenbank ablegen.

Sie können einen Support-Container (*.zip) in der tabellarischen Patientenübersicht (erreichbar über die Startansicht) exportieren, der alle Daten für Problemanalyse beinhaltet: rst-Datei, Bilddaten, log-Dateien, etc.

5.3.6 Automatisch speichern



Wenn *"Automatisch speichern"* aktiviert ist, wird der geöffnete Fall regelmäßig nach der eingestellten Zeit gespeichert. Automatisches Speichern wird nur dann ausgeführt, wenn zum jeweiligen Zeitpunkt keine Benutzerinteraktion oder Berechnung läuft, um Verzögerungen zu vermeiden.

5.3.7 Sprache



Hier können Sie die Sprache der Software einstellen.

5.3.8 Werkzeugrad



Das Werkzeugrad kann aktiviert/deaktiviert werden.

5.3.9 Handhabung von Blöcken




Unter *"Konfiguration"* / *"Einstellungen"* / *"Handhabung von Blöcken"* können Sie wählen, ob die Blockgröße in der Phase HERSTELLUNG kleinstmöglich oder in der zuletzt verwendeten Größe gewählt werden soll.

5.3.10 Automatischer Vorschlag für Präparationsrand



Unter *"Konfiguration"* / *"Einstellungen"* / *"Automatischer Vorschlag für Präparationsrand"* können Sie wählen, ob der Schritt *"Präparationsrand zeichnen"* in der Phase MODELL automatisch durchgeführt werden soll.

5.3.11 Abstichstelle voreinstellen



Unter "Konfiguration" / "Einstellungen" / "Anfängliche Position Abstichstelle" können Sie die Abstichstellen verschiedener Zahn- oder Restaurationstypen initial voreinstellen.

Es wird zwischen Veneer, Prämolaren-Krone und Backenzahn-Krone unterschieden.

Wählen Sie jeweils eine der zwei Optionen pro Kategorie aus. Die aktive Option wird rechts in 3D-Ansicht dargestellt.

Die ausgewählte Abstichstelle wird verwendet, es sei denn, die Festigkeit erfordert eine andere Position.

Die Abstichstelle kann in der Phase HERSTELLUNG noch geändert werden.

5.3.12 CEREC Primemill-Leistung




Diese Option gilt nur für CEREC Primemill-Fertigungseinheiten und erfordert vier Fräswerkzeuge, die für den parallelen Fräsprozess verwendet werden.

Hier können Sie wählen, ob in der Phase HERSTELLUNG schnelles oder superschnelles Fräsen für kompatible Zirkonoxidblöcke in Monogröße angeboten wird.

Mit der Option "Super Schnell" können zwei Einstellungen für die Oberflächenqualität ausgewählt werden. Die Option "Hoch" bietet kürzeste Fräszeiten bei hoher Oberflächenqualität. Die Auswahl der Option "Sehr gut" führt zu glatteren Restaurationsoberflächen, jedoch mit etwas längeren Fräszeiten.

5.3.13 Vereinbarung zur Qualitätsverbesserung




Hier können Sie die wählen, ob Sie am Programm für Qualitätsverbesserung teilnehmen oder nicht.

Mit der Teilnahme am Programm für Qualitätsverbesserung stimmen Sie zu, dass anonyme Nutzungsdaten an Dentsply Sirona gesendet werden. Die gesendeten Daten dienen zur Qualitätsverbesserung der Software.

Um am Programm für Qualitätsverbesserung teilzunehmen, setzen Sie einen Haken bei "Ja, ich möchte an dem Verbesserungsprogramm teilnehmen."

5.4 App-Center (Anwendungen)



Über das App-Center (Anwendungen) haben Sie Zugang zu Apps (Applikationen) für unsere CAD/CAM-Produkte. Sie haben darüber Zugriff auf eine Webseite, auf der Ihnen die verfügbaren Apps angezeigt werden. Die Webseite enthält auch weitere Informationen, wo Sie die Apps herunterladen können.

6 Optionen

6.1 Artikulation

Artikulation verwenden:



Einstellung	Beschreibung
Aktivieren	Der Artikulator wird während der Konstruktion rechts in der Seitenpalette angezeigt. Er kann jederzeit für die Konstruktion der Restaurationen aktiviert werden.
Deaktivieren	Der Artikulator wird während der Konstruktion rechts in der Seitenpalette nicht angezeigt.

Artikulation für Erstvorschlag verwenden:

Einstellung	Beschreibung
JA	Durch Aktivieren des Artikulators werden die dynamischen Bewegungen des Unterkiefers aufgezeichnet und können dann beim Restaurationsdesign berücksichtigt werden. Dynamische Frühkontakte basierend auf den eingestellten Parametern werden dabei entweder durch visuelle Kontrolle nach Berechnung des Designvorschlages kontrolliert oder automatisch schon während der Berechnung des Designvorschlages vermieden (nach Aktivierung des Kontrollkästchens "Artikulation für Erstvorschlag verwenden:"). Die Parametereinstellungen können dabei entweder mittelwertig sein oder individuell (nach Vermessung am Patienten) in die Eingabeoberfläche übertragen werden.
NEIN	Der Erstvorschlag erfolgt nur unter Berücksichtigung der statischen Kontaktpunkte. Die dynamischen Kontakte werden farblich gekennzeichnet (okklusaler Kompass nach Schulz).

Full Range Dynamic Occlusion

Durch das Aktivieren der Funktion "Full Range Dynamic Occlusion" werden die Unterkiefer-Bewegungen nicht nur anhand der in der Eingabeoberfläche eingestellten Kiefergelenkparameter berücksichtigt, sondern es werden die Unterkiefer-Bewegungen aller innerhalb einer natürlichen „Bandbreite“ sinnvollen Parameterkombinationen simuliert. Dadurch können zusätzlich mehr mögliche dynamische Kontakte erfasst und in der Folge vermieden werden. Eine individuelle Erfassung der Kiefergelenkparameter entfällt dabei. Dieses Verfahren bietet sich vor allem für Seitenzahnrestaurationen an.

6.2 Smile-Design



Einstellung	Beschreibung
Aktivieren	Die Funktion Smile-Design steht in der Phase ADMINISTRATION / <i>"Indikationen"</i> für den jeweiligen Fall zur Verfügung und kann im Fenster unten links aktiviert werden.
Deaktivieren	Die Funktion Smile-Design wird in der Phase ADMINISTRATION nicht angeboten.

7 Systemmenü



Im Systemmenü stehen folgende Untermenüs zur Auswahl:

"Startansicht"	Zum Startfenster wechseln, um mit einem neuen Fall zu beginnen.
"Speichern"	Aktuell geöffneten Fall speichern.
"Speichern unter..."	Fall unter einem anderen Namen bzw. Zahnarzt speichern.
"Import"	Fall aus dem Dateisystem importieren.
"Export"	Aktuell geöffneten Fall exportieren.
"Applikation ausführen..."	App-Center aufrufen um Plug-ins zu starten.
"Sirona Connect"	Aktuellen Fall über das Connect Case Center-Portal verschicken.
"Connect-Chat"	Chatfenster von Connect Case Center öffnen.
"Lizenz-Manager"	Den Lizenz-Manager aufrufen.
"Konfiguration"	Hard- und Software konfigurieren.
"Fenstermodus"	Wechseln zwischen dem Vollbild- und Fenstermodus.
"CEREC beenden"	CEREC-Software schließen.

Systemmenü öffnen



- > Betätigen Sie die Schaltfläche am oberen linken Bildschirmrand.
 - ↳ Das Systemmenü wird eingeblendet.

Systemmenü schließen

- > Betätigen Sie die Schaltfläche am oberen linken Bildschirmrand.
oder
- > Bewegen Sie den Mauszeiger in den Bereich des Hauptfensters.
 - ↳ Das Systemmenü wird nach wenigen Sekunden geschlossen.

7.1 Fall speichern

In diesem Dialog können Sie den aktuellen Fall abspeichern.



- > Wählen Sie im Systemmenü "*Speichern*"
 - ↳ Der aktuelle Bearbeitungszustand des Falls wird gespeichert.

7.2 Fall speichern unter

In diesem Dialog können Sie den aktuellen Fall unter einem neuen Namen abspeichern oder einem anderen Patienten zuordnen.



1. Wählen Sie im Systemmenü "*Speichern unter*"
 - ↳ Die Patientenliste wird geöffnet.
2. Wählen Sie den gewünschten Patienten aus.
oder
 - > Legen Sie über "*Neuen Patienten hinzufügen*" einen neuen Patienten an.
3. In der Spalte "*Fall*" können Sie über das Stift-Symbol dem Fall einen neuen Namen geben.

7.3 Fall importieren



1. Betätigen Sie im Systemmenü die Schaltfläche "*Import*"
 - ↳ Das Dialogfenster "*Fall importieren...*" öffnet sich.
2. Wählen Sie den Ordner, in dem sich der Fall befindet.
3. Wählen Sie die Datei aus.
4. Betätigen Sie die Schaltfläche "*Öffnen*"
 - ↳ Der Fall wird importiert und geöffnet.
Je nach Art der Restauration wird nur der optische Abdruck geöffnet.

7.4 Fall exportieren

Sie können einen Fall an beliebiger Stelle abspeichern.

✓ Sie haben einen Fall in der Software geöffnet.

1. Betätigen Sie im Systemmenü die Schaltfläche *"Exportieren"*
↳ Das Dialogfenster *"Fall exportieren..."* öffnet sich.
2. Wählen Sie den Ordner, in den Sie den Fall exportieren wollen.
3. Geben Sie dem Fall einen beliebigen Namen.
4. Betätigen Sie die Schaltfläche *"Speichern"*.
↳ Der Fall wird im gewünschten Format exportiert.

Wenn Sie den optischen Abdruck auf einen anderen PC übertragen möchten, können Sie dazu einen USB-Stick oder ein Netzlaufwerk verwenden.



7.5 Scandaten exportieren

Sie können Scandaten als STL oder DXD exportieren, um Sie

- in der inLab SW, CEREC SW oder Connect SW (DXD) oder
- in einem anderen kompatiblen System (STL)

zu verarbeiten.

WICHTIG


Für die Weiterverarbeitung von *.stl-Daten in einer anderen/externen Software wird von Seiten der Dentsply Sirona keine Verantwortung übernommen.

7.6 Lizenzmanager

Der Lizenzmanager wird zum Aufspielen neuer Software-Lizenzen auf den USB-Lizenz-Stick genutzt. Zum Aufspielen starten Sie den Lizenzmanager über das Systemmenü und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Halten Sie Ihren Lizenzgutschein mit dem 25-stelligen Code bereit, den Sie entweder mit dem Gerät erhalten haben oder über Ihren Fachhändler separat bestellt haben.

Tipp: Sie können den Lizenzmanager auch über „Start / Alle Programme / Sirona Dental Systems / CEREC SW 5 / Tools / Lizenz-Manager“ starten.

Zum Aktivieren der Lizenz muss eine Internetverbindung bestehen und der USB-Lizenz-Stick muss aufgesteckt sein.



7.7 Konfiguration

Die Konfiguration ist im Kapitel „Konfiguration [→ 36]“ beschrieben.



7.8 Fenstermodus



Über die Funktion "*Fenstermodus*" können Sie den Vollbild-Modus verlassen oder wieder ausführen. Sie können den Fenstermodus auch über **F11** aktivieren bzw. deaktivieren.

7.9 Aktuelle Programmversion

Wenn Sie in der Phasenleiste auf den Schriftzug "*CEREC*" klicken, erhalten Sie Informationen zur aktuellen Programmversion.

7.10 Programm beenden



Über die Funktion "*CEREC beenden*" können Sie die Software schließen.

8 Startansicht



In der Startansicht können Sie folgende Funktionen ausführen:

- Patienten suchen,
- Patientendatenbank öffnen,
- Patienten anlegen,
- Das Connect-Portal öffnen,
- Aktionspunkte öffnen.

Zur Startansicht wechseln

Sie können jederzeit zur Startansicht wechseln.

1. Öffnen Sie das Systemmenü.
2. Betätigen Sie die Schaltfläche "Startansicht".




8.1 Neuen Patienten anlegen

In der Datenstruktur ist ein Patient eindeutig durch eine der beiden Eingaben identifiziert:

- Name, Vorname und Geburtsdatum
oder
- Patienten-ID
Tipp: Wir empfehlen unseren Kunden ausschließlich mit einer Referenznummer zu arbeiten. Bitte beachten Sie die für Sie gültigen Bestimmungen des Datenschutzes.

Patienten hinzufügen



1. Betätigen Sie die Schaltfläche *"Neuen Patienten hinzufügen"*.
↳ Eine leere Patientenkarte wird geöffnet.
2. Geben Sie Name, Vorname und Geburtsdatum ein. Während der Eingabe ist eine Echtzeit-Suchfunktion aktiv, die Doppelseinträge vermeiden soll.

oder

- Geben Sie die Patienten-ID ein.



3. Betätigen Sie die Schaltfläche *"Neuen Fall hinzufügen"*.
↳ Das Programm wechselt in die Phase *"ADMINISTRATION"*.

8.2 Patienten suchen

Alle Patienten anzeigen


Über *"Alle Patienten anzeigen"* werden alle Patienten angezeigt.



Einzelne Patienten suchen

Über die Suche können Sie einzelne Patienten anzeigen.

1. Tippen oder klicken Sie in das Textfeld der Suche.
2. Geben Sie den Namen oder die Patienten-ID ein und drücken Sie zum Starten die „Enter“-Taste auf der Tastatur.
 - ↳ Das Programm zeigt die zutreffenden Ergebnisse an.



8.3 Patientendaten bearbeiten

8.3.1 Patientenkarte bearbeiten

Patientendaten mithilfe der Patientenzeile ändern

- ✓ Sie haben den Patienten mit der Suche gefunden.

 1. Wählen Sie die Patientenkarte.
 2. Betätigen Sie das Stift-Symbol in der Patientenzeile.
 - ↳ Die Patientendaten in der Zeile werden editierbar.
 3. Führen Sie die Änderungen durch.
 4. Bestätigen Sie die Änderung, indem Sie den Haken betätigen.
 - ↳ Die Änderungen werden gespeichert.



Patientendaten mithilfe des Patientennamens in der Phasenleiste ändern

- ✓ Sie haben einen Fall geöffnet.

 1. Tippen oder klicken Sie im geöffneten Fall oben in die Phasenleiste auf den Patientennamen.
 2. Führen Sie die Änderungen durch.
 3. Bestätigen Sie in der Kontextleiste mit *"OK"* oder verwerfen Sie mit *"Abbrechen"*.

8.3.2 Patienten entfernen

- ✓ Sie haben den Patienten mit der Suche gefunden.

 1. Wählen Sie die Patientenkarte.
 2. Betätigen Sie das Mülleimer-Symbol in der Patientenzeile.
 3. Bestätigen Sie den Löschvorgang mit *"Ja"*.
 - ↳ Der Patient wird gelöscht.



8.3.3 Fall entfernen




- ✓ Sie haben den zugehörigen Patienten mit der Suche gefunden.
- 1. Wählen Sie den Patienten.
- 2. Wählen Sie den Fall aus.
- 3. Betätigen Sie das Mülleimer-Symbol in der Fallzeile.
- 4. Bestätigen Sie den Löschvorgang mit "Ja".
 - ↳ Der Fall wird gelöscht.

8.3.4 Fall öffnen



- ✓ Sie haben den zugehörigen Patienten mit der Suche gefunden.
- 1. Wählen Sie die Patientenkarte.
- 2. Wählen Sie den Fall aus.
- 3. Betätigen Sie in der Fallzeile die Schaltfläche "Fall öffnen". Alternativ können Sie auch auf die Fallzeile oder auf das Vorschaubild doppelklicken oder -klicken.
 - ↳ Der Fall wird geöffnet.

8.3.5 Neuen Fall hinzufügen




- ✓ Sie haben den zugehörigen Patienten mit der Suche gefunden.
- 1. Wählen Sie den Patienten aus.
- 2. Betätigen Sie oberhalb der Fallliste die Schaltfläche "Neuen Fall hinzufügen".
 - ↳ Das Programm wechselt in die Phase "ADMINISTRATION".

8.4 Restaurationstypen und Designmodus


8.4.1 Restaurationstypen





Einzelzahn-Restauration





Symbol	Restaurationstyp	Design-Modus
	Automatisches Erkennen von Krone oder Inlay/Onlay	<ul style="list-style-type: none"> • Biogenerik individuell • Biogenerik-Kopie • Kopieren & Spiegeln
-	Fehlt	Nicht angelegte Zähne bei geschlossenen Zahnreihen müssen als fehlend markiert werden.
	Krone	Krone, Inlay, Onlay werden automatisch erkannt. <ul style="list-style-type: none"> • Biogenerik individuell • Biogenerik-Kopie • Kopieren & Spiegeln
	Inlay/Onlay	Krone, Inlay, Onlay werden automatisch erkannt. <ul style="list-style-type: none"> • Biogenerik individuell • Biogenerik-Kopie
	Veneer	<ul style="list-style-type: none"> • Biogenerik individuell • Biogenerik-Kopie • Kopieren & Spiegeln

Brücken-Restauration







Symbol	Restaurationstyp	Design-Modus
	Krone	<ul style="list-style-type: none"> • Biogenerik individuell • Biogenerik-Kopie • Kopieren & Spiegeln
	Inlay/Onlay	<ul style="list-style-type: none"> • Biogenerik individuell • Biogenerik-Kopie
	Veneer	<ul style="list-style-type: none"> • Biogenerik individuell • Biogenerik-Kopie • Kopieren & Spiegeln
	Zwischenglied	<ul style="list-style-type: none"> • Biogenerik individuell • Biogenerik-Kopie • Kopieren & Spiegeln
-	Fehlt	Nicht angelegte Zähne bei geschlossenen Zahnreihen müssen als fehlend markiert werden.

Verbindertyp

Symbol	Restaurationstyp	Design-Modus
	Verbinder	<ul style="list-style-type: none"> • Durchdringung
	Verbinder	<ul style="list-style-type: none"> • Anatomisch


Abutment




Symbol	Restaurationstyp	Design-Modus
	Krone mit Schraubbefestigung	<ul style="list-style-type: none"> • Biogenerik individuell • Biogenerik-Kopie • Kopieren & Spiegeln
	Abutment	-
	Abutment mit Krone	<ul style="list-style-type: none"> • Biogenerik individuell • Biogenerik-Kopie • Kopieren & Spiegeln

CEREC Guide




Symbol	Indikation	Design-Modus
	CEREC Guide	<ul style="list-style-type: none"> • Implantat • Prothetische Planung


Modell

Symbol	Indikation	Design-Modus
	Modell	-
	Arbeitsmodell	via inLab-Model-App

Abdrucklöffel

Symbol	Indikation	Design-Modus
	Abdrucklöffel	via inLab-Splint-App

Schiene

Symbol	Indikation	Design-Modus
	Schiene	via inLab-Splint-App

8.4.2 Designmodus

Biogenerik individuell

Weitere Informationen finden Sie unter „Biogenerik individuell [→ 33]“.

Kopieren & Spiegeln

Weitere Informationen finden Sie unter „Kopieren und Spiegeln [→ 34]“.

Biogenerik-Kopie

Weitere Informationen finden Sie unter „Biogenerik-Kopie [→ 34]“.


Anatomisch / Durchdringung

Die Modi *"Anatomisch"* und *"Durchdringung"* sind nur für die Verbinder von Brücken vorhanden.




Anatomisch

Der Verbinder ist ein eigenes Element und kann bearbeitet werden.



Durchdringung

Der Verbinder entsteht durch die Durchdringung der Nachbarzähne. Er ist kein eigenes Element und kann daher nicht bearbeitet werden.




Abutment mit Krone

Mit diesem Verfahren wird die vollanatomische Form in eine hinterschnittfreie Mesostruktur und die darüber liegende Krone geteilt. Beide Teile können aus verschiedenen Materialien ausgeschliffen werden.

9 Werkzeuge und Funktionen der Seitenpalette

In der Seitenpalette werden Ihnen verschiedene Funktionen angeboten, abhängig vom aktuellen Schritt.

9.1 Werkzeuge

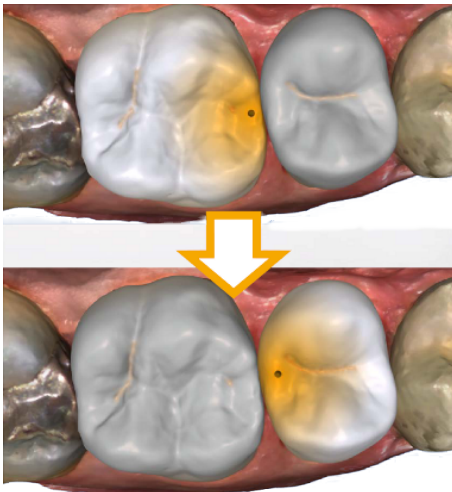

Tipp: Es ist ein automatischer Zahnwechsel bei der Verwendung der Werkzeuge auf mehreren Restaurationen möglich. Es ist keine Anwahl über den Restaurationsselektor oder per Klick notwendig.



Die Bildkataloge in der Aufnahme phase werden nach bereits erstellter Modellberechnung gesperrt, um ungewolltes Bearbeiten zu verhindern.



Sie können diese zur weiteren Bearbeitung wieder entsperren.

Es sind immer die Werkzeuge aktiv, die auf das aktive Restaurationselement angewendet werden können, die anderen Werkzeuge sind ausgegraut.

Die wichtigsten Werkzeuge werden Ihnen auch im Werkzeug-Rad angeboten. Weitere Informationen zum Werkzeug-Rad finden Sie im Abschnitt „Werkzeug-Rad [→ 73]“.

Sämtliche Werkzeuge finden Sie als Untermenü unter *„Werkzeuge“*. Sie bekommen pro Schritt die verfügbaren Werkzeuge angezeigt.

Um ein Werkzeug zu wechseln, klicken Sie in der linken Spalte der Seitenpalette auf die Schaltfläche eines anderen Werkzeugs.

Um ein Werkzeug zu beenden, klicken Sie in der linken Spalte erneut auf die Schaltfläche des aktiven Werkzeugs.

"Rückgängig" und "Zurücksetzen"




Mit der Schaltfläche *"Rückgängig"* in den Werkzeugen können Sie alle Änderungen seit dem Starten des Werkzeugs auf den selektierten Restaurationen zurücknehmen.



Mit der Schaltfläche *"Zurücksetzen"* in den Werkzeugen können Sie alle Änderungen seit dem Starten des Werkzeugs auf allen Restaurationen zurücknehmen.

9.1.1 Werkzeug-Rad

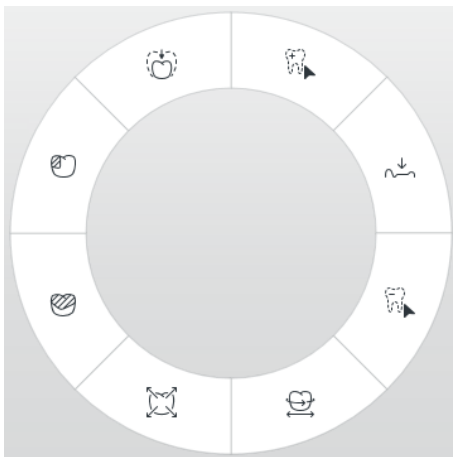

Das Werkzeug-Rad stellt die gängigsten Werkzeuge zur Verfügung, um die Zugriffe zu vereinfachen. Die zur Verfügung stehenden Werkzeuge sind abhängig vom aktuellen Schritt.

1. Tippen Sie lange mit dem Finger oder klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Arbeitsbereich.
 - ↳ Das Werkzeug-Rad wird geöffnet.
2. Tippen Sie lange mit dem Finger oder klicken Sie mit der rechten Maustaste an eine beliebige Stelle im Arbeitsbereich.
 - ↳ Das Werkzeug-Rad wird an die Position des Fingers oder Mauszeigers verschoben.
3. Wählen Sie ein Werkzeug.
 - ↳ Das Werkzeug steht zur Verfügung. Das Werkzeug-Rad schließt automatisch.

Sie können das Werkzeug auch schließen, indem Sie mit der linken Maustaste in den Arbeitsbereich klicken.

9.1.2 Bukkale Registrierung

(Phase "MODELL", Schritt "Bukkale Registrierung bearbeiten")

Bukkale Aufnahme korrigieren

Die bukkale Registrierung erfolgt automatisch. Falls sie nicht korrekt ist, können Sie sie manuell erzeugen.



✓ Das Werkzeug "Bukkales Bissregistrat" in der Seitenpalette ist angewählt.

1. Betätigen Sie die Schaltfläche "Zurücksetzen".

↳ Die bukkale Registrierung wird gelöst und Sie haben beide Kiefer und die bukkale Aufnahme getrennt auf dem Bildschirm.

2. Tippen Sie auf die bukkale Aufnahme und verschieben Sie diese auf den gleichen Bereich am Ober- oder Unterkiefer.

↳ Die Aufnahme wird akzeptiert.

Tipp: Wenn eine Aufnahme nicht akzeptiert wird, richten Sie den Kiefer zur bukkalen Aufnahme aus. Dadurch ist eine bessere Überlagerung möglich.

Wenn eine Registrierung auch weiterhin nicht möglich ist, prüfen Sie ob die bukkalen Anteile in den Kiefern und in der bukkalen Aufnahme ausreichend sind.

3. Wenn die Aufnahme akzeptiert wurde, verschieben Sie die Aufnahme auf den entsprechenden Bereich im Gegenkiefer.

Bukkalen Abdruck drehen

Mit der Funktion "Bukkalen Abdruck drehen" können Sie die bukkale Aufnahme drehen.

1. Betätigen Sie die Schaltfläche "Bukka".

2. Betätigen Sie die Schaltfläche "Bukkalen Abdruck drehen".

↳ Die bukkale Aufnahme wird gedreht.

9.1.3 Bukkale Bisswerkzeuge

Mit den folgenden Werkzeugen können Sie die Okklusion anpassen.


Kiefer bewegen

Mit der Funktion "*Kiefer ausrichten*" können Sie durch Positionieren und Rotieren des Oberkiefers den bukkalen Biss korrigieren.

- > Betätigen Sie die Schaltfläche "*Kiefer ausrichten*".
 - ↳ Das Rotieren/Positionieren Werkzeug wird eingeblendet.

9.1.4 Formen

(Phase "*DESIGN*", Schritt "*Restauration bearbeiten*").



Mit der Funktion "*Formen*" können Sie Material

- auftragen
- glätten
- abtragen

Die Eigenschaften "*Größe*" und "*Stärke*" können Sie mit einem Schieber oder numerisch im Voraus eingeben (siehe „Eigenschaften [→ 76]“).

Material auftragen



1. Betätigen Sie die Schaltfläche "*Formen*".
2. Betätigen Sie die Schaltfläche "*Auftragen*".
3. Tippen Sie mit dem Finger oder klicken Sie mit dem Mauszeiger auf die Stelle, die Sie verformen möchten.
4. Halten Sie gedrückt und tragen Sie Material auf die lokale Oberfläche auf, indem Sie den Finger oder die Maus bewegen.


Glätten



Beim Glätten können Sie die Oberfläche lokal glätten.

1. Betätigen Sie die Schaltfläche "*Formen*".
2. Betätigen Sie die Schaltfläche "*Glätten*".
3. Tippen Sie mit dem Finger oder klicken Sie mit dem Mauszeiger auf die Stelle, die Sie glätten möchten.
4. Halten Sie gedrückt und glätten Sie die lokale Oberfläche, indem Sie den Finger oder die Maus bewegen.

Material abtragen



1. Betätigen Sie die Schaltfläche "*Formen*".
2. Betätigen Sie auf die Schaltfläche "*Abtragen*".
3. Tippen Sie mit dem Finger oder klicken Sie mit dem Mauszeiger auf die Stelle, die Sie verformen möchten.
4. Halten Sie gedrückt und tragen Sie Material von der lokalen Oberfläche ab, indem Sie den Finger oder die Maus bewegen.

9.1.4.1 Eigenschaften

Größe verändern

5,00 mm



Sie können mit dem Schieber *"Größe"* die Größe des Einwirkungsbereichs verändern. Der Einwirkungsbereich wird als orangefarbene Fläche auf der aktuellen Restauration in der 3D-Vorschau dargestellt.

Die Größe des Einwirkungsbereichs lässt sich für jedes Formwerkzeug verändern.

1. Betätigen Sie den Schieber *"Größe"* und halten Sie diesen gedrückt.
2. Ziehen Sie den Schieber jetzt nach rechts oder links, um den Einwirkungsbereich zu vergrößern oder zu verkleinern.
 - ↳ Die orangefarbene Fläche (Einwirkungsbereich) wird in der 3D-Vorschau vergrößert bzw. verkleinert.

Tipp: Sie können auch die Größe des Einwirkungsbereiches verändern, indem Sie auf der Restauration mit der gedrückten rechten Maustaste die Maus nach oben oder unten bewegen.

Stärke verändern

Sie können mit dem Schieber *"Stärke"* die Intensität des Einwirkungsbereichs verändern. Die Stärke des Einwirkungsbereichs lässt sich für jedes Formwerkzeug verändern.

1. Betätigen Sie den Schieber *"Stärke"* und halten Sie diesen gedrückt.
2. Ziehen Sie den Schieber jetzt nach rechts oder links, um die Intensität zu erhöhen oder zu verringern.

Nachbarrestauration ausblenden

Sie können mit der Funktion *"Nachbarn ausblenden"* die Nachbarrestaurationen ausblenden. Diese Option steht nur zur Verfügung, solange der Kiefer eingeblendet ist.

9.1.5 Modellbereiche wegschneiden

(Phase "MODELL", Schritt "Modell bearbeiten")

WICHTIG

Diese Funktion ist aus Präzisionsgründen ausschließlich mit dem Trackball oder Touchpad bedienbar.



Mit der Funktion "Ausschneiden" können Sie Modellbereiche wegschneiden. Die weggeschnittenen Modellbereiche werden verworfen, sobald Sie den Schritt "Modell bearbeiten" verlassen. Sie können verworfene Bereiche später nicht mehr einblenden.

Modellbereich entfernen

Achten Sie beim Wegschneiden darauf, keine Bereiche versehentlich mit wegzuschneiden, die z.B. hinter dem Modell liegen oder anderweitig von der Linie geschnitten werden.

1. Betätigen Sie die Schaltfläche "Ausschneiden".
2. Starten Sie die Schnittlinie durch einen Doppelklick.
3. Betätigen Sie, um weitere Punkte zu setzen.
4. Schließen Sie den Schnitt durch einen Doppelklick ab.
 - ↳ Der Modellbereich wird abgeschnitten.

Modellbereich umkehren

Mit der Funktion "Auswahl umkehren" kann der weggeschnittene Modellbereich umgekehrt werden.

- ✓ Das Werkzeug "Ausschneiden" ist angewählt.
- ✓ Sie haben einen Schnitt erzeugt.
- > Betätigen Sie die Schaltfläche "Auswahl umkehren".
 - ↳ Der abgetrennte Modellbereich wird eingeblendet.
 - ↳ Der verbliebene Modellbereich wird ausgeblendet.

Tipp: Sie können den weggeschnittenen Modellbereich umkehren, indem Sie auf den halbtransparenten, weggeschnittenen Bereich doppelklicken.

9.1.6 Defekte korrigieren

(Phase "MODELL", Schritt "Modell bearbeiten")



Mit der Funktion "Ersetzen" können Sie Defekte und Artefakte am Modell (z. B. Löcher oder Erhebungen) korrigieren.

WICHTIG

Diese Funktion ist aus Präzisionsgründen ausschließlich mit dem Trackball oder Touchpad bedienbar.

Ziehen Sie dazu eine Linie um den Defekt in Ihrem Modell und wählen Sie die entsprechende Funktion.

1. Betätigen Sie die Schaltfläche "Ersetzen".
2. Setzen Sie den Anfangspunkt, indem Sie doppelklicken.
3. Tippen Sie, um weitere Punkte zu setzen und den Defekt eng zu umschließen. Die Linie muss vollständig auf dem Modell liegen.
4. Beenden Sie die Linie, indem Sie doppelklicken.
5. Betätigen Sie die Schaltfläche "Anwenden".
 - ↳ Die Software glättet durch Interpolation alles innerhalb der Linie.

9.1.7 Modell zurücksetzen

(Phase "MODELL", Schritt "Modell bearbeiten")

Mit der Funktion "Modell zurücksetzen" werden alle Änderungen zurückgesetzt.



1. Betätigen Sie die Schaltfläche "Modell zurücksetzen".
2. Bestätigen Sie mit "Anwenden".

9.1.8 Trimmen

(Phase "MODELL", Schritt "Trimmen")

WICHTIG

Diese Funktion ist aus Präzisionsgründen ausschließlich mit dem Trackball oder Touchpad bedienbar.



Mit der Funktion "Trimmen" können Sie die Präparation isolieren. Dadurch können Sie z. B. den Präparationsrand einfacher einzeichnen. Getrimmte Bildbereiche können später beliebig ein- und ausgeblendet werden.

Bildbereiche ausblenden

Die Trimmlinie kann auch über die Präparationslinie gelegt werden. Es wird dann automatisch nur der Bereich unterhalb der Präparation ausgeblendet, der präparierte Bereich bleibt vollständig erhalten.

1. Betätigen Sie die Schaltfläche "Trimmen".
2. Starten Sie in der Nähe des Modells oder auf dem Modell, indem Sie doppeltippen.
3. Tippen Sie, um weitere Punkte zu setzen. Führen Sie die Linie eng an der Präparation, um die Sie trimmen möchten.
4. Schließen Sie die Linie ab, indem Sie doppeltippen.
 - ↳ Der kleinere Bereich des Modells wird ausgeblendet.

Bildbereich umkehren

Mit der Funktion "Auswahl umkehren" kann der ausgeblendete Bildbereich umgekehrt werden.

- ✓ Ein Bildbereich wurde mit dem Werkzeug "Trimmen" ausgeblendet.
- Betätigen Sie die Schaltfläche "Auswahl umkehren".
 - ↳ Der ausgeblendete Bildbereich wird eingeblendet.
 - ↳ Der eingeblendete Bildbereich wird ausgeblendet.

Tipp: Sie können den ausgeblendeten Bildbereich umkehren, indem Sie auf den halbtransparenten, ausgeblendeten Bereich doppelklicken.

9.1.9 Präparationsrand zeichnen

(Phase MODELL, Schritt "*Präparationsrand zeichnen*")

Weitere Informationen zur Verwendung dieses Werkzeugs finden Sie im Abschnitt „Präparationsrand eingeben [→ 135]“.

WICHTIG

Diese Funktion ist aus Präzisionsgründen ausschließlich mit dem Trackball oder Touchpad bedienbar.

Automatische Kantendetektion

Mit "*Präparationsrand*" / "*Magnetisch*" können Sie mit der automatischen Kantendetektion arbeiten.

1. Betätigen Sie die Schaltfläche "*Präparationsrand*".
2. Betätigen Sie die Schaltfläche "*Magnetisch*".
 - ☞ Die automatische Kantendetektion wird eingeschaltet.

Manuelles Zeichnen

Mit "*Manuell*" können Sie die Präparationsgrenze manuell einzeichnen. Setzen Sie bei diesem Verfahren einzelne Punkt dicht beieinander, um den Verlauf der Präparationsgrenze in schwierigen Situationen selbst vorzugeben.

- ✓ Das Werkzeug "*Präparationsrand*" ist offen.
- Betätigen Sie die Schaltfläche "*Manuell*".
 - ☞ Das manuelle Verfahren wird eingeschaltet.

9.1.10 Basislinie auf Gingiva eingeben

(Im Implantat-Workflow)



Im Schritt "*Basislinie bearbeiten*" können Sie wählen, ob zur Berechnung des Emergenzprofils die Gingiva verwendet werden soll oder nicht.

Die Basislinie für Zwischenglieder kann auch auf der Gingiva eingegeben werden. Dazu muss die entsprechende Option "*Gingiva verwenden*" im Werkzeug aktiviert werden.

In diesem Schritt ist das Analysewerkzeug "*Intensitätsbild*" verfügbar, es kann über die Seitenpalette aktiviert werden.

9.1.11 Gingivamaske verwenden

Im Schritt "*Basislinie bearbeiten*" können Sie wählen, ob zur Berechnung des Emergenzprofils der entsprechende Bereich des Kieferscans übernommen werden soll. Für diesen Fall muss "*Gingivamaske verwenden*" aktiviert sein (Standardeinstellung). Um sich ein Emergenzprofil unabhängig vom Scan vorschlagen zu lassen, muss "*Gingivamaske verwenden*" deaktiviert werden.

Die Basislinie für Zwischenglieder kann auch auf der Gingiva eingegeben werden. Dazu muss die entsprechende Option im Werkzeug aktiviert werden.

9.1.12 Positionieren und Rotieren

(Phase "DESIGN", Schritt "Restauration bearbeiten").

Mit der Funktion "Positionieren" können Sie die Restauration verschieben, drehen und skalieren.

Verschieben und drehen

Mit dem Werkzeug "Positionieren und Rotieren" können Sie die Restauration verschieben und drehen.




Restauration verschieben und drehen

- > Betätigen Sie ein Pfeilsymbol und halten Sie es gedrückt.
 - ☞ Sie können die Restauration in die entsprechende Richtung verschieben oder rotieren.

Achsen ändern

- > Betätigen Sie mit der rechten Maustaste auf ein Pfeilsymbol und halten Sie die Taste gedrückt.
 - ☞ Sie können die Achse verändern, um die das Objekt gedreht oder geschoben wird.

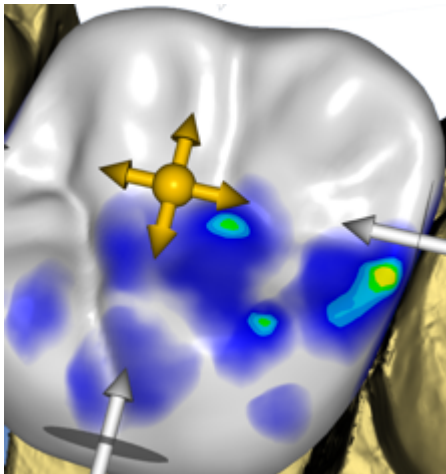

Skalieren

Mit der Funktion "Skalieren" können Sie die Größe der Restauration ändern. Der Wirkungsbereich wird als orangefarbene Fläche dargestellt.

1. Betätigen Sie die Schaltfläche "Positionieren".
2. Betätigen Sie die Schaltfläche "Skalieren".
3. Betätigen Sie den Pfeil für die gewünschte Skalierrichtung.
 - ↳ Der Pfeil wird orangefarben dargestellt.
4. Halten Sie gedrückt und ziehen Sie, um die Restauration zu vergrößern bzw. zu verkleinern.
 - ↳ Die Restauration wird in die entsprechenden Richtungen vergrößert bzw. verkleinert.

Darstellung	Auswirkung
	Betätigen Sie die Kugel in der Mitte, um die gesamte Restauration zu vergrößern und verkleinern.
	Vergrößern oder verkleinern Sie die Restauration in mesio-distaler Richtung, indem Sie den Pfeil betätigen und gedrückt haltend ziehen.
	Vergrößern oder verkleinern Sie die Restauration in bucco-lingualer Richtung, indem Sie den Pfeil betätigen und gedrückt haltend ziehen.
	Vergrößern oder verkleinern Sie die Restauration in die angezeigte Richtung, indem Sie den Pfeil betätigen und gedrückt haltend ziehen. Die Restauration wird dabei halbseitig vergrößert bzw. verkleinert.

9.1.13 Restaurationen neu berechnen

(Phase "DESIGN", Schritt "Restauration bearbeiten").

Mit dem Werkzeug "Neu berechnen" kann der Erstvorschlag neu berechnet werden.



1. Wählen Sie hierzu "Neu berechnen" und klicken Sie anschließend im Werkzeug auf "Neu berechnen".
2. Wenn Sie die Option "Nicht angepasst" anwählen, haben Sie die Möglichkeit die Restauration vor der Neuberechnung über das Werkzeug "Positionieren" / "Skalieren" auszurichten.
3. Klicken Sie anschließend auf "Neu berechnen" um den Vorgang abzuschließen.

9.1.14 Gestalten

(Phase "DESIGN", Schritt "Restauration bearbeiten").

Anatomisch

Mit der Funktion "Anatomisch" werden Bereiche der Morphologie, zum Beispiel Höcker oder die Fissurlinie, zum Gestalten vorselektiert.

Kreisförmig

Mit der Funktion "Kreisförmig" wird ein kreisförmiger Bereich zum Gestalten vorselektiert.

Mit der Funktion "Gestalten" können Sie einen ausgewählten Bereich verformen.

Sie können die Restauration auf 2 Arten verformen:



Funktion	Beschreibung
2 Richtungen	Die Bewegung ist entlang einer Achse orthogonal zur Restaurationsoberfläche möglich.
4 Richtungen	Die Bewegung ist entlang zweier Achsen parallel zur Restaurationsoberfläche möglich.

9.1.14.1 Eigenschaften

Größe verändern

Die Option steht nur bei der kreisförmigen Variante zur Verfügung.

Sie können mit dem Schieber "Größe" die Größe des Einwirkungsbereichs verändern. Der Einwirkungsbereich wird als orangefarbene Fläche auf der aktuellen Restauration in der 3D-Vorschau dargestellt.

1. Betätigen Sie den Schieber "Größe" und halten Sie diesen gedrückt.
2. Ziehen Sie den Schieber jetzt nach rechts oder links um den Einwirkungsbereich zu vergrößern oder zu verkleinern.
 - ↳ Die orangefarbene Fläche (Einwirkungsbereich) wird in der 3D-Vorschau vergrößert bzw. verkleinert.

Tipp: Sie können auch die Größe des Einwirkungsbereiches verändern, indem Sie auf der Restauration mit der gedrückten rechten Maustaste die Maus nach oben oder unten bewegen.

Nachbarrestauration ausblenden

Sie können mit der Funktion "Nachbarn ausblenden" die Nachbarrestaurationen ausblenden. Diese Option steht nur zur Verfügung, solange der Kiefer eingeblendet ist.

9.1.15 Biogenerische Variation

(Phase "DESIGN", Schritt "Restauration bearbeiten").



Mit der Funktion "Biogenerische Variation" können Sie verschiedene Varianten der möglichen Morphologie erzeugen.

1. Betätigen Sie den Schieber "Biogenerische Variation" und halten Sie diesen gedrückt.
2. Ziehen Sie den Schieber nach links oder rechts.
 - ↳ Die neue Morphologie wird als 3D-Vorschau angezeigt.
3. Wenn die mit der Morphologie zufrieden sind, lassen Sie den Schieber los.
 - ↳ Die neue Morphologie wird auf die aktuelle Restauration angewendet.

9.1.16 Reduzieren

(Phase "DESIGN", Schritt "Restauration bearbeiten", Voraussetzung: aktiviertes Pro-Modul).




Mit der Funktion "Reduzieren" können Sie eine Restauration anatomisch reduzieren. Sie können auch Teilreduktionen durchführen.

9.1.16.1 Kompletzt reduzieren

1. Betätigen Sie die Schaltfläche "Reduzieren".
2. Stellen Sie die Reduzierungsstärke über den Schieberegler ein. Der Wert wird sich für weitere Reduzierungen auch in anderen gemerkt.
3. Betätigen Sie auf "Anwenden" um die Reduzierung durchzuführen.
↳ Die Restauration wird um den eingestellten Wert reduziert.

Tipp: Sie können mehrere Zähne gleichzeitig reduzieren, indem Sie zuerst in der Seitenpalette die Funktion "Gruppieren" anwenden.

Tipp: Sie können vor der Reduzierung die Reduzierlinie editieren und so schnell und einfach Girlanden oder Rückenschutzplatten erzeugen.

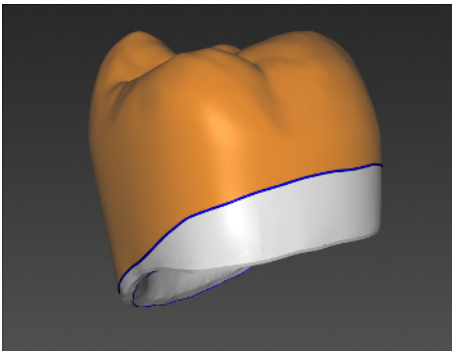

9.1.16.2 Teilweise Reduzieren

WICHTIG

Diese Funktion ist aus Präzisionsgründen ausschließlich mit dem Trackball oder Touchpad bedienbar.

1. Betätigen Sie die Schaltfläche "Reduzieren".
2. Doppeltippen Sie auf die Restauration und zeichnen Sie eine geschlossene Linie.
3. Stellen Sie die Reduzierungsstärke über den Schieberegler ein.
4. Betätigen Sie "Anwenden", um die Reduzierung durchzuführen.
↳ Die Restauration wird um den eingestellten Wert reduziert.

Tipp: Mit "Bereich wechseln" können Sie den zu reduzierenden Bereich umschalten. Dieser wird als orangefarbene Fläche dargestellt.

9.1.16.3 Eigenschaften

Minimalstärke beim Reduzieren berücksichtigen

Beim Werkzeug *"Reduzieren"* können Sie wählen, ob die Minimalstärke beim Reduzieren berücksichtigt werden soll.

- Wenn die entsprechende Option im Werkzeug angewählt ist, wird die Minimalstärke beim Reduzieren beachtet.
- Wenn die entsprechende Option im Werkzeug nicht angewählt ist, kann die Minimalstärke beim Reduzieren auch unterschritten werden.

Zwischenglied basal anheften

Wenn die Funktion *"Zwischengliedbasis auf Gingiva anheften"* aktiv ist, wird bei Vollreduktion die Basis des Zwischengliedes nicht mit reduziert.

Nachbarrestauration ausblenden

Sie können mit der Funktion *"Nachbarn ausblenden"* die Nachbarrestaurationen ausblenden. Diese Option steht nur zur Verfügung, solange der Kiefer eingeblendet ist.

9.1.17 Kontakte anpassen

(Phase *"DESIGN"*, Schritt *"Restauration bearbeiten"*).



Wenn Sie die Restauration verändern, verschieben sich auch die Kontaktflächen. Mit dem Werkzeug *"Kontakte anpassen"* werden die Kontakte wieder auf die in den Parametern eingestellte Stärke zurückgesetzt.

1. Betätigen Sie die Schaltfläche *"Kontakte anpassen"*.
2. Betätigen Sie die Schaltfläche *"Mesial"*, *"Distal"* oder *"Okklusal"*.
↳ Die jeweilige Kontaktfläche wird zurückgesetzt.

Nachbarrestauration ausblenden

Sie können mit der Funktion *"Nachbarn ausblenden"* die Nachbarrestaurationen ausblenden. Diese Option steht nur zur Verfügung, solange der Kiefer eingeblendet ist.

9.1.18 Abstichstelle anpassen

(Phase *"HERSTELLUNG"*)



Mit der Funktion *"Abstichstelle"* können Sie die Position der Abstichstelle auf der Restauration auf 2 Arten drehen:

- Schrittweise, durch Betätigen des Pfeils in dem Kreissegment.
- Stufenlos, indem Sie auf das Kreissegment oder innerhalb des Kreissegments drücken, gedrückt halten und den Finger oder die Maus bewegen.

9.1.19 Block verschieben

(Phase "HERSTELLUNG")

Verschieben



Mit der Funktion "Block verschieben" können Sie den Block um die Restauration in alle Raumrichtungen verschieben, bis die Restauration an eine der Blockgrenzen stößt.

Sie können den Block auf 3 Arten bewegen:

- Schrittweise, durch Betätigen einer der Pfeile, die auf dem halbtransparenten Würfel die Bewegungsachsen anzeigen.
- Stufenlos in 2 Richtungen, wenn Sie einen der Pfeile betätigen, gedrückt halten und den Finger oder die Maus bewegen.
- Stufenlos in alle 4 Richtungen, wenn Sie die Mitte einer Würfelfläche betätigen, gedrückt halten und den Finger oder die Maus bewegen.

Rotieren

Mit der Funktion "Block verschieben" haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, die Restauration um die Blockachse zu drehen.

Sie können die Restauration im Block auf 2 Arten drehen:

- Schrittweise, durch Betätigen des Pfeils im Kreissegment.
- Stufenlos, indem Sie auf das Kreissegment oder innerhalb des Kreissegments drücken, gedrückt halten und den Finger oder die Maus bewegen.

9.1.20 Inzisale Variation

(Phase "DESIGN", Schritt "Restauration bearbeiten").



Mit der Funktion "Inzisale Variation" können Sie Marmelons (vertikale Strukturen) und Wachstumslinien (horizontale Strukturen) auf Ihren Frontzahnrestaurationen erzeugen.

Stärke

Mit dem Schieber "Stärke" können Sie einstellen, mit welcher Intensität die ausgewählte Struktur auf eine Restauration wirkt.

Variation

Mit dem Schieber "Variation" können Sie den gewünschten Strukturtyp auswählen.

- Die Positionen 1 bis 4 stehen für Marmelons (vertikale Strukturen).
- Die Positionen 5 bis 6 stehen für Wachstumslinien (horizontale Strukturen)

Struktur positionieren

Haben Sie den Strukturtyp und die gewünschte Stärke eingestellt, so können Sie als Nächstes die Position der Struktur justieren.

1. Drücken oder klicken Sie dafür in der 3D-Vorschau auf Ihre aktuelle Frontzahnrestauration und halten Sie gedrückt.
 - ☞ Der Wirkungsbereich vom Werkzeug wird orangefarben eingefärbt.

2. Bewegen Sie nun die Maus, um die Struktur nach Ihren Vorstellungen zu positionieren.

Struktur anwenden

1. Sind Sie mit der erstellten Struktur zufrieden, betätigen Sie die Schaltfläche "Anwenden". Die erstellte Struktur wird jetzt gespeichert.

WICHTIG

Um mehrere Strukturen miteinander zu kombinieren, stellen Sie erst eine Struktur fertig und speichern Sie diese dann über die Schaltfläche "Anwenden".

2. Erstellen Sie nun weitere Strukturen und speichern Sie auch hier jede einzelne Struktur jeweils nach ihrer Fertigstellung.

9.1.21 Teilen

(Phase "DESIGN", Schritt "Restauration bearbeiten").



Mit der Funktion "Teilen" können Sie ein vollformatiges "Multilayer-Abutment" in ein Gerüst und eine Verblendstruktur aufteilen.

Mit der Funktion "Teilung aufheben" können Sie das Gerüst und eine Verblendstruktur eines Multilayer-Abutments wieder zusammenführen.

1. Wählen Sie die gewünschte Option "Teilen" oder "Teilung aufheben" über die betreffende Schaltfläche aus.
2. Betätigen Sie anschließend die Schaltfläche "Anwenden".
 - ↳ Das Multilayer-Abutment wird geteilt oder wieder zusammengeführt

9.1.22 Verbinder anpassen

(Phase "DESIGN", Schritt "Restauration bearbeiten").

Für die Gestaltung der Verbinder stehen verschiedene Werkzeuge zur Verfügung. Diese sind nur bei dem Verbindertyp "Anatomisch" anwendbar.

WICHTIG

Diese Funktion ist aus Präzisionsgründen ausschließlich mit dem Trackball oder Touchpad bedienbar.

Skalieren



Mit der Funktion "Verbinder verschieben" können Sie die Verbinder anpassen.

1. Betätigen Sie die Schaltfläche "Skalieren".
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über einen aktiven Verbinder.
 - ↳ Der Einwirkungsbereich wird orange dargestellt.
3. Drücken Sie die linke Maustaste und halten Sie sie gedrückt.
4. Bewegen Sie die Maus, um das Objekt zu verändern.

Wenn Sie die Option "Alles skalieren" angewählt haben, können Sie den gesamten Verbinder anpassen.

Positionieren

Mit der Funktion *"Verbinder verschieben"* kann der Verbinder umpositioniert werden.

1. Betätigen Sie die Schaltfläche *"Verschieben"*.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über einen aktiven Verbinder.
↳ Der Einwirkungsbereich wird orange dargestellt.
3. Drücken Sie die linke Maustaste und halten Sie sie gedrückt.
4. Bewegen Sie die Maus, um das Objekt zu verändern.


Wenn Sie die Option *"Alles positionieren"* angewählt haben, können Sie den gesamten Verbinder verschieben. Die benachbarten Elemente werden transparent dargestellt.

Nach dem Verschieben, werden die Anwachsstellen wieder angerechnet.

Linien editieren

Sie können die Linien eines Verbinders mit *"Linie ziehen"* verändern. Die benachbarten Elemente werden dabei transparent dargestellt.

1. Betätigen Sie auf die Schaltfläche *"Verbinderlinien"*.
↳ *"Linie ziehen"* ist automatisch aktiviert.
2. Fahren Sie mit der Maus über die angezeigte blaue Verbinderlinie.
↳ Ein Teilbereich wird gelb eingefärbt.
3. Ziehen Sie die Linien wie benötigt. Es wird immer der Linienteil verschoben, der gelb dargestellt wird.

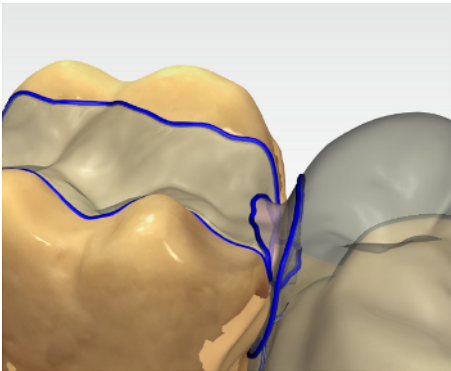

Sie können die Linien eines Verbinders mit *"Linie bearbeiten"* umzeichnen.

1. Betätigen Sie auf die Schaltfläche *"Verbinderlinien"*.
2. Betätigen Sie die Schaltfläche *"Linie bearbeiten"*.
3. Zeichnen Sie die Linie an den benötigten Stellen um, indem Sie mit einem Doppelklick auf der Linie starten.
4. Klicken Sie, um die Linie am entsprechenden Punkt festzusetzen.
5. Führen Sie die Linien so weiter fort, bis Sie mit einem Doppelklick an einem anderen Punkt der Ursprungslinie die Änderung beenden.

9.1.23 Modell bereinigen

(Phase DESIGN, Schritt *"Modellbasis bearbeiten"*)

Wenn Sie die Phase DESIGN bei der Indikation *"Modell"* betreten, wird Ihnen automatisch eine Basislinie vorgeschlagen. Diese können Sie mit dem Werkzeug *"Modellbasis bearbeiten"* anpassen.



1. Betätigen Sie die Schaltfläche *"Modell bereinigen"*.
2. Wählen Sie zwischen den Werkzeugen *"Ziehen"* und *"Bearbeiten"*.
Mithilfe des Werkzeugs *"Ziehen"* können Sie Segmente der Basislinie ziehen und verschieben. Mithilfe des Werkzeugs *"Bearbeiten"* können Sie neue Punkte/Segmente der Linie hinzufügen.

9.1.24 Modellhöhe festlegen

(Phase DESIGN, Schritt "Modellbasis bearbeiten")

Mit diesem Werkzeug können Sie die Höhe der Modellbasis bearbeiten.



1. Betätigen Sie die Schaltfläche "Modellhöhe festlegen".
2. Verwenden Sie den Schieberegler oder das Eingabefeld, um die Höhe der Modellbasis einzustellen.

9.1.25 Modell ausstechen

(Phase DESIGN, Schritt "Modellbasis bearbeiten")

Über das Kontrollkästchen können Sie einstellen, ob der Boden des Modells ausgestochen werden soll.



9.1.26 Beschriftung

(Phase DESIGN, Schritt "Modellbasis bearbeiten")

Mit diesem Werkzeug können Sie Textfelder auf der Modellbasis anbringen. Sie können dazu voreingestellte Texte wie z. B. "Patientenname" oder einen Freitext einfügen.









1. Betätigen Sie die Schaltfläche "Beschriftung".
2. Wählen Sie das Werkzeug "Beschriftung hinzufügen".
3. Ziehen Sie das Textfeld auf eine beliebige Fläche auf der Modellbasis



Sie können mehrere Textfelder anbringen. Die Texte können editiert werden, indem Sie das entsprechende Textfeld auswählen.

9.2 Objekte anzeigen

Mit diesen Funktionen können Sie Bereiche des Modells und der Restaurationen ein- und ausblenden.

1. Betätigen Sie die Schaltfläche "*Ansichtsoptionen*".
2. Betätigen Sie die jeweilige Schaltfläche.
 - ↳ Der betreffende Bereich wird ein- bzw. ausgeblendet.

	Mit der Schaltfläche " <i>Oberkiefer</i> " können Sie den Oberkiefer ein- und ausblenden.
	Mit der Schaltfläche " <i>Unterkiefer</i> " können Sie den Unterkiefer ein- und ausblenden.
	Sie können die Transparenz des Ober-/Unterkiefers stufenlos einstellen. <ol style="list-style-type: none"> 1. Betätigen Sie den Schieber vom "Ober -oder Unterkiefer" und halten Sie diesen gedrückt. 2. Ziehen Sie den Schieber jetzt nach rechts oder links um die Transparenz zu erhöhen oder zu verringern.
	Mit der Schaltfläche " <i>Mindeststärke</i> " können Sie die Darstellung der Mindeststärken ein- und ausblenden. Sie können die Mindeststärke unter " <i>Parameter</i> " einstellen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Parameter.
	Mit der Schaltfläche " <i>Restauration</i> " können Sie die Restauration ein- und ausblenden.
	Sie können die Transparenz der Restauration stufenlos einstellen. <ol style="list-style-type: none"> 1. Betätigen Sie den Schieber "<i>Restauration</i>" und halten Sie diesen gedrückt. 2. Ziehen Sie den Schieber jetzt nach rechts oder links um die Transparenz zu erhöhen oder zu verringern.
	Mit der Schaltfläche " <i>Getrimmtes Modell</i> " können Sie den getrimmten Bereich ein- und ausblenden.
	Mit der Schaltfläche " <i>BioKopie OK</i> " können Sie den Bereich der BioKopie Oberkiefer ein- und ausblenden (nur wenn entsprechender Bildkatalog Bilder enthält).
	Mit der Schaltfläche " <i>BioKopie UK</i> " können Sie den Bereich der BioKopie Unterkiefer ein- und ausblenden (nur wenn entsprechender Bildkatalog Bilder enthält).
	Mit der Schaltfläche " <i>Gingivamaske OK</i> " können Sie die Gingivamaske Oberkiefer ein- und ausblenden (nur wenn entsprechender Bildkatalog Bilder enthält).

	Mit der Schaltfläche " <i>Gingivamaske UK</i> " können Sie die Gingivamaske Unterkiefer ein- und ausblenden (nur wenn entsprechender Bildkatalog Bilder enthält).
	Mit der Schaltfläche Implantat können Sie Implantate ein- und ausblenden (nur Abutment).
	Mit der Schaltfläche TiBase können Sie den TiBase ein- und ausblenden (nur Abutment).
	Mit der Schaltfläche " <i>Modellbasis</i> " können Sie die Modellbasis ein- und ausblenden.


9.3 Analysewerkzeuge

Analysewerkzeuge aktivieren

- > Betätigen Sie die Schaltfläche "Analysewerkzeuge", um die Analysewerkzeuge zu aktivieren.

Farbiges Modell

Mit der Schaltfläche "farbiges Modell" können Sie bei Modellen, die mit dem Scanner aufgenommen wurden, die Modellfarbe umstellen.

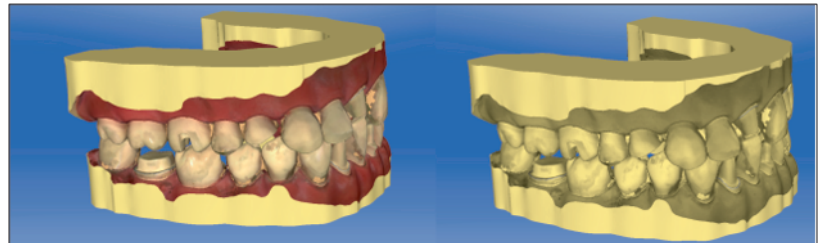

Kontaktflächen auf dem virtuellen Modell

Über die Schaltfläche "Modellkontakte" können die Kontaktflächen auf dem virtuellen Modell ein- oder ausgeblendet werden.

- > Betätigen Sie die Schaltfläche "Modellkontakte".
 - ↪ Die Kontaktflächen auf dem Modell werden ein- bzw. ausgeblendet.

Durchdringung/Druck:	■ > 100 µm
	■ 100 - 50 µm
	■ 50 - 0 µm
Distanz:	■ 0 - 50 µm
	■ 50 - 100 µm
	■ > 100 µm

Kontaktflächen auf der Restauration

Mithilfe der Farbpalette können Sie die okklusalen Kontaktpunkte der Kiefer überprüfen.

Es wird das gleiche Farbschema verwendet, wie auch bei Anzeige der Kontakte zu den Nachbarzähnen oder zum anderen Kiefer.

Durchdringung/Druck:	■ > 100 µm
	■ 100 - 50 µm
	■ 50 - 0 µm
Distanz:	■ 0 - 50 µm
	■ 50 - 100 µm
	■ > 100 µm

Kontakte

Über die Schaltfläche "*Kontakte*" können alle farbige dargestellten Kontaktpunkte der Restauration(en) des angezeigten Kiefers ein- und ausgeschaltet werden.

- > Betätigen Sie die Schaltfläche "*Kontakte*".
 - ↳ Die Restauration wird ohne bzw. mit den okklusalen Kontakten dargestellt.

Modellkontakte

Über die Schaltfläche "*Modellkontakte*" können alle farbige dargestellten Kontaktpunkte des gesamten Modells ein- und ausgeschaltet werden.

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Ober- und Unterkiefer gescannt wurden.

- > Betätigen Sie die Schaltfläche "*Modellkontakte*".
 - ↳ Die Restauration wird ohne bzw. mit den approximalen Kontakten dargestellt.

Seitenflächen und Boden

Über die Schaltfläche "*Modellbox*" kann das virtuelle Modell ohne Seitenflächen und ohne Boden dargestellt werden.

- > Betätigen Sie die Schaltfläche "*Modellbox*".
 - ↳ Das virtuelle Modell wird ohne Seitenflächen und ohne Boden dargestellt.

Tipp: Blenden Sie in der Phase HERSTELLUNG das jeweilige Kiefermodell ein und blenden Sie den Boden des Modells aus, um die Passform von allen Seiten zu überprüfen.

Dadurch können Sie die dicht versiegelte Präparationsgrenze kontrollieren und prüfen, ob Keramik durch die Präparation ragt. Dies ist ein Hinweis auf Stellen, bei denen die Restauration aufsitzen kann.

Restaurationsfarbe

Über die Schaltfläche "*Restaurationsfarbe*" kann die Restauration in der Modellfarbe dargestellt werden.

1. Betätigen Sie die Schaltfläche "*Restaurationsfarbe*".
 - ↳ Das virtuelle Modell wird weiß bzw. in der Modellfarbe dargestellt.
2. Betätigen Sie den Schieber "*Restaurationsfarbe*" und halten Sie diesen gedrückt.
3. Ziehen Sie den Schieber nach rechts oder links um die Restaurationsfarbe mehr oder weniger einzublenden.
 - ↳ Die Restaurationsfarbe des jeweiligen Objekts (oder Objektgruppe) wird verändert.



Schnitt (Phase HERSTELLUNG / DESIGN)


Über das Analysewerkzeug "*Schnitt*" wird durch die Restaurationen und das Modell ein Schnitt auf der Bildebene erzeugt.

1. Betätigen Sie die Schaltfläche "*Schnitt*".
 - ↳ Es wird ein Schnitt in der Bildebene durch das virtuelle Modell und alle Restaurationen erzeugt.
2. Betätigen Sie einen der Anfasser in der 3D-Vorschau und halten Sie diesen gedrückt. Durch das gleichzeitige Bewegen können Sie die Schnittebene in der Höhe verschieben oder die Schnittebene rotieren.

Cursordetails (Phase HERSTELLUNG / DESIGN)

Über die Schaltfläche "*Cursordetails*" können Sie die Höhe und Dicke der Restauration anzeigen lassen. Die Cursordetails werden unten links auf dem Bildschirm eingeblendet.

- > Betätigen Sie die Schaltfläche "*Cursordetails*".
 - ↳ Bedienen Sie per Touch, wird unter Ihrem Finger ein Präzisionszeiger angezeigt.

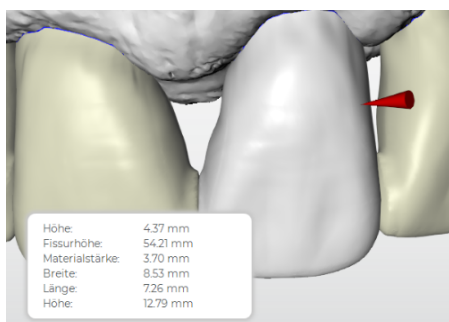

Je nach Art der Restauration werden folgende Informationen angezeigt:


Höhe	Abstand von diesem Punkt zum Boden des Modells
Fissurhöhe	Geringste Dicke in der Fissur
Materialstärke	Dicke der Restauration an der Cursorposition (Abstand zwischen den beiden Messpunkten: Eintrittspunkt in Blickrichtung und Austrittspunkt in Blickrichtung.)
Verbinder-Querschnitt	Fläche des Querschnitts
Breite	Gesamtbreite der Restauration
Länge	Gesamtlänge der Restauration
Höhe	Gesamthöhe der Restauration

Distanz

Über die Schaltfläche "*Distanz*" können Sie Distanzen messen.

1. Betätigen Sie die Schaltfläche "*Distanz*".
2. Tippen oder klicken Sie auf die Restauration um den Startpunkt festzulegen.
3. Tippen oder klicken Sie ein zweites Mal und/oder ziehen Sie den zweiten Anzeiger zum gewünschten Endpunkt.
 - ↳ Die Distanz wird angezeigt.

Rastermodus

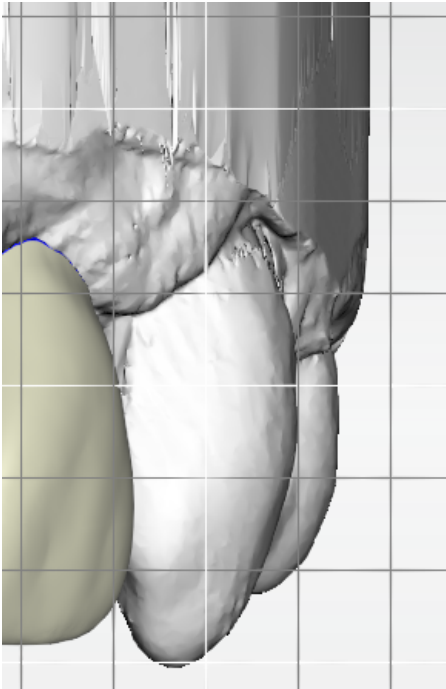

Mit der Funktion *"Rastermodus"* blenden Sie ein Gitter aus senkrechten und waagerechten Linien ein. Es dient als Orientierungshilfe.

- > Betätigen Sie die Schaltfläche *"Rastermodus"*.
 - ↳ Das Raster in der 3D-Vorschau wird eingeblendet.

Führungslinien

(Phase *"DESIGN"*, Schritt *"Restauration bearbeiten"*, SmileDesign aktiv)

Mit der Funktion *"Führungslinienmodus"* können Sie die Hilfsebenen des SmileDesigns ein- und ausblenden.

- > Betätigen Sie die Schaltfläche *"Führungslinienmodus"*.
 - ↳ Die Führungslinien in der 3D-Vorschau werden eingeblendet.

9.4 Falldetails

In der Anzeige der Restauration *"Falldetails"* können Sie während der Konstruktion alle Informationen zum Fall aufrufen (siehe auch Kapitel „Phase ADMINISTRATION [→ 98]“).

10 Phase ADMINISTRATION

10.1 Indikationen

Indikation auswählen


1. Legen Sie einen neuen Fall (siehe „Neuen Fall hinzufügen [→ 67]“) an.
2. Wählen Sie in der Seitenpalette die Indikation:
 - "Einzelrestauration",
 - "Brückenrestauration",
 - "Abutment",
 - "CEREC Guide" (siehe „Herstellung eines CEREC Guide 2 [→ 168]“ / „Herstellung eines CEREC Guide 3 [→ 174]“)
 - "Modell"
 - "Abdrucklöffel"
 - "Bisschiene"

Einzelzahn-Restauration

✓ Sie haben als Indikation "Einzelrestauration" gewählt.

1. Wählen Sie den Restaurationstyp.
 - ☞ Die zur Verfügung stehenden Restaurationstypen passen sich an die ausgewählte Zahnnummer an.
2. Wählen Sie den Designmodus.

Tipp: Informationen zu den Konstruktionsverfahren finden Sie im Abschnitt „Designmodus [→ 33]“.
3. Wählen Sie erst "Hersteller" und dann "Material" aus, um das gewünschte Material für die Restauration festzulegen. **Tipp:** Die letzten zwei verwendeten Materialien werden als Favoriten angezeigt.
 - Bei einigen Materialien sind die zwei Herstellungsarten möglich: Schleifen oder Fräsen.
 - Wenn mehrere Fertigungseinheiten verbunden sind, können Sie unter "Gerät" die entsprechende Fertigungseinheit bestimmen.
4. Wählen Sie den Zahn aus, für den die Restauration mit den eingestellten Angaben angelegt werden soll.
 - ☞ Der gewählte Zahn wird markiert.
5. Legen Sie gegebenenfalls weitere Restaurationen an.





Brücken-Restauration

- ✓ Sie haben als Indikation *"Brückenrestauration"* gewählt.
- 1. Bestimmen Sie den Restaurationstyp und den Verbindertyp, wie im Abschnitt „Einzelzahn-Restauration“ beschrieben.
- 2. Wählen Sie die Positionen der Pfeilerzähne der Brücke aus.
 - ↳ Die gewählten Zähne werden markiert.
- 3. Bestimmen Sie den Restaurationstyp und den Designmodus für die Zwischenzähne.
 - ↳ Die gewählten Zähne werden markiert.
- 4. Gehen Sie im Schrittmenü auf den Schritt *"Gerät"*, und wählen die gewünschte Fertigungseinheit aus.
- 5. Optional: Gehen Sie im Schrittmenü auf den Schritt *"Materialauswahl"*, um das gewünschte Material für die Restauration zu wählen.
- 6. Legen Sie gegebenenfalls weitere Restaurationen an.

Abutment

- ✓ Sie haben einen Fall ausgewählt oder neu angelegt.
- ✓ Sie befinden sich in der Phase ADMINISTRATION.
- 1. Wählen Sie die Indikation *"Abutment"*.
- 2. Wählen Sie den Restaurationstyp *"Abutment mit Krone"*.
- 3. Wählen Sie den Designmodus *"Biogenerik individuell"*.
- 4. Wählen Sie als Gerüstmaterial ein Material des gewünschten Herstellers aus, aus dem das Abutment gefertigt werden soll. **Tipp:** Die letzten zwei verwendeten Materialien werden als Favoriten angezeigt.
- 5. Wählen Sie als Verblendstruktur ein Material des gewünschten Herstellers aus, aus dem die Krone gefertigt werden soll.
- 6. Optional: Falls Sie mehrere Fertigungseinheiten verwenden, können Sie im Schritt *"Gerät"* wählen, welche Fertigungseinheit Sie für den Fall verwenden wollen.
- 7. Wählen Sie die gewünschte TiBase aus.

WICHTIG

Nicht alle TiBasen auswählbar

In Abhängigkeit vom gewählten Gerüstmaterial und für welches Land Ihre Installation aufgesetzt wurde, kann es sein, dass nicht alle TiBasen auswählbar sind.

- 8. Wählen Sie aus, ob Sie TiBase oder ScanPost zum Scannen verwenden.

WICHTIG

Bei intraoraler Anwendung: ScanPost empfohlen

Bei intraoraler Anwendung ist die Verwendung eines ScanPosts zu empfehlen, weil nur dann der korrekte Sitz des Scanbodys überprüft werden kann.

9. Wählen Sie den Zahn aus, für den die Restauration angelegt werden soll.
☞ Der gewählte Zahn wird markiert.

WICHTIG

Multilayer-Restaurationen können nur in Verbindung mit den Ti-Basen erstellt werden.

Modell

Sie haben als Indikation "*Modell*" gewählt.

1. Wählen Sie zwischen den Modellarten "*Modell*" und "*Arbeitsmodell*" das "*Modell*" aus.
2. Wählen Sie den Materialhersteller und das Material aus.
3. Wählen die gewünschte Herstellungsmaschine aus.
4. Wählen Sie den Kiefer aus, für den ein Modell mit den eingestellten Angaben angelegt werden soll.
☞ Der gewählte Kiefer wird markiert.

Es können keine weiteren Indikationen angelegt werden.

Arbeitsmodell

Sie haben als Indikation "*Modell*" gewählt.

1. Wählen Sie zwischen den Modellarten "*Modell*" und "*Arbeitsmodell*" das "*Arbeitsmodell*" aus.
2. Wählen Sie den Materialhersteller und das Material aus.
3. Wählen Sie den Kiefer aus, für den ein Arbeitsmodell mit den eingestellten Angaben angelegt werden soll.
☞ Der gewählte Kiefer wird markiert.
4. Legen Sie gegebenenfalls weitere Indikationen an.

Abdrucklöffel

Sie haben als Indikation "*Abdrucklöffel*" gewählt.

1. Wählen Sie den Materialhersteller und das Material aus.
2. Wählen Sie den Kiefer aus, für den ein Abdrucklöffel mit den eingestellten Angaben angelegt werden soll.
☞ Der gewählte Kiefer wird markiert.

Es können keine weiteren Indikationen angelegt werden.

Bisschiene

Sie haben als Indikation "*Bisschiene*" gewählt.

1. Wählen Sie den Materialhersteller und das Material aus.
2. Wählen Sie den Kiefer aus, für den eine Schiene mit den eingestellten Angaben angelegt werden soll.
☞ Der gewählte Kiefer wird markiert.

Es können keine weiteren Indikationen angelegt werden.

Indikation editieren

Sie können bereits angelegte Indikationen ändern.

1. Betätigen Sie die Indikation in der Objektleiste.
oder
Wählen Sie in der Seitenpalette "*Falldetails*" die betreffende Indikation an.
2. Betätigen Sie das Stift-Symbol, um in den Editiermodus zu gelangen.
3. Ändern Sie die gewünschten Angaben.
4. Bestätigen Sie die Änderungen mit dem Häkchen oder verwerfen sie mit dem Kreuz.



Phase ADMINISTRATION abschließen

- ✓ Alle anzulegenden Indikationen sind definiert.
- ✓ Die Phase AUFNAHME ist anwählbar.
- > Gehen Sie zu der Phase AUFNAHME.
oder
- > Betätigen Sie den Pfeil.
↳ Das Programm wechselt in die Phase AUFNAHME.



Falldetails

Nach dem Anlegen eines Falles werden alle Informationen in der Seitenpalette dargestellt.

Folgende Informationen können während der gesamten Konstruktion des Falles nachgelesen werden.

- Indikation
- Designmodus
- Material
- Fertigungseinheit
- Bei Brücken: die Indikation pro Element

10.2 Smile-Design

Mit Smile-Design können Frontzahnrestaurationen unter Berücksichtigung des Mundes bzw. Gesichtes des Patienten gestaltet werden.

Über das Analysewerkzeug kann während der Konstruktion zwischen dem Kiefermodell und der Ansicht mit Patient gewechselt werden.

Smile-Design aktivieren



Sie können in der Phase "ADMINISTRATION" unter "Indikationen" die Funktion "Smile-Design" aktivieren.

1. Gehen Sie unten links auf "Smile-Design".
2. Setzen Sie oben den Haken bei "Smile-Design".
↳ In den "Falldetails" wird die Funktion angeführt.
3. Sie können im selektierten Zustand die Funktion "Smile-Design" auch wieder deaktivieren, indem Sie den Haken entfernen.

In Smile-Design wechseln

- ✓ Sie haben die Modellachse im Schritt "Modellachse einstellen" in der Phase MODELL eingestellt.
- Betätigen Sie die Funktion "Smile Design initialisieren" in der Seitenpalette "Smile-Design" des rechten Bildschirmrandes.

Smile-Design verlassen

- ✓ Sie befinden sich im "Smile-Design".
- Betätigen Sie im Schrittmenu "Smile-Design beenden", um "Smile-Design" zu verlassen.

10.2.1 Referenzbild laden

Sie müssen für Smile-Design ein Bild des Patientengesichts laden. Das Bild muss ein frontales Passbild sein, auf dem der Patient lächelt.

Zugelassene Formate	Auflösung
<ul style="list-style-type: none"> • jpeg / jpg • bmp • png 	Mindestens 2 Megapixel

1. Betätigen Sie den Schritt "Referenzbild laden".
↳ Das Dialogfenster "Bild wählen" öffnet sich.
2. Wählen Sie den Ordner, in dem sich die Datei befindet.
3. Wählen Sie die Datei aus.
4. Betätigen Sie die Schaltfläche "Öffnen".
↳ Die Software wechselt in den Schritt "Feature-Punkte definieren".
↳ Das Bild wird importiert und geöffnet.

10.2.2 Referenzpunkte setzen

Im Schritt *"Feature-Punkte definieren"* müssen Sie die Referenzpunkte im Patientenbild setzen. Folgen Sie dabei den Anweisungen der Software. Die gelbe Markierung im Avatarbild zeigt Ihnen, wo der nächste Gesichtspunkt gesetzt werden muss.

Wenn automatisch eine Lupe eingeblendet wird, müssen Sie den Punkt möglichst genau setzen.

Über *"Rückgängig"* können Sie einzelne Schritte zurück gehen.

Sobald alle Referenzpunkte gesetzt wurden, erscheint keine weitere Markierung und die nächsten Schritte werden aktiv. Wechseln Sie eigenständig in den Schritt *"Lateraler Augenwinkelabstand"*.

10.2.3 Abstand der Canthi anpassen

Messen Sie den Abstand zwischen den beiden Canthi-Punkten mit einem geeigneten Messinstrument. Wechseln Sie in den Schritt *"Lateraler Augenwinkelabstand"*.

Passen Sie den Wert über den Schieberegler an.

WICHTIG

Sie müssen diesen Schritt durchführen, um ein 3D-Gesichtsmodell mit dem Kiefer exakt zu korrelieren.

10.2.4 Kiefer ausrichten

Richten Sie das Modell an dem Bild aus.

Modell positionieren


- > Betätigen Sie ein Pfeilsymbol und halten Sie dieses gedrückt.
 - ↪ Sie können das Modell in die entsprechende Richtung verschieben oder rotieren.

Verwenden Sie die Perspektive *"Links"* oder *"Rechts"* oder drehen Sie das Gesichtsmodell seitlich über die Ansichtsoptionen *"Global"*. Dadurch können Sie das Gesichtsmodell und das Kiefermodell exakt ausrichten.

Achsen ändern

- > Betätigen Sie ein Pfeilsymbol und halten Sie dieses gedrückt.
 - ↪ Sie können die Achse verändern, um die das Objekt gedreht oder geschoben wird.


10.2.5 Hilfsebenen

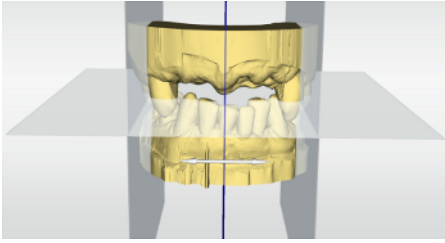

Im Schritt "*Leitlinie*" können Sie Hilfsebenen einblenden. Die Hilfsebenen erleichtern das Positionieren des Kiefers im Patientenbild.

Sie können die Ebenen auch für die Konstruktion einblenden.

1. Tippen oder klicken Sie doppelt auf die Ebene, die Sie anpassen möchten.
2. Passen Sie die Ebene mit den Pfeilen an.

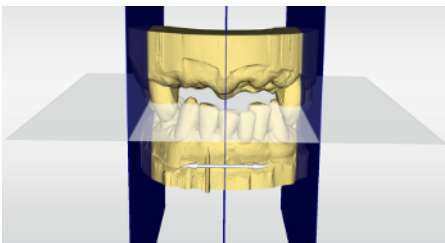

Ebene positionieren


- > Tippen oder klicken Sie auf das Pfeilsymbol und halten Sie dieses gedrückt.
 - ↳ Sie können die Ebene in die entsprechende Richtung verschieben.

Wenn Sie nur eine Ebene verschieben möchte, entfernen sie den Haken bei "*Hilfslinien gruppieren*". Sie können die Ebenen aktivieren, indem Sie darauf doppelklicken oder -klicken.

10.3 Artikulation

Um die Funktion "Artikulation" angezeigt zu bekommen, müssen Sie in der "Konfiguration" unter den "Optionen" den Artikulator aktiviert haben. Dieser wird dann in der Phase ADMINISTRATION zusätzlich in der Seitenpalette "Falloptionen" angezeigt.

Hier können Sie für den aktuell geöffneten Fall die Verwendung des Artikulators aktivieren.

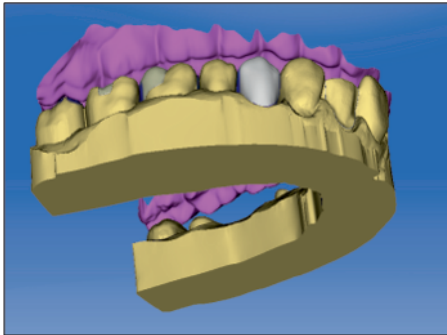

Mit der Funktion "Artikulation" können Sie eine Restauration unter Berücksichtigung der Dynamik gestalten.

Nach der Berechnung des Erstvorschlages werden die dynamischen Kontaktpunkte farbig angezeigt.

Für ein möglichst genaues Ergebnis ist es wichtig, muss die Aufnahme des Kiefers folgende Bedingungen erfüllen:

- Die Eckzahnführung ist auf beiden Seiten durchführbar.
- Beim Einstellen der Modellachse richten Sie das virtuelle Modell präzise an den Führungslinien aus.

Der virtuelle Artikulator benutzt als Bezugsebene für die Artikulationsparameter die Campersche Ebene. Die Campersche Ebene steht in der Regel parallel zur Okklusalebene.

Nach Einstellen der Modellachse können Sie den virtuellen Artikulator jederzeit über die Schaltfläche in der Seitenpalette aktivieren.



Full Range Dynamic Occlusion

Durch das Aktivieren der Funktion "Full Range Dynamic Occlusion" werden die Unterkiefer-Bewegungen nicht nur anhand der in der Eingabeoberfläche eingestellten Kiefergelenksparameter berücksichtigt, sondern es werden die Unterkiefer-Bewegungen aller innerhalb einer natürlichen „Bandbreite“ sinnvollen Parameterkombinationen simuliert. Dadurch können zusätzlich mehr mögliche dynamische Kontakte erfasst und in der Folge vermieden werden. Eine individuelle Erfassung der Kiefergelenksparameter entfällt dabei. Dieses Verfahren bietet sich vor allem für Seitenzahnrestaurationen an.

WICHTIG

Verwenden Sie zum Einstellen der Modellachse den Unterkiefer.

Artikulationsparameter



Die Werte für die Artikulation gelten nur für die aktuelle Restauration. Sie können die Einstellungen überall in den Phasen "MODELL" und "DESIGN" anpassen.

1. Betätigen Sie die Schaltfläche "Artikulation".
2. Betätigen Sie die Schaltfläche "Artikulationsparameter".
 - ↳ Die Artikulationsparameter werden eingeblendet.

Sie können die folgenden Werte individuell einstellen:

Parameter	Einstellung	Mittelwert
"Schenkel"	Schenkel des Bonwilldreiecks	105mm
"Basis"	Interkondylarabstand	100mm
"Balkwill-Winkel"	Balkwill-Winkel	23°
"Sagittale Gelenkbahnneigung links" und "Sagittale Gelenkbahnneigung rechts"	Sagittale Gelenkbahnneigung	35°
"Bennettwinkel links" und "Bennettwinkel rechts"	Bennett-Winkel	15°
"Unmittelbare Seitenverschiebung links" und "Unmittelbare Seitenverschiebung rechts"	Initiale Bennett-Bewegung	0µm
"Restaurationen einschließen"	Falls aktiviert, werden vorhandene Restaurationen so für die Berechnung des FGPs berücksichtigt, als wären sie bereits eingesetzt worden. Damit kann beispielsweise eine neu konstruierte Eckzahnführung für die anderen Restaurationen des Falls berücksichtigt werden.	YES

Functionally Generated Path (FGP)

Über die Funktionen "*Unterer virtueller FGP*" und "*Oberer virtueller FGP*" können Sie einen virtuellen FGP für den Gegenkiefer bzw. den Kiefer einblenden. Die Hülle stellt dabei die maximale Bewegung des jeweiligen Kiefers für die gewählten Artikulationsparameter dar.

Die Störkontakte werden durch das FGP angezeigt. Die Störkontakte können über die Werkzeuge entsprechend entfernt werden.

Unterer virtueller FGP



1. Betätigen Sie die Schaltfläche "*Artikulation*".
2. Betätigen Sie die Schaltfläche "*Unterer virtueller FGP*".
↳ Der virtuelle FGP wird angezeigt.

Oberer virtueller FGP



1. Betätigen Sie die Schaltfläche "*Artikulation*".
2. Betätigen Sie die Schaltfläche "*Oberer virtueller FGP*".
↳ Der virtuelle FGP wird angezeigt.

11 Phase AUFNAHME

11.1 Bildkataloge

In der Phase "AUFNAHME" werden im Standard 3 Bildkataloge angeboten:

- Unterkiefer
- Oberkiefer
- Bukkal



Zusätzlich können weitere Bildkataloge eingeblendet werden:

- BioKopie UK (Unterkiefer)
- BioKopie OK (Oberkiefer)
- Gingivamaske UK (Unterkiefer)
- Gingivamaske OK (Oberkiefer)
- Scanbody UK (Unterkiefer)
- Scanbody OK (Oberkiefer)

Es wird für jeden dieser Bildkataloge nur eine Aufnahme im entsprechenden Bildkatalog abgespeichert.

Bildkatalog öffnen

1. Wählen Sie das Symbol des gewünschten Bildkataloges.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger an den unteren Bildschirmrand.
 - ↳ Der aktive Bildkatalog wird geöffnet, die 3D-Aufnahme ist sichtbar.


Initial ist der notwendige Bildkatalog ausgewählt, sofern sich die Restauration(en) nur in Ober- oder Unterkiefer befinden.

Wenn Sie die Phase AUFNAHME verlassen und später zu dieser zurückkehren, sind alle Aufnahmen initial gesperrt.

Aufnahmen löschen

Sollte eine Aufnahme nicht gefallen, können Sie die Aufnahme löschen. Sie können dann eine neue Aufnahme für den entsprechenden Bildkatalog durchführen.

1. Selektieren Sie das Bild im Bildkatalog.
2. Drücken Sie auf "Löschen".
 - ↳ Die Aufnahme wird gelöscht.



11.2 3D-Vorschau

Standardmäßig werden die Daten in der 3D-Vorschau aus okklusaler Richtung dargestellt.

Die Betrachtungsrichtung des virtuellen Modells im 3D-Vorschaufenster können Sie durch Interaktion mit den Fingern oder der Maus frei wählen.

Tipp: Sie können zwischen den Bildkatalogen wechseln, indem Sie sie mittels Maus/Touchpad oder Doppelklick mit dem Fußschalter anwählen.

11.3 Aufnahme durchführen

11.3.1 Modus

Schritt Video / Foto

In dem Schritt *"Video"* / *"Foto"* können mit dem Scanner intraorale Videos und einzelne Intraoralbilder gemacht werden.

Fotos aufnehmen

1. Gehen Sie im Schrittmnü auf *"Video / Bild"*.
2. Wählen Sie die Option *"Foto"*.
3. Betätigen Sie zum Auslösen des Scanners die Schaltfläche oder nutzen Sie den Fußschalter.



Videos aufnehmen

1. Gehen Sie im Schrittmnü auf *"Video / Bild"*.
2. Wählen Sie die Option *"Video"*.
3. Betätigen Sie die Schaltfläche zum Starten der Videoaufnahme oder nutzen Sie den Fußschalter.
4. Stoppen Sie die Aufnahme durch das wiederholte Betätigen der Schaltfläche oder erneute Betätigung des Fußschalters.



Fotos und Videos ansehen

1. Wählen Sie die Schaltfläche mit dem Ordner-Symbol *"Ansicht"*.
2. Benutzen Sie den Links- oder Rechtspfeil, um alle gemachten Aufnahmen zu sehen. Videos können durch Betätigen des Wiedergabe-Symbols gestartet werden.
Tipp: Betätigen Sie in den Aufnahmemodi die rechte Schaltfläche mit dem Ordner-Symbol, um direkt aus dem Aufnahmemodus in die Medienansicht zu wechseln.

11.3.2 CEREC Omnicam, Omnicam

11.3.2.1 Aufwärmzeit des Scanners

Wenn Sie das System einschalten, muss der Scanner 15 - 20 Minuten aufwärmen. Ist die beschichtete Saphirscheibe des Scanners nicht warm genug, beschlägt sie während der Aufnahme. Dies erschwert die Erstellung einer Aufnahme.

Legen Sie den Scanner nach Gebrauch immer auf die Heizerplatte, beziehungsweise in die Scannerablage ab.

Sie können die Endtemperatur einstellen, auf die der Scannerheizer die Spiegelhülse des Scanners erwärmt.

1. Gehen Sie in der Software in das Systemmenü und klicken Sie auf die Schaltfläche "*Konfiguration*".
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche "*Geräte*".
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche "*Omnicam*".
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche "*Einstellungen Kamera-Heizung*".
5. Verändern Sie mit dem Schieberegler die Temperatur.

11.3.2.2 Scannerführung

Der Scanner nimmt Bilder auf, die während der laufenden Messung in räumliche Beziehung zueinander gebracht werden (Registrierung).

Während der Aufnahme und dem damit einhergehenden Registrierungsprozess ist ein markanter Laut zu hören. Wenn die Registrierung nicht ausgeführt werden kann, wird der Aufnahmefluss unterbrochen. Sie werden darüber mit einem Laut informiert. Dieser Laut unterscheidet sich von dem Laut während der erfolgreichen Aufnahme. Die Lautstärke kann unter Konfiguration angepasst und eine andere Art von Ton (Melodie) ausgewählt werden.

WICHTIG

Registrierungsfehler

Wenn ein Registrierungsfehler auftritt, müssen Sie zu einer anderen erfassten Stelle zurück.


Üben Sie diesen Vorgang zunächst am Modell und dann intraoral.

- Bewegen Sie den Scanner auf eine Position, die erfolgreich aufgenommen wurde. Am besten finden Sie eine bereits erfasste Stelle im okklusalen Bereich.
 - ↳ Der Ton für registrierte Aufnahmen ertönt.
- Führen Sie die Aufnahme fort.

Teilen Sie die Aufnahme in 4 aufeinanderfolgende Sequenzen auf:

1. Okklusal
2. Bukkal
3. Lingual
4. Approximal

11.3.2.2.1 Okklusaler Scan

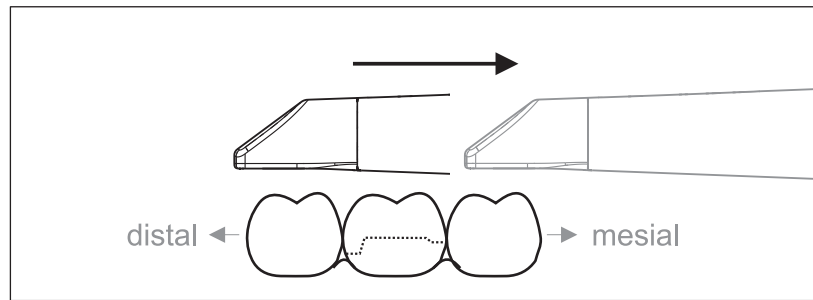


Wichtig: Achten Sie auf den Abstand der beschichteten Saphirscheibe des Scanners zur vermessenen Oberfläche.

Der Abstand muss zwischen 0-15 mm liegen (Optimal: 5 mm). Der Scanner liegt nicht auf den Zähnen oder auf dem Zahnfleisch auf. Wenn die Distanz zu groß ist, werden keine Daten empfangen.

1. Positionieren Sie den Scanner in der Startposition. Der Scanner befindet sich dazu in okklusaler Ansicht auf dem Zahn, der in distaler Richtung zum präparierten Zahn am nächsten liegt.
2. Scannen Sie in mesialer Richtung. Bewegen Sie dabei langsam den Scanner okkusal vom distal gelegenen Zahn über den präparierten Zahn zum mesial liegenden Zahn.

Bei Vollkieferaufnahmen ändert sich die Scanreihenfolge beim Frontzahnübergang. Es wird erst lingual und labial gescannt und im Anschluss inzisal.

11.3.2.2.2 Bukkaler Scan

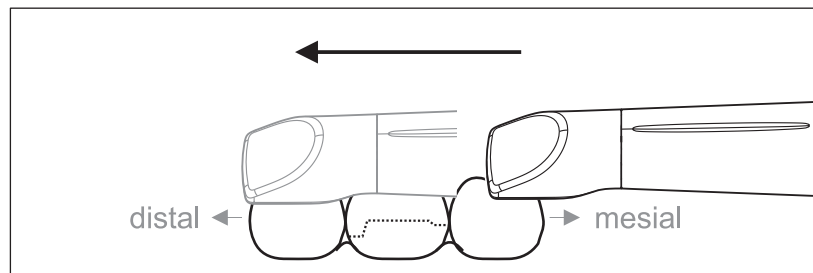

✓ Der Scanner ist auf dem mesial zur Präparation gelegenen Nachbarzahn.


1. Drehen Sie den Scanner von 45° bis maximal 90° nach bukkal.
2. Führen Sie den Scanner über die gesamte Distanz bukkal in distaler Richtung über den präparierten Zahn.

Bei Vollkieferaufnahmen nehmen Sie maximal einen Quadranten als bukkalen Scan auf.

Achten Sie darauf, beim bukkalen Scan den Scanner wie eine Querflöte zu halten. Verkappen Sie nicht in vertikale Richtung zur Bewegungsrichtung.


Tipp: Üben Sie die Führung des Scanners unter 45° bis 90°.

11.3.2.2.3 Lingualer Scan

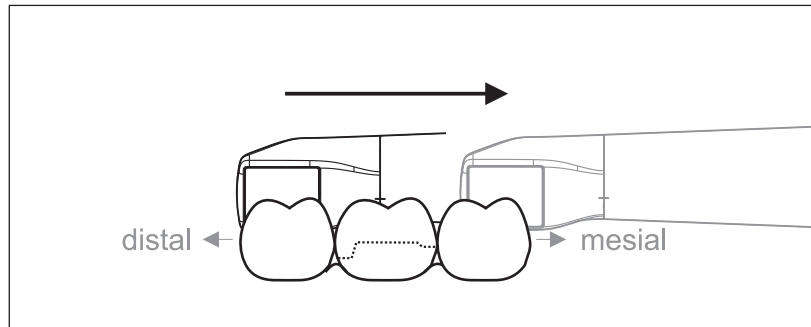

- ✓ Der Scanner ist auf dem Zahn, der distal neben der Präparation liegt.
- 1. Drehen Sie den Scanner von 90° bukkal auf die andere Seite auf 45° bis maximal 90° lingual.
- 2. Führen Sie den Scanner über die gesamte Distanz lingual in mesialer Richtung über den präparierten Zahn.

11.3.2.2.4 Approximalfächen Scan

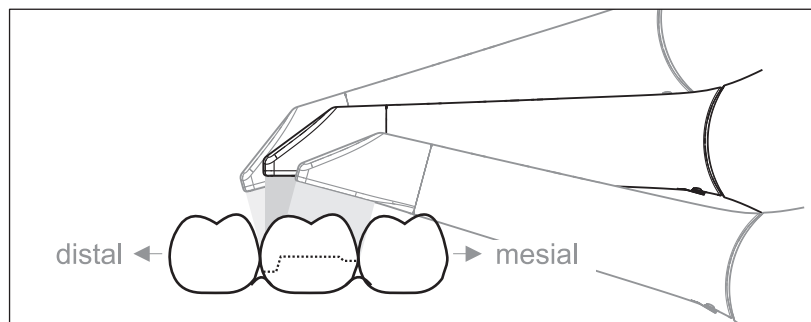

Scannen Sie die Approximalfächen des präparierten Zahns.

- Bewegen Sie den Scanner okklusal zum präparierten Zahn. Nehmen Sie die Approximalfächen in distal und mesialer Richtung auf, indem Sie mit einer Wellenbewegung okklusal, bukkal und lingual über den präparierten Zahn hinweg aufnehmen. Verkippen Sie hierzu distal und mesial um 15° zur besseren Einsicht der Approximalkontakte.

Hinweise:

- Entfernen Sie Weichgewebe.
- Schneiden Sie bewegliche Gingiva weg, sodass nur noch 2-5mm Gingiva zum Zahn übrig bleiben.
- Achten Sie beim Wegschneiden darauf, keine Bereiche versehentlich mit wegzuschneiden, die z. B. hinter dem Modell liegen oder anderweitig von der Linie geschnitten werden.
- Dieser Beschnitt muss in der Phase AUFNAHME über das Schneidwerkzeug erfolgen.

11.3.2.2.5 Einfache und mehrfache bukkale Registrierung

Mit der bukkalen Registrierung wird die Zuordnung der Kieferaufnahmen hergestellt.

- ✓ Der Kiefer mit der Präparation ist gescannt.
- 1. Scannen Sie die okklusale, bukkale und linguale Ansicht des Antagonisten (siehe Abschnitt „Okklusaler Scan [→ 122]“, „Bukkaler Scan [→ 122]“ und „Lingualer Scan [→ 123]“).
- 2. Führen Sie vor der abschließenden Registrierung einen bukkalen Scan des Aufbisses durch. Dieser bukkale Scan sollte nahe der Präparation durchgeführt werden. Um genügend Geometrie aufzunehmen, erfassen Sie die Zähne des Ober- und Unterkiefers sowie jeweils 5 mm des Zahnfleisches.


Tipp: Bei multiplen oder weitspannigen Restaurationen über mehrere Quadranten, wird empfohlen mehrere bukkale Aufnahmen nahe der Restauration zu erstellen.

11.3.2.2.6 Quadranten und Kiefer aufnehmen

Die folgende Scanvorschrift ist für die Aufnahme eines kompletten Quadranten oder Kieferbogens geeignet.


Eine Aufnahme des ersten (vierten) Quadranten erfolgt bis zum gegenüberliegenden zweiten Frontzahn mit parallelem Bewegungen des Scanners entlang des Kieferbogens.

In den Scanvorgang einsteigen

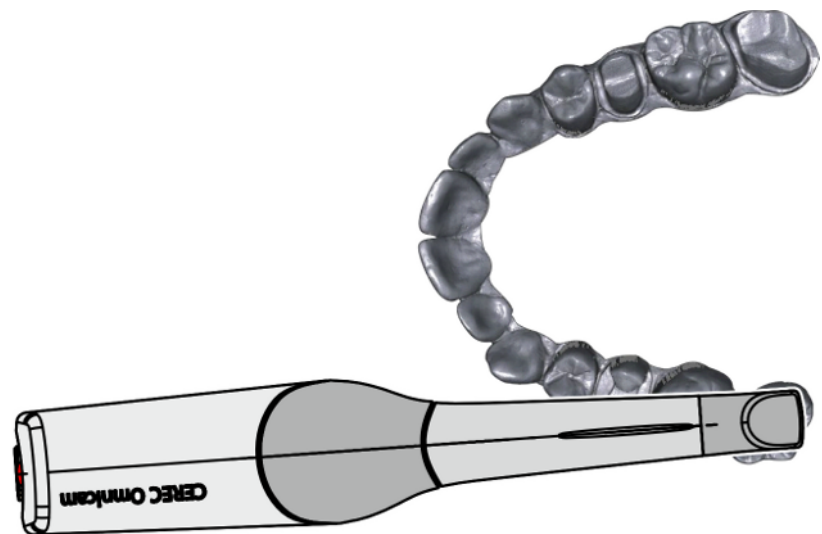


- > Positionieren Sie den Scanner okkusal über dem rechten endständigen Zahn, um in den Scanvorgang einzusteigen.

Scanvorgang durchführen

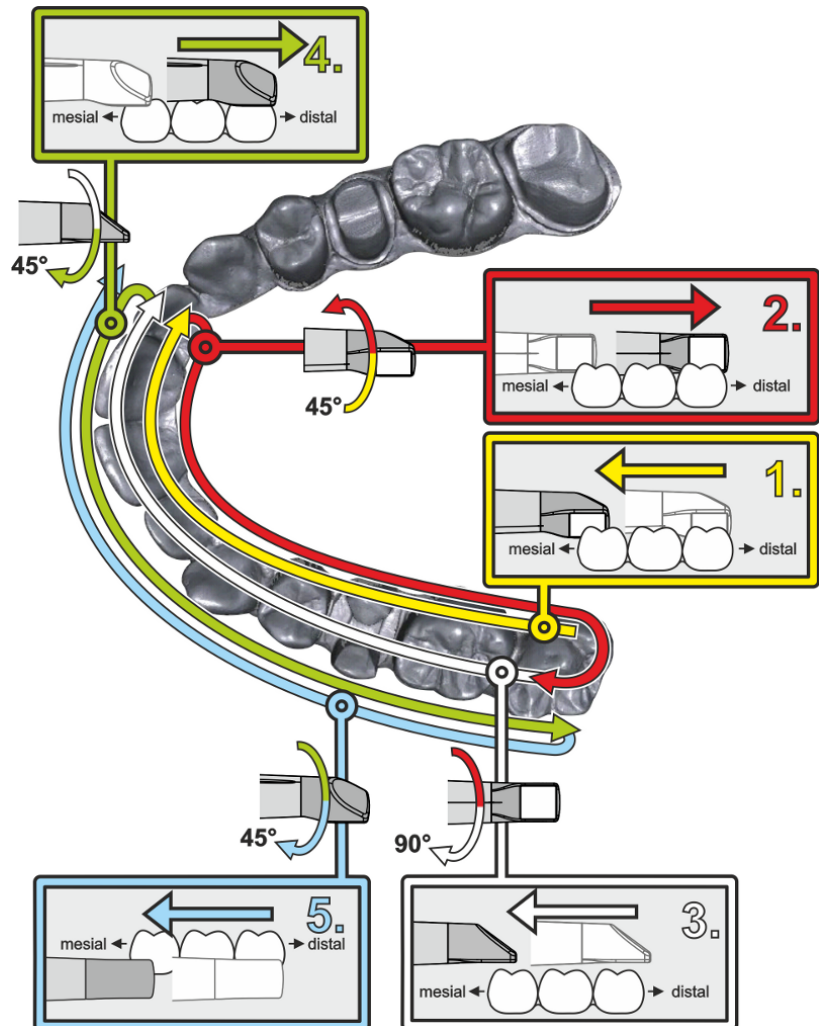

1. **Beginnen Sie, wie oben gezeigt, okklusal auf dem rechten endständigen Zahn** und nehmen Sie diesen okklusal auf. Kippen Sie den Scanner 45° nach palatinal (oral) und führen Sie ihn von distal nach mesial.
2. Schwenken Sie den Scanner weitere 45° nach palatinal (oral) and bewegen Sie ihn nach distal.
3. Schwenken Sie den Scanner um 90° auf die okklusale Fläche und bewegen Sie ihn nach mesial.
4. Schwenken Sie den Scanner auf 45° bukkal und bewegen Sie ihn wieder nach distal.
5. Schwenken Sie dort den Scanner nochmals 45° weiter nach bukkal auf insgesamt 90° und bewegen Sie ihn wieder nach mesial.

Für den gegenüberliegenden zweiten (dritten) Quadranten ergibt sich der folgende Scanablauf:

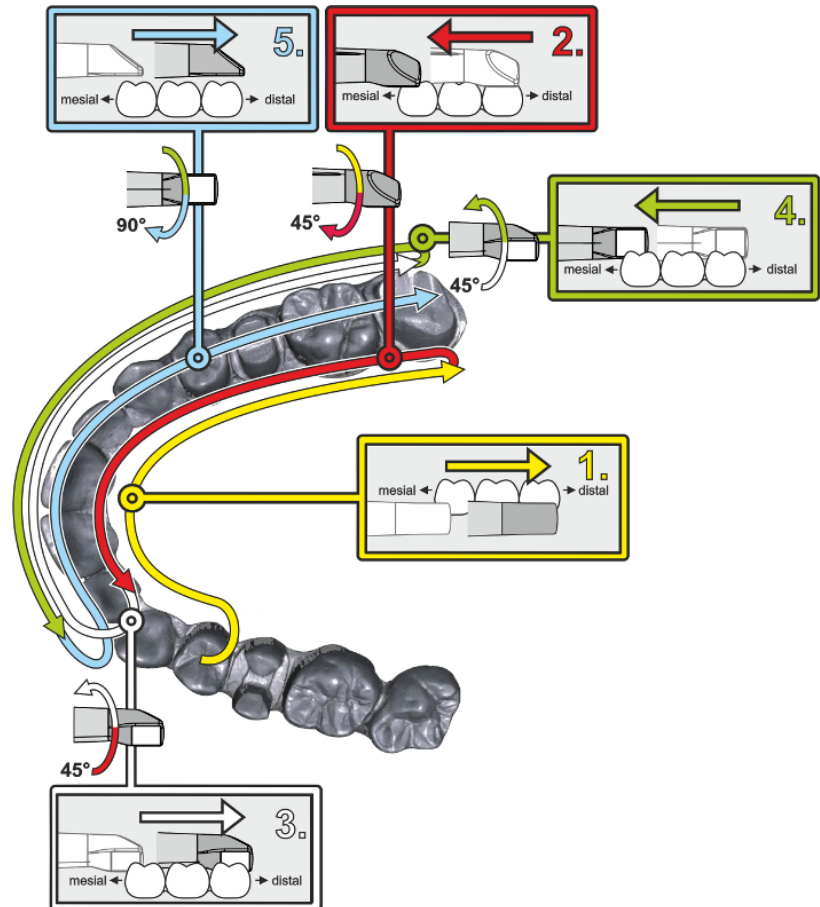

1. **Beginnen Sie mit der Aufnahme auf der Okklusalfäche eines bereits aufgenommenen Prämolaren** und führen Sie den Scanner palatinal (oral) mit bis zu 90° gekippt von mesial über die linguale Fläche der Frontzähne Richtung distal zum endständigen Zahn.
2. Kippen Sie dann den Scanner leicht um 45°, sodass der Scanner dann nur noch um 45° nach palatinal (oral) gekippt von distal wieder nach mesial zu den Frontzähnen geführt wird.
3. Führen Sie den Scanner im Frontzahnbereich angekommen 45° auf die bukkale Seite herüber und führen Sie den Scanner um diese 45° gekippt von mesial nach distal.
4. Distal angekommen kippen Sie den Scanner noch einmal um 45° (insgesamt 90°) weiter nach bukkal und führen den Scanner wieder von distal nach mesial.
5. Im Frontzahnbereich angekommen kippen Sie den Scanner in okklusale Ansicht und führen den Scanner mesial auf den Okklusalfächen bis zum hintersten distalen Molaren.

Hinweise:

- Entfernen Sie Weichgewebe.
- Schneiden Sie bewegliche Gingiva weg, sodass nur noch 2-5 mm Gingiva zum Zahn übrig bleiben.
- Achten Sie beim Wegschneiden darauf, keine Bereiche versehentlich mit wegzuschneiden, die z. B. hinter dem Modell liegen oder anderweitig von der Linie geschnitten werden.
- Dieser Beschnitt muss in der Phase AUFNAHME über das Schneidwerkzeug erfolgen.

11.3.2.2.7 Messungen abschließen

- ✓ Die Aufnahmen sind vollständig.
- 1. Betätigen Sie die Schaltfläche "Weiter".
 - ↳ Das virtuelle Modell wird berechnet und farbig dargestellt.
 - ↳ Graue Flächen zeigen fehlendes Datenmaterial im berechneten Modell an.
- 2. Wenn fehlende Daten im Bereich der Präparation auftauchen, führen Sie weitere Aufnahmen durch.

11.3.2.3 Mit dem Scanner aufnehmen

ACHTUNG

Bildhelligkeit

Die Bildhelligkeit bei der Aufnahme wird automatisch geregelt, sodass - weitgehend unabhängig vom Abstand des Scanners zum Zahn - immer eine optimale Bildhelligkeit gegeben ist.

Das Umfeld des aufzunehmenden Zahnes sollte möglichst schwach beleuchtet sein. Vermeiden Sie jede Art von Fremdlicht. Schalten Sie die Behandlungsleuchte aus.

WICHTIG

Keine Watterollen im Scanbereich verwenden

Verwenden Sie keine Watterollen in der Nähe des Scanbereichs, da sie die Genauigkeit des Scans verringern und Bildstörungen erzeugen können.

VORSICHT

Kreuzkontaminationen verhindern

Keime können über die Hände auf nicht kontaminierte Personen, Materialien oder Gegenstände übertragen werden.

- Tragen Sie während der Anwendung des Scanners aus hygienischen Gründen bei jedem Patienten neue Einmalhandschuhe.

VORSICHT

Bei Patienten mit Nickelallergie

Berührungen der Spiegelhülse des Scanners mit der Haut können bei Patienten mit Nickelallergie allergische Reaktionen hervorrufen.

- Achten Sie darauf, dass bei Patienten mit bekannterweise Nickelallergie die mit der Spiegelhülse berührbaren Hautpartien geschützt werden.

WARNUNG

Verletzungsgefahr bei diagnostizierter Epilepsie

Für Personen mit diagnostizierter Epilepsie besteht das Risiko eines epileptischen Schocks durch das pulsierende Licht des Scanners.

- Patienten, bei denen Epilepsie diagnostiziert worden ist, dürfen nicht mit dem Scanner behandelt werden.
- Zahnärzte und Zahnarztassistenten, bei denen Epilepsie diagnostiziert worden ist, dürfen nicht mit dem Scanner arbeiten.

- ✓ Die Zähne sind trockengeblasen.
- 1. Wechseln Sie in die Phase "AUFNAHME".
 - ↳ Der Scanner ist aufnahmebereit.
 - ↳ Sobald Sie den Scanner bewegen, erscheint ein Live-Bild, mit dessen Hilfe Sie sich im Patientenmund orientieren können.
- 2. Entnehmen Sie den Scanner aus seiner Halterung.
 - ↳ Sobald der Scanner über einen Zahn oder die Gingiva geführt wird, startet die Datenerfassung. Während der kontinuierlichen Datenerfassung entsteht am Bildschirm automatisch ein farbiges 3D-Modell.
Ein weißes Feld gibt an, in welchem Bereich Daten aufgenommen werden. Wenn der automatische Datenfluss abreißt, geht das weiße Feld verloren und das Audio-Signal wird verändert. In diesem Fall bewegen Sie den Scanner auf einen beliebigen Bereich, der bereits aufgenommen wurde. Der Aufnahmeprozess fährt fort.
- 3. Legen Sie den Scanner in die Ablage, dann schaltet er sich nach wenigen Sekunden ab.
 - ↳ Sie können vor der Aufnahme den Fußschalter betätigen, um die Funktion der automatischen Aufnahme auszuschalten. Halten Sie dann den Scanner über die Fläche, die Sie aufnehmen wollen und betätigen Sie den Fußschalter ein zweites Mal. Die Kamera-Funktion schaltet sich an und der Scanner startet. Wieder durch Betätigung des Fußschalters können Sie Kamera- und Scanfunktion ausschalten.
- 4. Betätigen Sie den Fußschalter oder führen Sie den Mauszeiger auf den Schalter rechts oben in der Ecke der Kamera-Ansicht, um den Aufnahmeprozess zu beenden.

Aufnahmeprozess fortsetzen

1. Betätigen Sie den Fußschalter oder klicken Sie mit dem Mauszeiger auf den Schalter.
 - ↳ Der Aufnahmeprozess wird gestartet.
2. Setzen Sie den Aufnahmeprozess, wie oben beschrieben, fort.

11.3.3 CEREC Primescan, Primescan

11.3.3.1 Mit dem Scanner aufnehmen

ACHTUNG

Bildhelligkeit

Die Bildhelligkeit bei der Aufnahme wird automatisch geregelt, sodass - weitgehend unabhängig vom Abstand des Scanners zum Zahn - immer eine optimale Bildhelligkeit gegeben ist.

Das Umfeld des aufzunehmenden Zahnes sollte möglichst schwach beleuchtet sein. Vermeiden Sie jede Art von Fremdlicht. Schalten Sie die Behandlungsleuchte aus.

WICHTIG

Keine Watterollen im Scanbereich verwenden

Verwenden Sie keine Watterollen in der Nähe des Scanbereichs, da sie die Genauigkeit des Scans verringern und Bildstörungen erzeugen können.

VORSICHT

Kreuzkontaminationen verhindern

Keime können über die Hände auf nicht kontaminierte Personen, Materialien oder Gegenstände übertragen werden.

- Tragen Sie während der Anwendung des Scanners aus hygienischen Gründen bei jedem Patienten neue Einmalhandschuhe.

WARNUNG

Verletzungsgefahr bei diagnostizierter Epilepsie

Für Personen mit diagnostizierter Epilepsie besteht das Risiko eines epileptischen Schocks durch das pulsierende Licht des Scanners.

- Patienten, bei denen Epilepsie diagnostiziert worden ist, dürfen nicht mit dem Scanner behandelt werden.
- Zahnärzte und Zahnarztassistenten, bei denen Epilepsie diagnostiziert worden ist, dürfen nicht mit dem Scanner arbeiten.

VORSICHT

Möglicherweise gefährliche optische Strahlung

Der Scanner sendet möglicherweise gefährliche optische Strahlung aus, die für die Augen schädlich sein kann.

- Bei Betrieb nicht für längere Zeit in den Scanner blicken.

WICHTIG

Möglicher Abschaltvorgang

Bei mehrfach wiederholtem Scannen der Bildfelder ohne Modellberechnung kann der Scanner außerhalb des kalibrierten Temperaturbereichs kommen. In diesem Fall erscheint eine Warnmeldung, und Sie müssen vor dem Abschluss der Aufnahmen eine Scanpause einlegen. Bitte warten Sie ungefähr so lange, wie Sie für die verbleibenden Aufnahmen Zeit brauchen. Der mögliche Abschaltvorgang ist unschädlich für Ihren Scanner und ist keine Fehlfunktion.

WICHTIG

Aufheizen des Scanners

Die interne Heizung des Scanners sorgt dafür, dass kein Beschlag beim Scannen auftritt. Die Heizung startet unmittelbar nach Hochfahren der Aufnahmeeinheit und nach etwa 5 Minuten ist der Scanner beschlagsfrei. Dies ist in der Regel bis zur Navigation in die Aufnahme phase der Fall.

- ✓ Die Zähne sind trockengeblasen.
- 1. Wechseln Sie in die Phase "AUFNAHME".
 - ↳ Der Scanner ist aufnahmebereit.
 - ↳ Sobald Sie den Scanner bewegen, erscheint ein Live-Bild, mit dessen Hilfe Sie sich im Patientenmund orientieren können.
- 2. Entnehmen Sie den Scanner aus seiner Halterung.
 - ↳ Sobald der Scanner über einen Zahn oder die Gingiva geführt wird, startet die Datenerfassung. Während der kontinuierlichen Datenerfassung entsteht am Bildschirm automatisch ein farbiges 3D-Modell.
Ein weißes Feld gibt an, in welchem Bereich Daten aufgenommen werden. Wenn der automatische Datenfluss abreißt, geht das weiße Feld verloren und das Audio-Signal wird verändert. In diesem Fall bewegen Sie den Scanner auf einen beliebigen Bereich, der bereits aufgenommen wurde. Der Aufnahmeprozess fährt fort.
- 3. Legen Sie den Scanner in die Ablage, dann schaltet er sich nach wenigen Sekunden ab.
 - ↳ Sie können vor der Aufnahme den Fußschalter betätigen, um die Funktion der automatischen Aufnahme auszuschalten. Halten Sie dann den Scanner über die Fläche, die Sie aufnehmen wollen und betätigen Sie den Fußschalter ein zweites Mal. Die Kamera-Funktion schaltet sich an und der Scanner startet. Wieder durch Betätigung des Fußschalters können Sie Kamera- und Scanfunktion ausschalten.
- 4. Betätigen Sie den Fußschalter oder führen Sie den Mauszeiger auf den Schalter rechts oben in der Ecke der Kamera-Ansicht, um den Aufnahmeprozess zu beenden.

Aufnahmeprozess fortsetzen

1. Betätigen Sie den Fußschalter oder klicken Sie mit dem Mauszeiger auf den Schalter.
↳ Der Aufnahmeprozess wird gestartet.
2. Setzen Sie den Aufnahmeprozess, wie oben beschrieben, fort.

11.3.3.2 Scannerführung

Der Scanner nimmt Bilder auf, die während der laufenden Messung in räumliche Beziehung zueinander gebracht werden (Registrierung).

Während der Aufnahme und dem damit einhergehenden Registrierungsprozess ist ein markanter Laut zu hören. Wenn die Registrierung nicht ausgeführt werden kann, wird der Aufnahmefluss unterbrochen. Sie werden darüber mit einem Laut informiert. Dieser Laut unterscheidet sich von dem Laut während der erfolgreichen Aufnahme. Die Lautstärke kann unter Konfiguration angepasst und eine andere Art von Ton (Melodie) ausgewählt werden.

WICHTIG

Registrierungsfehler

Wenn ein Registrierungsfehler auftritt, müssen Sie zu einer anderen erfassten Stelle zurück.


Üben Sie diesen Vorgang zunächst am Modell und dann intraoral.

- Bewegen Sie den Scanner auf eine Position, die erfolgreich aufgenommen wurde. Am besten finden Sie eine bereits erfasste Stelle im okklusalen Bereich.
 - ↳ Der Ton für registrierte Aufnahmen ertönt.
- Führen Sie die Aufnahme fort.

Teilen Sie die Aufnahme in 4 aufeinanderfolgende Sequenzen auf:

1. Okklusal
2. Bukkal
3. Lingual
4. Approximal

11.3.3.2.1 Okklusaler Scan

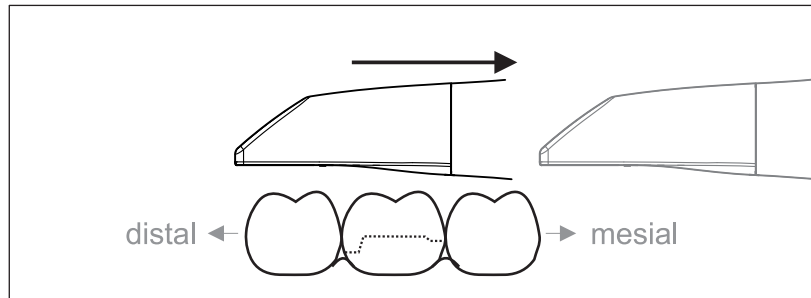


Wichtig: Achten Sie auf den Abstand der beschichteten Saphirscheibe des Scanners zur vermessenen Oberfläche.

Der Abstand muss zwischen 0-20mm liegen (Optimal: 2mm). Der Scanner liegt nicht auf den Zähnen oder auf dem Zahnfleisch auf.

1. Positionieren Sie den Scanner in der Startposition. Der Scanner befindet sich dazu in okklusaler Ansicht auf dem Zahn, der in distaler Richtung zum präparierten Zahn am nächsten liegt.
2. Scannen Sie in mesialer Richtung. Bewegen Sie dabei den Scanner okklusal vom distal gelegenen Zahn über den präparierten Zahn zum mesial liegenden Zahn.


11.3.3.2.2 Bukkaler Scan

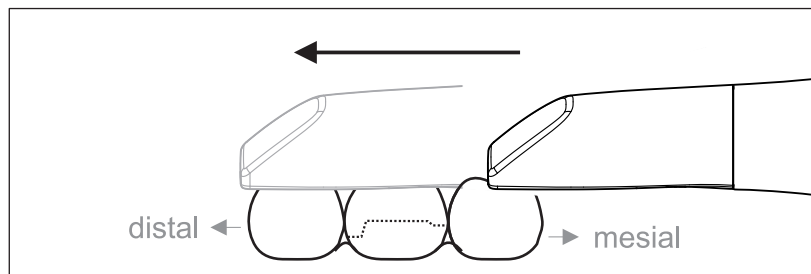

✓ Der Scanner ist auf dem mesial zur Präparation gelegenen Nachbarzahn.


1. Drehen Sie den Scanner 20° nach bukkal.
2. Führen Sie den Scanner über die gesamte Distanz bukkal in distaler Richtung über den präparierten Zahn.

11.3.3.2.3 Lingualer Scan

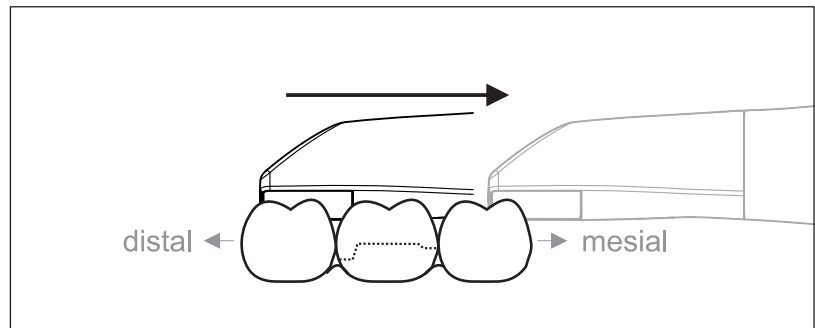

- ✓ Der Scanner ist auf dem Zahn, der distal neben der Präparation liegt.
- 1. Drehen Sie den Scanner bis maximal 20° lingual.
- 2. Führen Sie den Scanner über die gesamte Distanz lingual in mesialer Richtung über den präparierten Zahn.

11.3.3.2.4 Approximalfächen-Scan

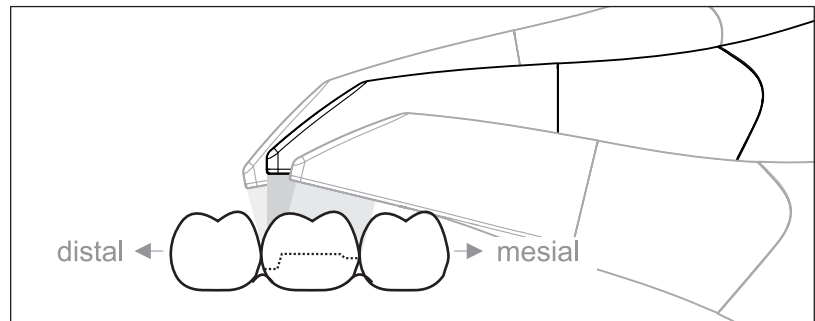

- Scannen Sie die Approximalfächen des präparierten Zahns.
- > Bewegen Sie den Scanner okklusal zum präparierten Zahn. Nehmen Sie die Approximalfächen in distal und mesialer Richtung auf.

11.3.3.2.5 Einfache und mehrfache bukkale Registrierung

Mit der bukkalen Registrierung wird die Zuordnung der Kieferaufnahmen hergestellt.


- ✓ Der Kiefer mit der Präparation ist gescannt.
- 1. Scannen Sie die okklusale, bukkale und linguale Ansicht des Antagonisten (siehe Abschnitt „Okklusaler Scan [→ 122]“, „Bukkaler Scan [→ 122]“ und „Lingualer Scan [→ 123]“).
- 2. Führen Sie vor der abschließenden Registrierung einen bukkalen Scan des Aufbisses durch. Dieser bukkale Scan sollte nahe der Präparation durchgeführt werden. Um genügend Geometrie aufzunehmen, erfassen Sie die Zähne des Ober- und Unterkiefers sowie jeweils 5mm des Zahnfleisches.

Tipp: Bei multiplen oder weitspannigen Restaurationen über mehrere Quadranten, wird empfohlen mehrere bukkale Aufnahmen nahe der Restauration zu erstellen.

11.3.3.2.6 **Quadranten- und Vollkiefer-Scan**


Für den Scan eines Quadranten oder Vollkiefers können Sie unterschiedliche Scanprozeduren einsetzen. Finden Sie wie folgt zwei Prozeduren, die Ihnen den Einstieg erleichtern sollen, falls eine solche Hilfe erforderlich ist.

Prozedur 1

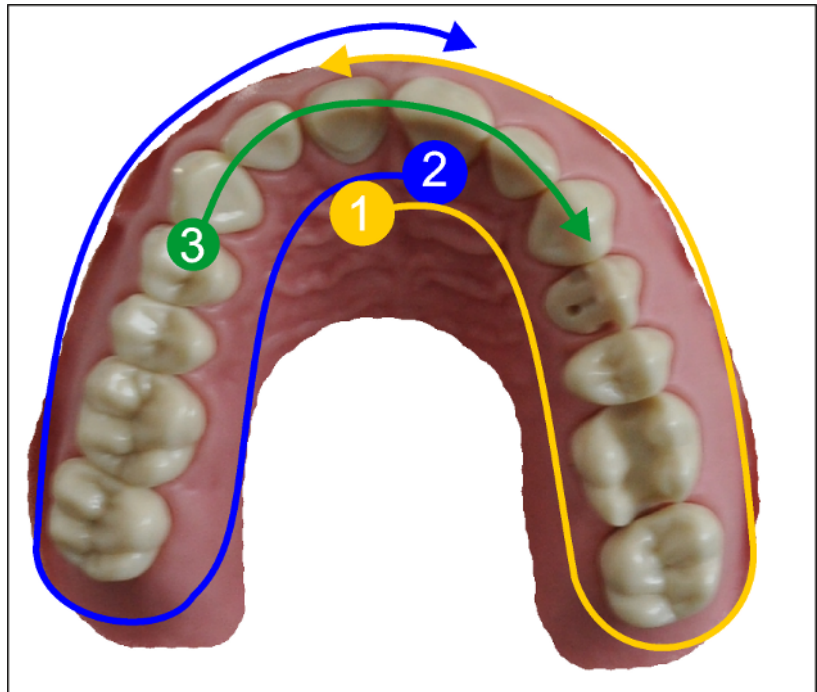

1. Starten Sie mit der oralen Fläche der Frontzähne und bewegen Sie den Scanner oral entlang des Quadranten. Bewegen Sie den Scanner über den distalen Zahn auf die vestibuläre Seite und folgen Sie dem ersten Quadranten zurück zu den Frontzähnen. Verkippen Sie den Scanner leicht ca. 30° in koronal-apikaler Richtung.
2. Bewegen Sie den Scanner wie unter (1) auch für den zweiten Quadranten.
3. Abschließend scannen Sie die Vorderzähne von Eckzahn zu Eckzahn in koronaler-apikaler Richtung. Stellen Sie sicher, dass sowohl die labiale Fläche als auch die oralen Flächen sichtbar sind. Weiten Sie diesen letzten dritten Scan auf Orte aus, wo Sie Scanlöcher erkennen.

Prozedur 2

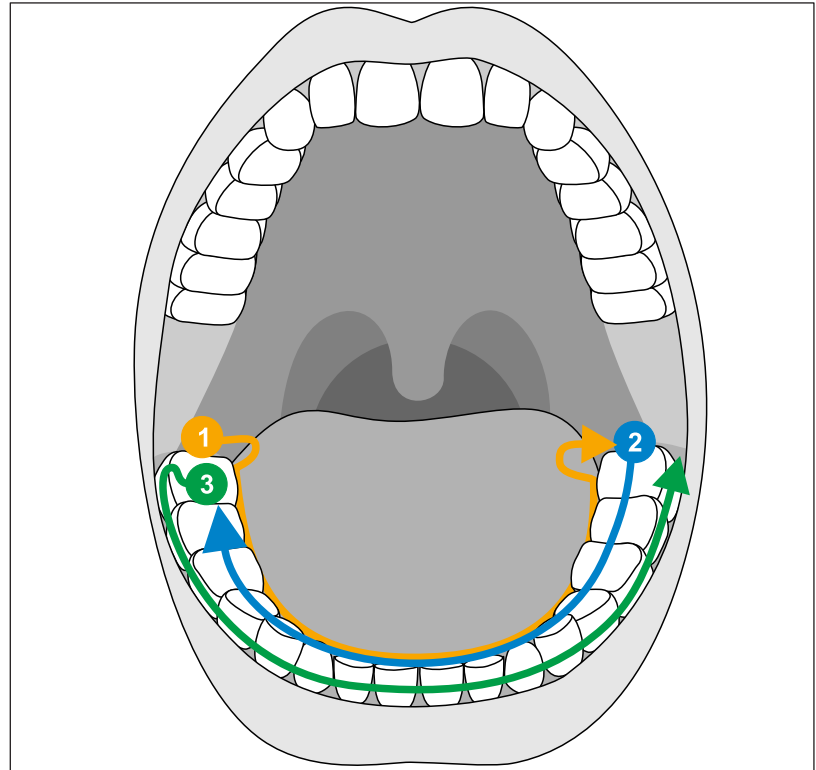

1. Starten Sie okklusal auf dem distalen Zahn, kippen Sie den Scanner ca. 60° nach oral und bewegen ihn oral entlang des Zahnbogens bis zum gegenüberliegenden distalen Zahn.
2. Führen Sie den Scanner okklusal vom distalen Zahn über den gesamten Zahnbogen wieder zurück auf die andere Seite.
3. Zur Komplettierung des Scans kippen Sie den Scanner ca. 60° nach bukkal und bewegen ihn bukkal entlang des gesamten Zahnbogens.

11.3.3.2.7 Aufnahmen abschließen

- ✓ Die Aufnahmen sind vollständig.
- 1. Klicken Sie auf die Schaltfläche *"Weiter"*.
 - ↳ Das virtuelle Modell wird berechnet und farbig dargestellt.
- 2. Wenn fehlende Daten im Bereich der Präparation auftauchen, führen Sie weitere Scans durch.

11.3.4 Modellbereiche wegschneiden



Mit der Funktion *"Ausschneiden"* sollten Sie Modellbereiche wegschneiden. Das können Bereiche sein, in denen versehentlich Teile von Watterollen oder Wange aufgenommen wurden.

Achten Sie beim Wegschneiden darauf, keine Bereiche versehentlich mit wegzuschneiden, die z.B. hinter dem Modell liegen oder anderweitig von der Linie geschnitten werden.

WICHTIG

Diese Funktion ist aus Präzisionsgründen ausschließlich mit dem Trackball oder Touchpad bedienbar.

- ✓ Sie befinden sich in der Phase AUFNAHME oder in der Phase MODELL.
- 1. Betätigen Sie das Werkzeugrad.
- 2. Betätigen Sie die Schaltfläche *"Ausschneiden"*.
 - ↳ Der Cursor wird zu einem Kreuz.
- 3. Starten Sie die Schnittlinie durch Doppeltippen/Doppelklicken.
- 4. Tippen/Klicken Sie, um weitere Punkte zu setzen.
- 5. Schließen Sie den Schnitt durch Doppeltippen/Doppelklicken ab.
 - ↳ Der Modellbereich wird ausgeschnitten.
- 6. Betätigen Sie die Schaltfläche *"Anwenden"*, um die Änderung umzusetzen.

11.3.5 Nachträgliche Aufnahmen

Sie können aus den Phasen HERSTELLUNG, DESIGN und MODELL in die Phase AUFNAHME zurückwechseln und weitere Aufnahmen hinzufügen.

- ✓ Sie befinden sich in der Phase DESIGN.
- 1. Gehen Sie zu der Phase AUFNAHME.
 - ↳ Die Phase AUFNAHME wird geöffnet. Die Bildkataloge sind gesperrt.
- 2. Betätigen Sie in der Seitenpalette die Schaltfläche *"Entsperren"*.
 - ↳ Die Bildkataloge werden entsperrt.
 - ↳ Sie können zusätzliche Aufnahmen machen.



11.3.6 Primescan™ 2

Ein mit einer Primescan™ 2 aufgenommener Scan kann mit CEREC SW 5.3 geöffnet und weiterverwendet werden.

In CEREC SW 5.3 kann mit einer Primescan™ 2 kein Scan aufgenommen werden. Das Scannen ist in der Aufnahme phase gesperrt.

12 Phase MODELL

In der Phase "MODELL" werden die virtuellen Modelle auf Basis der aufgenommenen Bildkataloge berechnet.

Wenn Sie das Modell bearbeiten möchten, wechseln Sie in den Schritt "Modell bearbeiten".

Die Schritte "Oberkiefer", "Unterkiefer", "Bukkales Bissregistrat" und "Modellachse einstellen" beziehen sich auf das ganze Modell (Ober- und Unterkiefer).

Alle weiteren Schritte in der Phase "MODELL" beziehen sich auf die jeweilig ausgewählte Restauration. Diese Schritte müssen jeweils für alle Restaurationen durchgeführt werden.

12.1 Modell bearbeiten

Dieser Schritt ist optional. Um in diesen Schritt zu gelangen, müssen Sie ihn anklicken.

Sie können im Schritt "Modell bearbeiten" mit den folgenden Werkzeugen arbeiten:

- "Ausschneiden"
- "Ersetzen"
- "Modell zurücksetzen"

Die Handhabung der einzelnen Werkzeuge ist im Abschnitt „Werkzeuge [→ 72]“ beschrieben.

12.2 Bukkale Registrierung (optional)

Die Software fügt die Modelle automatisch zusammen und zeigt dies mit einem grünen Haken am bukkalen Fenster. Falls dies nicht möglich ist, versucht die Software im nachfolgenden Prozess die Kiefer zu korrelieren. Sollte dies nicht möglich sein, können Sie die Modelle auch manuell korrelieren.

Manuelle Korrelation

In diesem Schritt sollen die virtuellen Modelle vom Oberkiefer und Unterkiefer mit Hilfe der bukkalen Aufnahme in ihre korrekte Position zueinander ausgerichtet werden.

Sie können im Schritt "Bukkales Bissregistrat" mit den folgenden Werkzeugen in der Seitenpalette arbeiten:

- Bukkal zuordnen
- Bukkalen Abdruck drehen

Werkzeug Settling

Im Schritt "Bukkale Bisswerkzeuge" können Sie mit dem Werkzeug "Settling" die bukkale Registrierung halbautomatisch überarbeiten. Dies kann nötig sein, wenn der Biss durch einen intraoralen ScanPost gesperrt wird.


Tipp: Der Schritt "Bukkale Bisswerkzeuge" mit dem Werkzeug "Settling" steht nur beim Restaurationstyp "Abutment" zur Verfügung.




Unterkiefer und Oberkiefer drehen

- > Drücken Sie mit einem Finger oder klicken Sie mit der linken Maustaste in den grauen Bereich und halten Sie gedrückt.
 - ↳ Unterkiefer und Oberkiefer lassen sich gleichzeitig um die vertikale Achse drehen.
- > Drücken Sie mit einem Finger oder klicken Sie mit der linken Maustaste auf den Unterkiefer oder den Oberkiefer und halten Sie gedrückt.
 - ↳ Die Kiefer lassen sich einzeln frei drehen.

Bukkal zuordnen

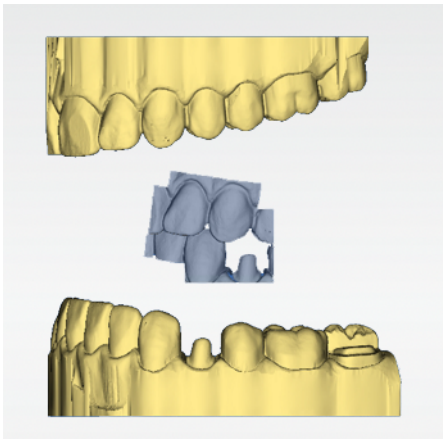


1. Drehen Sie die beiden Modelle so, dass Sie den Überlappungsbereich der bukkalen Aufnahme und von Unterkiefer und Oberkiefer sehen können.
2. Ziehen Sie nun die bukkale Aufnahme mit dem Finger/der Maus auf den entsprechenden Bereich des Oberkiefers und lassen Sie los (Drag & Drop).

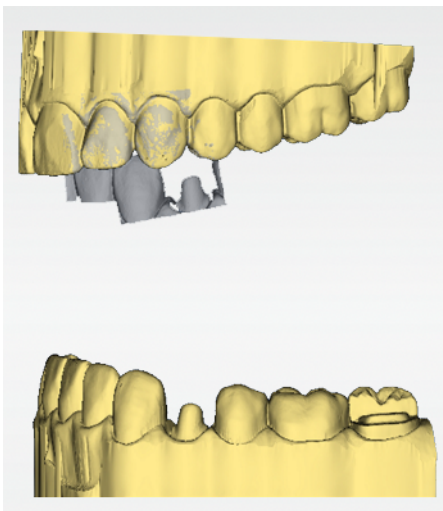

- ↳ Die bukkale Aufnahme registriert sich automatisch auf den Oberkiefer. War die Registrierung erfolgreich, erkennen Sie das am „Leopardenmuster“. War die Registrierung nicht erfolgreich, springt die bukkale Aufnahme zurück in die ursprüngliche Position. In diesem Fall müssen Sie die Prozedur (Drag & Drop) wiederholen, um eine bessere Korrelationsfläche zu finden.

3. Betätigen Sie jetzt wieder die bukkale Aufnahme und ziehen Sie diese auf die entsprechende Fläche des Unterkiefers (Drag & Drop).

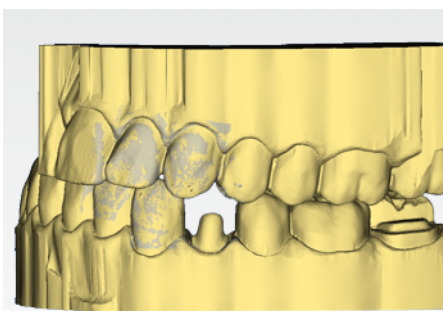

- ↳ War die Registrierung erfolgreich, erkennen Sie das am „Leopardenmuster“. War die Registrierung nicht erfolgreich, springt die bukkale Aufnahme zurück in die ursprüngliche Position. In diesem Fall müssen Sie die Prozedur (Drag & Drop) wiederholen, um eine bessere Korrelationsfläche zu finden.


Ob Sie die bukkale Aufnahme zuerst auf den Unterkiefer oder auf den Oberkiefer ziehen, ist nicht relevant.

Bukkalen Abdruck drehen


In einigen Fällen kann es vorkommen, dass die bukkale Aufnahme in Relation zum Unterkiefer und Oberkiefer verkehrt herum dargestellt wird. Gehen Sie in einem solchen Fall wie folgt vor:

- > Betätigen Sie den oberen Bereich der bukkalen Aufnahme und ziehen Sie diese auf das untere Modell.
- oder
- > Bewegen Sie die Maus über *"Werkzeuge"* auf die Schaltfläche *"Bissregistrierung"* und aktivieren Sie den Befehl *"Bukkalen Abdruck drehen"*.
 - ↳ Die bukkale Aufnahme dreht sich automatisch um und Sie können diese per Drag&Drop-Technik auf den Kiefer registrieren.

Dies funktioniert in gleicher Weise, wenn Sie den unteren Bereich der bukkalen Aufnahme betätigen und auf das obere Modell ziehen.

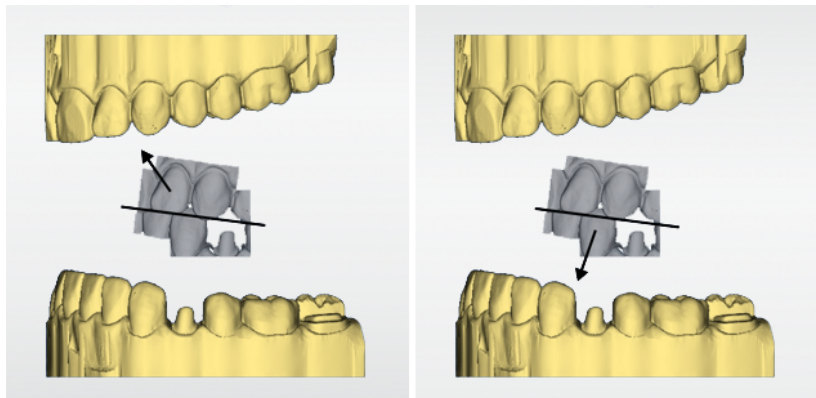

Die bukkale Aufnahme wird richtig herum dargestellt. Die Registrierung ist ohne Drehung möglich.

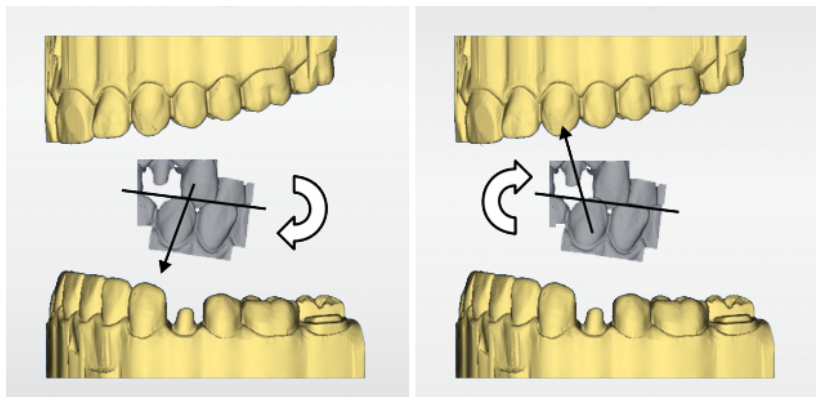


Die bukkale Aufnahme wird falsch herum dargestellt. Wenn Sie die Registrierung beginnen, merkt dies die Software und dreht die Aufnahme automatisch richtig herum.

Zum nächsten Schritt wechseln

- ✓ Der Schritt ist vollständig abgeschlossen.
- > Gehen Sie zum nächsten Schritt, um fortzufahren.


12.3 Modellachse festlegen (optional)

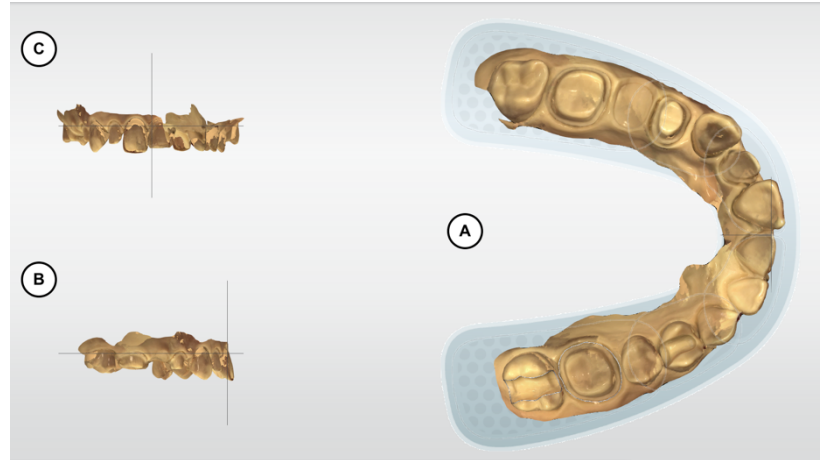

Die Modellachse wird von der Software automatisch vorgeschlagen. Wenn Sie mit dem Vorschlag nicht zufrieden sind, können Sie die Modellachse neu definieren. Die Ausrichtung wird benötigt, um optimale Erstvorschläge zu berechnen.

Okklusale Ansicht (A) ausrichten

1. Richten Sie das Modell anhand des schematischen Kieferbogens aus. Jeder Zahn muss sich im korrekten Quadranten befinden.
2. Richten Sie die Schneidezähne anhand der dargestellten Mittellinien aus.
Folgende Markierungen helfen Ihnen bei der Ausrichtung:
 - T-förmiges Fadenkreuz für die Inzisalpunkte der Schneidezähne
 - Gepunktete Fläche für die Molaren
 - Gestreifte Fläche für die Prämolaren
 - Gefüllte Fläche für die Frontzähne
3. Halten Sie einen Finger oder die linke Maustaste gedrückt, um den Kiefer zu drehen oder halten Sie zwei Finger oder die rechte Maustaste gedrückt, um den Kiefer zu verschieben. Wenn Sie einen Kiefer bewegen, bewegt sich der andere Kiefer automatisch mit.
4. Gehen Sie zum nächsten Schritt, um den Präparationsrand zu zeichnen.

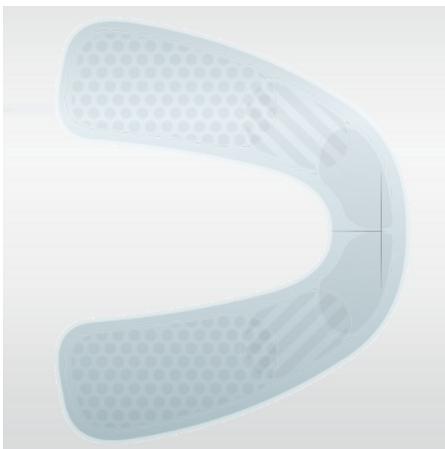

Bukkale Ansicht (B) ausrichten

1. Richten Sie den Kiefer so aus, dass Inzisalpunkt und distrobukkaler Höcker der ersten Molaren parallel zur horizontalen Hilfslinie stehen.
2. Halten Sie einen Finger oder die linke Maustaste gedrückt, um den Kiefer zu drehen oder halten Sie zwei Finger oder die rechte Maustaste gedrückt, um den Kiefer zu verschieben.
3. Gehen Sie zum nächsten Schritt, um den Präparationsrand zu zeichnen.

Mesiale Ansicht (C) ausrichten

1. Richten Sie die Quadranten vom Kiefer parallel zur horizontalen Hilfslinie aus.
2. Halten Sie einen Finger oder die linke Maustaste gedrückt, um den Kiefer zu drehen oder halten Sie zwei Finger oder die rechte Maustaste gedrückt, um den Kiefer zu verschieben.
3. Gehen Sie zum nächsten Schritt, um den Präparationsrand zu zeichnen.

12.4 Präparationsrand eingeben

Präparationsrand automatisch erfassen

WICHTIG

Diese Funktion ist aus Präzisionsgründen ausschließlich mit dem Trackball oder Touchpad bedienbar.

Sollte der Präparationsrand nicht komplett korrekt gefunden worden sein oder möchten Sie den automatisch gefundenen Rand verfeinern, können Sie ihn korrigieren.

1. Starten Sie mit einem Doppelklick in der Nähe der zu korrigierenden Stelle.
 - ↳ Eine neue korrigierende Linie wird geöffnet und die Linie hängt am Maus-Cursor.
2. Zeichnen Sie die Linie entsprechend um, indem Sie den Cursor über die richtigen Positionen führen und mit Linksklick Punkte setzen.
3. Setzen das Vorgehen fort, bis die Stelle korrigiert ist und schließen die Linie mit einem Doppelklick ab.

Allgemeine Hinweise

WICHTIG

Sie können während der Eingabe bzw. der Bearbeitung des Präparationsrandes die 3D-Ansicht vergrößern oder verkleinern (siehe „3D-Vorschau“), um so die korrekte Platzierung des Präparationsrandes sicherzustellen. Achten Sie dabei darauf, die linke Maustaste lange zu halten. Ein kurzer Klick fügt einen Punkt zur Präparationsgrenze hinzu.

Nach der vollständigen Erstellung des Präparationsrandes wird die Zahnnummer angezeigt. So werden Verwechslungen und damit schlechte Vorschläge vermieden.

Der Präparationsrand muss immer eine geschlossene Linie sein.

Der fertige Präparationsrand kann nach der Eingabe der letzten Linie editiert werden.

Um den Präparationsrand einzugeben, kann über die Seitenpalette ein Verfahren gewählt werden:

Verfahren	Darstellung	Verwendung
"Magnetisch"	Höhenbild	Bei klaren Präparationskanten, für das initiale Einzeichnen der Grenze. Manuell/Höhenbild/Für kleine, präzise Korrekturen.
"Manuell"	Höhenbild	Für kleine, präzise Korrekturen.

Tipp: Sie können während der Eingabe das Modell drehen, um eine bessere Sicht auf die Präparationsgrenze zu erhalten. Klicken Sie mit der linken Maustaste und bewegen Sie das Modell mit der Maus bei gedrückter Maustaste. Sie können den eingezeichneten Vorschlag jederzeit verwerfen oder erneut automatisch berechnen lassen.

Präparationsrand Gingivaelement

Wenn Sie für die Konstruktion ein Gingivaelement angewählt haben, müssen Sie in diesem Schritt den Präparationsrand für das Element eingeben.

Dies funktioniert genau so, wie das manuelle Zeichnen eines Präparationsrandes auf einem Stumpf.

Präparationsrand für die nächste Restauration eingeben

- Fahren Sie mit dem Präparationsrand für die nächste Restauration fort, indem Sie die gewünschte Restauration in der Objektleiste auswählen.

12.5 Einschubachse oder Restaurationsachse festlegen (optional)


Die Einschub- oder Restaurationsachse wird von der Software automatisch vorgeschlagen. Wenn Sie mit dem Vorschlag nicht zufrieden sind, können Sie die Einschubachse neu definieren (siehe „Einschubsachse neu definieren [→ 138]“).

12.5.1 Die richtige Einschubachse vorbereiten

CEREC Biogenerik erhält seine Informationen von der okklusalen Kaufläche und der Äquatorlinie der benachbarten Zähne, basierend auf der vom Anwender gewählten Einschubachse. Die Software setzt voraus, dass beide Ebenen senkrecht zu der Einschubachse sind.

Wenn die Präparation so geformt ist, dass die Einschubachse senkrecht zur okklusalen Kaufläche Hinterschnitte erzeugt, müssen Sie die Richtung der Einschubachse ändern.

Abweichungen der aufgenommenen Fläche von der eigentlichen Okklusion wirken sich negativ auf die zur Verfügung stehende Informationsmenge für den biogenerischen Algorithmus aus. Dies beeinflusst potenziell die Qualität des Vorschlags.

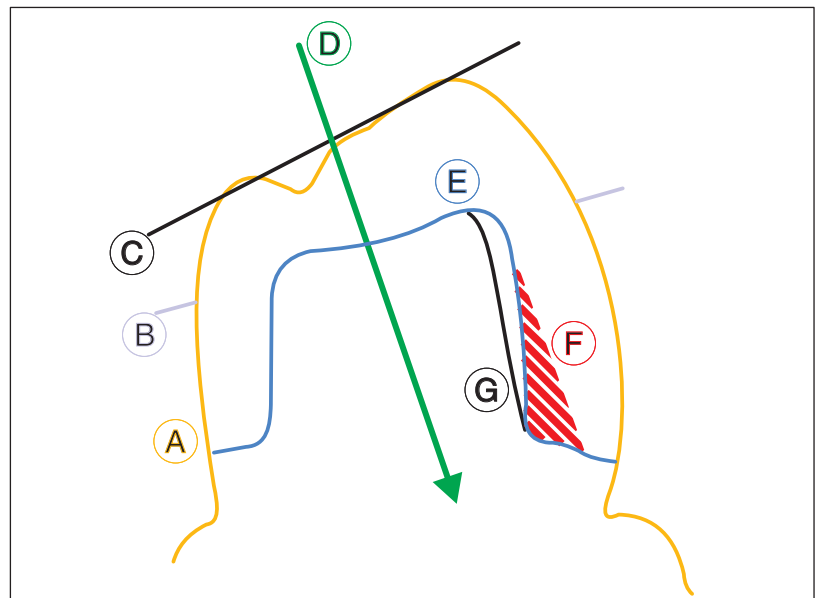

A	Umriss des Zahns	E	Präparation
B	Äquatorlinie	F	Hinterschnitt
C	Okklusale Kaufläche	G	Alternative bukkale Präparationslinie
D	Einschubachse		

(A) zeigt den originalen Umriss des Zahns, der restauriert werden soll.

Die ideale Ausrichtung für die Einschubachse (D), um Informationen für den biogenerischen Algorithmus zu liefern, ist etwa senkrecht zu der Äquatorlinie (B) und zu der okklusalen Kaufläche (C).

Mit dieser für das biogenerische Berechnungswesen idealen Achse für die Präparation (E) können Hinterschnitte (F) entstehen. (G) zeigt eine alternative bukkale Präparationslinie, die den Einschubwinkel optimieren und optimale Ergebnisse von CEREC Biogenerik individuell ermöglichen würde.

12.5.2 Einschubachse neu definieren

Tipp: Bereiche innerhalb eines Präparationsrandes, die aus Blickrichtung einen Hinterschnitt zeigen, sind gelb markiert.

- > Verändern Sie die Lage der Präparation im 3D-Modell so, dass möglichst alle farbigen Markierungen verschwinden. Sollte dies nicht möglich sein (z. B. bei divergierenden Stümpfen) achten Sie darauf, dass alle Präparationsränder aus der Blickrichtung komplett sichtbar sind und farbig markierte Hinterschnitte möglichst weit vom Präparationsrand entfernt sind.

Sie können die Einschubachse folgenderweise einstellen.

1. Drehen Sie das Modell in die gewünschte Einschubachse und wählen in der Seitenpalette die Option "*Einschubachse festlegen*".

Bei Brücken haben Sie die Möglichkeit, die Einschubachse der Einzelstümpfe neu zu definieren.

- > Wählen Sie hierzu im Restaurationsselektor den gewünschten Zahn.
 - ↳ Ihnen stehen alle Möglichkeiten zur Einstellung der Einschubachse zur Verfügung.

CEREC Primemill und MC XL = 4 Achsen (hier kann der Einschub nur in bucco-lingualer Richtung zur Brückenachse eingestellt werden).

12.5.3 Einschubachse für das Gingivaelement einstellen

Wenn Sie für die Konstruktion ein Gingivaelement angewählt haben, müssen Sie in diesem Schritt die Einschubachse des Gingivaelementes eingeben.

12.5.4 Präparationsanalyse

Dieser Schritt ist nach der Definition der Einschubachse optional anwählbar.

Hier sind folgende Analysen möglich:

- Abstand zum Antagonisten
- Hinterschnitt
- Präparationsrand
- Oberfläche (Oberflächenbeschaffenheit)

Eine Legende in der linken oberen Ecke des 3D-Raumes zeigt die verschiedenen Maße an.


In der linken unteren Ecke lassen sich Messwerte der Position des Mauszeigers auslesen.

12.6 Restaurationsachse bei Implantat-Abutment

Dieser Schritt ist nur verfügbar, wenn als Indikation *"Abutment"* ausgewählt wurde.

Es wird automatisch eine Restaurationsachse vorgeschlagen, die manuell verändert werden kann.

Dazu klicken Sie mit der linken Maustaste auf den orangefarbenen Kreis im Zentrum der dargestellten Zielscheibe. Halten Sie die Taste gedrückt und verändern Sie die Restaurationsachse in die gewünschte Richtung. Bestätigen Sie die Änderung mit *"OK"* oder verwerfen Sie diese.

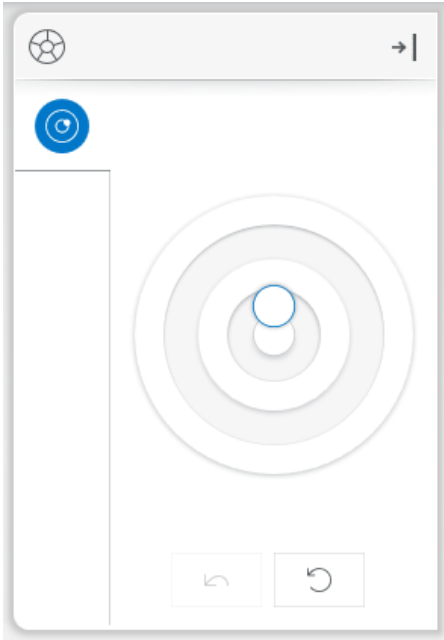

ACHTUNG

Eine Abwinkelung von mehr als 20° zur Implantatachse ist nicht zulässig. Dies wird Ihnen durch eine Rotfärbung der Restauration angezeigt.

Bei der Indikation *"Multilayer-Abutment"* entspricht die Restaurationsachse der Einschubachse der Krone auf das Abutment bzw. einem abgewinkelten Abutment.

12.7 Modell anzeigen

In diesem Schritt können das virtuelle Modell sowie die Kontaktflächen betrachtet werden.

Insbesondere für den Fall, dass Sie in der Phase ADMINISTRATION keine Indikation oder Restauration angelegt haben, kann dieser Schritt verwendet werden, um sich das aufgenommene Modell anzuschauen. Die Phase DESIGN kann ohne angelegte Indikation oder Restauration nicht betreten werden. Ein Export des virtuellen Modells ist aus diesem Schritt heraus möglich.

12.8 Phase abschließen

- ✓ Die nächste Phase ist anwählbar.
- > Gehen Sie zur nächsten Phase.
- oder
- > Betätigen Sie den Doppelpfeil.
 - ↔ Das Programm wechselt in die nächste Phase.

13 Phase DESIGN

13.1 Restaurationsparameter (optional)

Sie können vor der weiteren Bearbeitung die Parameter für diese Restauration prüfen und gegebenenfalls verändern. Die hier eingestellten Werte beziehen sich nur auf die aktuelle Restauration.

Dieser Schritt ist optional. Wenn Sie den Schritt überspringen, werden die globalen Parameter verwendet.

Sie können die Parameter umstellen, wie im Abschnitt „Parameter“ beschrieben.

WICHTIG

Materialabhängige Parameter können nur für die aktuelle Restauration verändert werden. Die vom Materialhersteller vorgegebenen Werte sind gesperrt dargestellt und müssen von Ihnen aktiv entsperrt werden. Änderungen an diesen Parametern liegen in Ihrer eigenen Verantwortung.

13.2 Schritt Morphologie (optional)



Im Schritt *"Morphologie"* haben Sie folgende Möglichkeiten zu wählen:

- ob die Restaurationen vollständig von der Biogenetik berechnet werden sollen,
- ob Sie die Zahnform vorgeben möchten (für Frontzähne),
- ob der Vorschlag anhand eines Datenbankzahns erfolgen soll. In dieser Version stehen Datenbanken von VITA, Candulor und Merz zur Verfügung.

Die Auswahl der Morphologie erfolgt getrennt nach Front- und Seitenzähnen.

Wählen Sie hierzu *"Zahnform"*, um für Frontzähne eine Zahnform vorzugeben oder wählen Sie *"Zahn-DB"*, um einen Datenbankzahn auszuwählen.

WICHTIG

Auswahl aus *"Zahn-DB"* ist Funktionalität des Pro-Moduls.

13.3 Schritt Positionieren (optional)

WICHTIG

Diese Funktion ist aus Präzisionsgründen ausschließlich mit dem Trackball oder Touchpad bedienbar.



Im Schritt *"Positionieren"* können Sie die Aufstellung der Zähne verändern. Die Zähne sind in diesem Schritt noch nicht an den Präparationsrand angerechnet und können frei bewegt werden. Dafür stehen Ihnen die Werkzeuge *"Positionieren und Rotieren"* und *"Skalieren"* zur Verfügung. Fahren Sie mit der Maus über den jeweiligen Zahn, um die Anfasser des Werkzeugs einzublenden. Alternativ können Sie in der Objektleiste die einzelnen Restaurationen anwählen und bekommen die Anfasser im 3D-Modell angezeigt. Die Neupositionierung kann für jeden Zahn einzeln erfolgen oder Sie können benachbarte Restaurationen gruppieren (Option in der Seitenpalette) und somit mehrere Zähne gleichzeitig bearbeiten. Wenn Sie die Zähne gruppieren, berücksichtigt die Software die Kontaktsituation der markierten Zähne, das heißt, wird beispielsweise ein Zahn der Gruppe vergrößert, werden die anderen verkleinert. Der gleiche Mechanismus wirkt beim Positionieren der Zähne. Auch hier werden die Zähne in ihrer Größe den veränderten Gegebenheiten angepasst.

Wenn *"Linear"* aktiviert ist, werden alle gruppierten Restaurationen um den gleichen Wert verschoben, vergrößert oder verkleinert. Die Funktion Linear ist nur aktiv, wenn mehrere Zähne gruppiert wurden.

Bei der Option *"Auf NaturShape ausrichten"* wird die initiale Position des Präparationsrandes zugunsten eines ebenmäßigen Verlaufs des Kieferbogens ignoriert. Damit lassen sich natürliche Fehlstellungen im Kieferbogen bis zu einem gewissen Grad ausgleichen.

Wenn die Funktion *"Eingeschränkte Übernahme"* aktiviert ist (Standard), wird der Erstvorschlag in Form und Position nochmals angepasst, um der Kontaktsituation, Materialstärke und dem Präparationsrand gerecht zu werden. Falls dies nicht gewünscht ist, kann diese Option deaktiviert werden. Dann wird der Vorschlag nur an den Präparationsrand gerechnet und die Form und Aufstellung bleibt erhalten. Dies kann dazu führen, dass Material manuell aufgetragen werden muss, damit Materialwandstärken eingehalten werden.

13.4 Restauration bearbeiten


Das virtuelle Modell dient zur Visualisierung und Konstruktion einer Restauration in 3D.

Nachdem die Restauration berechnet wurde, können Sie die Restauration mit den Werkzeugen der Werkzeugeiste ändern.

Die einzelnen Werkzeuge und ihre Anwendung sind im Abschnitt „Werkzeuge und Funktionen der Seitenpalette [→ 72]“ beschrieben.

Seitenpalette Gruppieren

Sie können mit der Funktion *"Gruppieren"* mehrere Restaurationen gleichzeitig bearbeiten.



1. Öffnen Sie die Seitenpalette *"Gruppieren"*.
2. Wählen Sie die Funktion *"Gruppieren"*.
3. Wählen Sie die gewünschten Zähne/Restaurationen in der Objektleiste oder direkt im Modell an.
 - ↳ Die blaue Selektionsfarbe gibt Auskunft über die zusammengeführten Objekte.
4. Betätigen Sie erneut die Schaltfläche *"Gruppieren"*, um das Gruppieren zu deaktivieren und die selektierten Restaurationen gemeinsam zu bearbeiten.

13.5 Arbeitsmodell, Abdrucklöffel und Schiene

Um Arbeitsmodelle, Abdrucklöffel und Schienen designen zu können, müssen auf Ihrem System die Applikationen inLab Model-App (für Arbeitsmodelle) beziehungsweise inLab Splint-App (für Abdrucklöffel und Schienen) installiert sein.

In der Phase MODELL im Schritt *"Modell anzeigen"* können Sie in die entsprechende Applikation wechseln.



1. Wählen Sie die Seitenpalette *"Werkzeuge"* aus.
2. Wählen Sie *"Design-App starten"* aus.
 - ↳ Die für die gewählte Indikation notwendige inLab-App startet und die Daten des aktuellen Falls werden übertragen.

Alle weiteren Schritte finden in der inLab-App und der Software inLab CAM SW statt.

13.6 Phase abschließen

- ✓ Die nächste Phase ist anwählbar.
 - > Gehen Sie zur nächsten Phase.
- oder
- > Betätigen Sie den Doppelpfeil.
 - ↳ Das Programm wechselt in die nächste Phase.

14 Phase HERSTELLUNG

14.1 Farbe auswählen

14.1.1 CEREC SpeedFire

Bei der Verwendung von Zirkonia und IPS e.max CAD in einem Sinterofen CEREC SpeedFire muss die Farbe des Blocks zuvor in der Software ausgewählt werden. Dies gewährleistet die Anwendung der passenden Parameter.

- ✓ Sie haben in der Phase ADMINISTRATION die Materialien „CEREC Zirconia“, „inCoris TZI C“, „inCoris TZI“ oder „IPS e.max CAD“ ausgewählt.

1. Wählen Sie den Schritt *"Farbe wählen"* aus.
2. Wählen Sie die gewünschte Farbe aus, indem Sie die Farbe im Farbcenter selektieren.
3. Betätigen Sie die Schaltfläche *"OK"*

14.1.2 CEREC Blocs C In



Sie können die Farbe der Restauration und die Inzisalkante für die Materialien „CEREC Blocs C In“ einstellen.

- ✓ Sie haben in der Phase ADMINISTRATION das Material „CEREC Blocs C In“ ausgewählt.

1. Wählen Sie den Schritt *"Farbe wählen"* aus.
2. Wählen Sie die gewünschte Farbe aus, indem Sie die Farbe im Farbcenter selektieren.
3. Betätigen Sie *"Inzisalkante"*.
4. Verstellen Sie gegebenenfalls den Dentinkern der individuellen Situation in die inzisale oder appikale Richtung.
5. Betätigen Sie die Schaltfläche *"OK"*
6. Die Software legt die Restauration entsprechend der angewählten Parameter in den Block.

14.2 Seitenpalette Herstellung/Export

In dieser Seitenpalette können Sie eine Fertigungseinheit festlegen und einen Sinterofen CEREC SpeedFire auswählen (wenn angeschlossen).

Sie können hier auch Bearbeitungsoptionen als Untermenü der entsprechenden Maschine anwählen (siehe „Bearbeitungseinstellungen ändern [→ 145]“).

14.2.1 Manuelles Firmware-Update

Wenn die Firmware der Fertigungseinheit oder des Sinterofens CEREC SpeedFire nicht aktuell ist, wird dies durch ein rotes Ausrufezeichen und einen Tooltip (Pop-up-Fenster, das erscheint wenn man 1-2 Sekunden mit dem Cursor über dem entsprechenden Symbol verharrt) angezeigt. Wenn Sie auf das Symbol klicken, gelangen Sie in das entsprechende Konfigurationsmenü der Fertigungseinheit oder des Sinterofens CEREC SpeedFire. Dort können Sie dann über die Schaltfläche *"Firmware-Download"*, die nach der Prüfung auf Aktualität etwa 5 Sekunden später erscheint, das Update manuell ausführen.

14.2.2 Bearbeitungseinstellungen ändern

14.2.2.1 Schleifen – Herstellungsoptionen

Schleifen – Schnell

WICHTIG
Qualitätsverlust Schnelles Schleifen kann sich negativ auf die Qualität der Restauration auswirken!

Bei einigen Materialien kann auf Wunsch der Schleifprozess beschleunigt werden. Dazu können Sie die Schaltfläche *"Schnell"* aktivieren.

Dieser Modus ist schneller, die Oberfläche der geschliffenen Restauration jedoch etwas rauer.

In diesem Modus wird der Detailgrad automatisch auf *"Hoch"* und der Bearbeitungsmodus auf *"Schnell"* eingestellt.

Schleifen – Fein

Dieser ist der Standard-Schleifmodus und kann für alle Indikationen und Materialien verwendet werden.

In diesem Modus wird der Detailgrad automatisch auf *"Hoch"* und der Bearbeitungsmodus auf *"Normal"* eingestellt.

Schleifen – Extrafein

In Verbindung mit einer CEREC Primemill oder einer MC XL (4-motorige Maschine) haben Sie die Möglichkeit die Option *"Extrafein"* zu wählen.

Hierfür müssen Sie Ihre Maschine mit folgenden Instrumenten bestücken:

CEREC Primemill:

- Im Instrumentenset 1:
 - Links – Diamond 1.0 CS
 - Rechts – Diamond 0.6 CS
- Im Instrumentenset 2:
 - Links – Diamond 1.4 CS
 - Rechts – Diamond 1.2 CS

MC XL:

- Im Instrumentenset 1: Instrumente vom Typ *"Extrafein"*:
 - Links – CYLINDER BUR 12 EF
 - Rechts – CYLINDER POINTED BUR 12 EF
- Im Instrumentenset 2: Instrumente vom Typ „Standard“.

Die Schleifzeiten verlängern sich um ca. 100%.

In diesem Modus wird der Detailgrad automatisch auf *"Sehr hoch"* und der Bearbeitungsmodus auf *"Normal"* eingestellt.

WICHTIG

Die Schleifoption *"Extrafein"* kann nur für endfeste Keramiken ausgewählt werden.

WICHTIG

Ab der CEREC SW 5 wird in der Phase HERSTELLUNG der Parameter *"Okklusaler Offset"* eingestellt. Dieser Wert betrifft nur das Schleifergebnis und die Option ist beim Fräsen nicht verfügbar. Mit dieser Einstellung wird Material auf der gesamten Kaufläche in Okklusalrichtung auf- oder abgetragen. Die Auswirkungen sind nicht in der Software sichtbar.

14.2.2.2 Fräsen – Herstellungsoptionen

Fräsen – Modus "Extraschnell"

Dieser Modus ist nur für CEREC Primemill-Fertigungseinheiten verfügbar und erfordert vier Fräswerkzeuge, die für den parallelen Fräsprozess verwendet werden.

Der ist auch nur verfügbar mit kompatiblen Zirkonoxidblöcken und wenn für die Restauration der Parameter *"Randverstärkung"* auf 100µm oder mehr eingestellt ist.

Dieser Modus kann im Konfigurationsbereich *"CEREC Primemill – Leistung"* aktiviert werden. Im Modus Super Schnell gibt es zwei zusätzliche Optionen: *"Hoch"* und *"Sehr gut"*, mit denen Sie zwischen kürzesten Verarbeitungszeiten oder Oberflächenqualität wählen können.

Fräsen – Modus "Schnell"

Lässt Sonderprozesse weg und vergrößert Schnittparameter sowie den Bahnabstand für optimale Bearbeitungszeiten mit sehr guter Qualität.

Dieser Modus ist nur verfügbar, wenn für die Restauration der Parameter *"Randverstärkung"* auf 100µm oder mehr eingestellt ist.

In diesem Modus wird der Detailgrad automatisch auf *"Hoch"* und der Bearbeitungsmodus auf *"Schnell"* eingestellt.

Fräsen – Modus "Fein"

Umfasst dieselben Prozessschritte wie die Stufe *"Schnell"* aber mit verringertem Bahnabstand.

In diesem Modus wird der Detailgrad automatisch auf *"Hoch"* und der Bearbeitungsmodus auf *"Normal"* eingestellt.

Fräsen – Modus "Extrafein"

Dieser Modus ist nur für CEREC Primemill-Fertigungseinheiten verfügbar. Zusätzlich zu den beiden Fräsinstrumenten, die für die Modi Fräsen *"Schnell"* oder *"Fein"* von Zirkonoxid oder PMMA / Kunststoff verwendet werden, ist ein Bur 0,5 CS erforderlich. Mit diesem Modus können sehr genaue Details bei Fissuren für Kronen und Brücken sowie Interdentalbereiche bei Brücken erzielt werden.

Fräsen – Benutzerdefiniert

Dieser Modus bietet mehr Flexibilität bei der individuellen Einstellung des Detailgrads und des Bearbeitungsmodus.

14.2.2.3 Veneer-Modus

Veneer-Modus

Der Veneer-Modus gewährleistet, dass selbst feinste Strukturen beim Schleifen und Fräsen berücksichtigt werden. Dadurch wird verhindert, dass das Veneer und Frontzahnkronen aufsitzen.

14.2.3 Restauration exportieren

Sie können einzelne Restaurationen exportieren, um Sie

- mit der Software inLab CAM SW zu verarbeiten,
- zum Versand an infiniDent abzuspeichern oder
- in einem anderen Format abzuspeichern.

Tipp: Um angefräste Blöcke wieder zu verwenden, exportieren Sie die Restauration in die Software inLab CAM SW. Das Aufrufen bereits angefräster Blöcke ist in der Schleifvorschau der CEREC SW 5 nicht möglich.

Tipp: Wählen Sie *"Auftrag starten"* an, um die nach inLab CAM SW exportierte Datei direkt mit inLab CAM SW zu öffnen.

inLab CAM-Restaurationen	Das Dateiformat kann nur von der Software inLab CAM SW gelesen werden.
--------------------------	--

WICHTIG

Für die Weiterverarbeitung von *.stl-Daten in einer anderen/externen Software wird von Seiten der Dentsply Sirona keine Verantwortung übernommen.

14.3 Seitenpalette Blockgrößenauswahl

Blockgrößen

In der Seitenpalette *"Blockgrößen"* können Sie die passende Blockgröße auswählen. Initial wird immer die zuletzt ausgewählte oder kleinstmögliche Blockgröße vorselektiert. Diese Voreinstellung kann in der Konfiguration über das Systemmenü vorgenommen werden.

WICHTIG

Mit einem gelben Warnsymbol werden die Blockgrößen gekennzeichnet, welche kleiner sind, als die aktuell selektierte Restauration.

Blockgröße ändern

Die Blockgröße wird von der Software automatisch vorgeschlagen. Sie können die Blockgröße über die Seitenpalette *"Blockgrößen"* ändern.

- > Wählen Sie in der Seitenpalette die gewünschte Blockgröße an. Aufgrund der Größe nicht geeignete Blöcke werden in der Seitenpalette durch ein Zusatzsymbol markiert.
 - ☞ Die Restauration wird in dem von Ihnen gewählten Block positioniert.

14.4 Restauration im Block positionieren

Sie können den Block mit den Positionswerkzeugen um die Restauration verschieben, drehen und die Abstichstelle bestimmen.

Die Werkzeuge sind im Abschnitt „Werkzeuge [→ 72]“ beschrieben.

Bei der fräsenden Bearbeitung stehen 2 Optionen der Anstiftung zur Verfügung. Es wird immer versucht die Restauration in einen Block zu nesten (mehrere Anstichstellen). Um den Block optimal auszunutzen, wechselt die Software bei Einzelelementen auf eine Abstichstelle. Sie können durch die Auswahl eines größeren Blocks jederzeit wieder ein Nest erzeugen.

14.5 Fertigungsprozess starten

Wenn Sie die Konstruktion abgeschlossen und die Restauration in der Vorschau begutachtet haben, können Sie die Restauration herstellen.

Weitere Informationen zum Schleifen oder Fräsen finden Sie in den entsprechenden Gebrauchsanweisungen der Geräte.

14.6 Herstellungsprozess mit Primeprint

Haben Sie in der Phase ADMINISTRATION als Gerät „Primeprint“ ausgewählt, dann findet die Vorbereitung der Herstellung in der Software inLab CAM statt.



1. Wählen Sie in der Phase HERSTELLUNG die Seitenpalette *„Herstellung“*.
2. Wählen Sie *„Export nach inLab CAM“*.
3. Wählen Sie *„Start“*.

Sollten Sie die Software inLab CAM auf dem gleichen System wie die Software CEREC SW 5 oder über ein Netzwerk verfügbar haben, so können Sie über das Kontrollkästchen *„Auftrag starten“* eine inLab CAM-Instanz wählen. Diese inLab CAM-Instanz wird, nachdem Sie *„Start“* gewählt haben, automatisch geöffnet und der aktuelle Fall wird angezeigt.


15 Konstruktionsbeispiele

15.1 Abutment mit Krone - Biogenerik Individuell

Dieses Beispiel beschreibt das Vorgehen zum Konstruieren eines Abutments mit dazu passender Krone bei Vorhandensein intakter Nachbarzähne.

Konstruktionsbeispiel "Abutment" mit Designmodus "Biogenerik individuell" ("Teilen": "Multilayer") am Zahn 26 (#14).

15.1.1 Neue Restauration anlegen

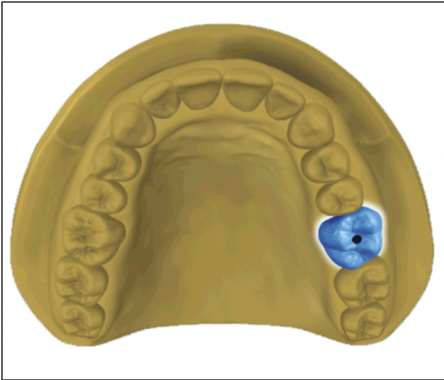

- ✓ Sie haben einen Fall ausgewählt oder neu angelegt.
- ✓ Sie befinden sich in der Phase ADMINISTRATION.
- 1. Wählen Sie die Indikation "Abutment".
- 2. Wählen Sie den Restaurationstyp "Abutment mit Krone".
- 3. Wählen Sie den Designmodus "Biogenerik individuell".
- 4. Wählen Sie als Gerüstmaterial ein Material des gewünschten Herstellers aus, aus dem das Abutment gefertigt werden soll. **Tipp:** Die letzten zwei verwendeten Materialien werden als Favoriten angezeigt.
- 5. Wählen Sie als Verblendstruktur ein Material des gewünschten Herstellers aus, aus dem die Krone gefertigt werden soll.
- 6. Optional: Falls Sie mehrere Fertigungseinheiten verwenden, können Sie im Schritt "Gerät" wählen, welche Fertigungseinheit Sie für den Fall verwenden wollen.
- 7. Wählen Sie die gewünschte TiBase aus.

WICHTIG

Nicht alle TiBasen auswählbar

In Abhängigkeit vom gewählten Gerüstmaterial und für welches Land Ihre Installation aufgesetzt wurde, kann es sein, dass nicht alle TiBasen auswählbar sind.

- 8. Wählen Sie aus, ob Sie TiBase oder ScanPost zum Scannen verwenden.


WICHTIG

Bei intraoraler Anwendung: ScanPost empfohlen

Bei intraoraler Anwendung ist die Verwendung eines ScanPosts zu empfehlen, weil nur dann der korrekte Sitz des Scanbodys überprüft werden kann.

- 9. Wählen Sie den Zahn aus, für den die Restauration angelegt werden soll.
 - ↳ Der gewählte Zahn wird markiert.

15.1.2 Präparation aufnehmen

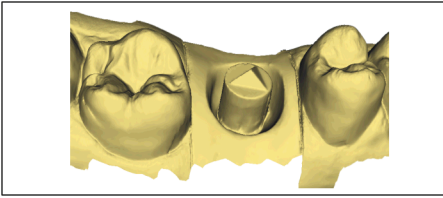


1. Nehmen Sie die Präparation auf (siehe „Phase AUFNAHME“).
2. Wenn Sie ein Emergenzprofil ausgeformt haben, empfiehlt es sich, unmittelbar nach dem Entfernen des Gingivaformers mit der Aufnahme dieses Bereichs zu beginnen.
3. Optional können Sie Aufnahmen des Gegenkiefers und zur bukkalen Bissregistrierung durchführen.
4. Setzen Sie nun den ScanPost mit Scanbody ein. Wechseln Sie in den Bildkatalog *“Scanbody”* für den jeweiligen Kiefer und nehmen Sie den Scanbody auf. **ACHTUNG! Achten Sie darauf, dass der ScanPost selbst, als auch der Übergang von der Gingiva zum ScanPost gut erfasst wurde und keine Unterbrechung aufweist.**
5. Achten Sie darauf, dass Sie auch bezahnte Bereiche mit aufnehmen (immer zwei Zähne zusätzlich), um die Registrierung zur Aufnahme der Präparation zu gewährleisten.
6. Wenn alle erforderlichen Aufnahmen vorliegen, wechseln Sie in die Phase MODELL.

15.1.3 Modell bearbeiten (optional)

Dieser Schritt ist optional. Um in diesen Schritt zu gelangen, müssen Sie ihn anklicken.

- ✓ Der Schritt *“Modell bearbeiten”* ist aktiv.
- 1. Schneiden Sie mit dem Werkzeug *“Ausschneiden”* unnötige Bildbereiche aus (siehe „Modellbereiche wegschneiden [→ 128]“).
- 2. Korrigieren Sie Defekte mit dem Werkzeug *“Ersetzen”* (siehe „Defekte korrigieren [→ 78]“).

15.1.4 Bissregistrierung (optional)

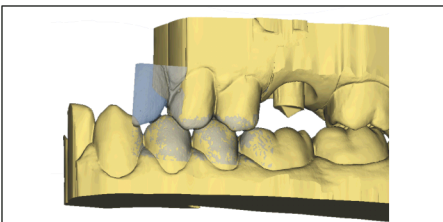

- ✓ Der Schritt *“Bissregistrierung”* ist optional. Die Bissregistrierung erfolgt in der Regel automatisch.
- Führen Sie gegebenenfalls eine manuelle bukkale Registrierung durch (siehe „Bukkale Registrierung“).


15.1.5 Modellachse festlegen (optional)

- ✓ Der Schritt *“Modellachse einstellen”* ist aktiv.
- Legen Sie die Achsen für die Modell-Ausrichtung fest (siehe Modellachse festlegen). Achten Sie dabei auf eine stimmige Darstellung.

15.1.6 Bereiche ausblenden (optional)

WICHTIG

Diese Funktion ist aus Präzisionsgründen ausschließlich mit dem Trackball oder Touchpad bedienbar.

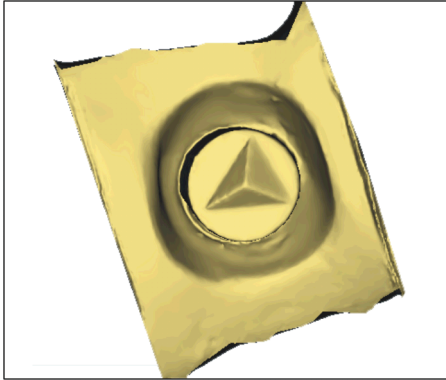

- ✓ Der Schritt "*Trimmen*" ist aktiv.
- Schneiden Sie den distalen und mesialen Nachbarn weg, indem Sie jeweils eine offene Linie eingeben (siehe „Trimmen [-> 79]“).

15.1.7 Scanbody auswählen


- ✓ Der Schritt "*Scanbody anklicken*" ist aktiv.
- Der Scanbody wird automatisch erkannt. Sollte dies nicht korrekt sein, tippen oder klicken Sie doppelt auf den Scanbody, den Sie bearbeiten.

15.1.8 Basislinie bearbeiten

WICHTIG

Diese Funktion ist aus Präzisionsgründen ausschließlich mit dem Trackball oder Touchpad bedienbar.

Der Schritt "*Basislinie bearbeiten*" ist aktiv.

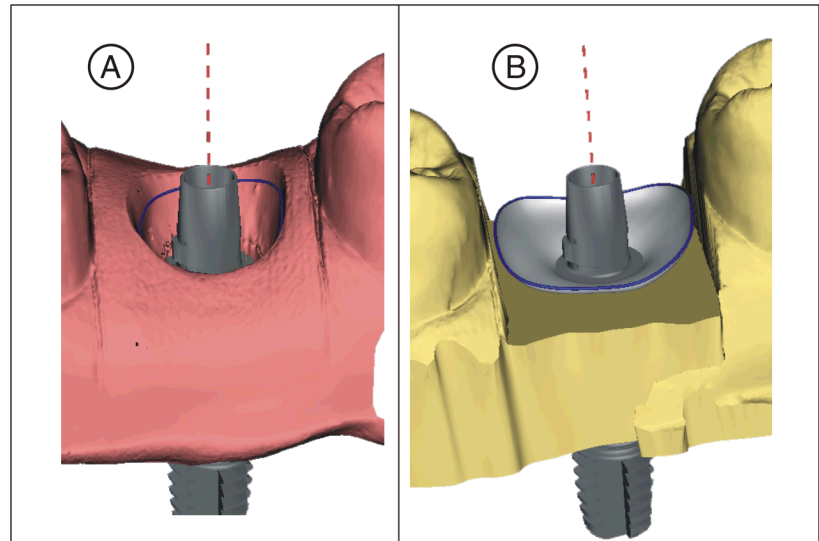

Die Basislinie (Emergenzlinie, blau) wird automatisch vorgeschlagen (A).

Wenn Sie die Option "*Gingivamaske verwenden*" abwählen, wird automatisch ein Emergenzprofil vorgeschlagen (B).

Passen Sie gegebenenfalls die Basislinie wie folgt an.

1. Starten Sie die Eingabe mit einem Doppelklick an einer beliebigen Stelle der Basislinie. Zeichnen Sie eine neue Basislinie durch Klicks entlang des gewünschten Pfades.
2. Beenden Sie die Eingabe mit einem Doppelklick auf einen Punkt der alten Basislinie.

WICHTIG

Das Bearbeiten der Basislinie ist beim automatischen Emergenzprofil, wie auch beim auf der Gingiva basierenden Emergenzprofil möglich.

Die Basislinie für Zwischenglieder kann auch auf der Gingivamaske eingegeben werden. Dazu muss die entsprechende Option im Werkzeug aktiviert werden.

15.1.9 Restauraionsachse definieren

Legen Sie die Abwinkelung für das Abutment fest (siehe „Restauraionsachse bei Implantat-Abutment [-> 140]“).

15.1.10 Parameter anpassen

- ✓ Der Schritt "*Restaurationsparameter*" ist optional.
- 1. Passen Sie gegebenenfalls die Parameter an.
- 2. Bestätigen Sie die Änderungen mit "*Ok*".
 - ↳ Der Erstvorschlag wird anschließend automatisch berechnet.

15.1.11 Restauration bearbeiten

Das virtuelle Modell dient zur Visualisierung und Konstruktion einer Restauration in 3D.

Nachdem die Restauration berechnet wurde, können Sie die Restauration mit den Werkzeugen der Werkzeugleiste ändern.

Die einzelnen Werkzeuge und ihre Anwendung sind im Abschnitt „Werkzeuge und Funktionen der Seitenpalette [→ 72]“ beschrieben. Es ist vorteilhaft, zunächst die äußere Form der Restauration final zu gestalten, bevor Sie diese in Abutment und Krone teilen.

Beginnen Sie zunächst mit den groben Werkzeugen und positionieren Sie die Restauration. Führen Sie dann kleinere Korrekturen aus. Für den Bereich der Krone gelten dieselben Bearbeitungsempfehlungen wie für Kronen auch.

Zur Anpassung des Emergenzprofils empfiehlt sich die Anwendung des Werkzeuges "*Gestalten*" / "*Kreisförmig*".

Um die Dicke ihrer Restauration oder des Abutments einschätzen zu können, wählen Sie das Analysewerkzeug "*Schichtachse*".


Schichten einzeln bearbeiten



- ✓ Der Schritt *"Restauration bearbeiten"* ist aktiv.
- 1. Wählen Sie das Werkzeug *"Teilen"*.
 - ↳ Die Krone wird transparent dargestellt.
- 2. Betätigen Sie den Pfeil in der Kontextleiste an der unteren Bildkante.
 - ↳ Die Auswahl der Restauration erweitert sich. Es werden 2 Restaurationen für die Zahnposition dargestellt.
- 3. Betätigen Sie das Symbol für Krone oder Abutment, um zwischen den beiden Restaurationen zu wechseln.
- 4. Bearbeiten Sie die jeweils aktive Restauration mit den Werkzeugen aus der Seitenpalette.
- 5. Beginnen Sie mit der Bearbeitung des Abutments. Verwenden Sie das Werkzeug *"Skalieren"*, um die Höhe des Abutments und den Verlauf der Schulter anzupassen.
- 6. Beachten Sie, dass Änderungen am Abutment sich auf das Design der Krone auswirken. Durch den Wechsel zur Krone können Sie überprüfen, ob z. B. nach einer Verschmälerung der Schulter die Mindestwandstärke der Krone noch eingehalten würde.

Wechseln Sie in die Phase HERSTELLUNG. Beide Restaurationsschichten müssen einzeln ausgearbeitet werden.

15.1.12 Restaurationen herstellen

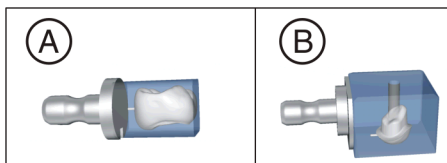


1. Wählen Sie im Schritt *"Schleifeinheit"* das Gerät, mit dem die Restauration bearbeitet werden soll.
2. Ändern Sie im Schritt *"Blockgröße ändern"* gegebenenfalls die Blockgröße.
3. Positionieren Sie im Schritt *"Schleifposition einstellen"* gegebenenfalls die Position der Restauration im Block.
4. Starten Sie den Bearbeitungsvorgang.

15.2 Verschraubte Krone - Biogenerik Individuell

Dieses Beispiel beschreibt das Vorgehen zum Konstruieren einer direktverschraubten Krone bei Vorhandensein intakter Nachbarzähne.

Konstruktionsbeispiel "Abutment" mit Designmodus "Biogenerik individuell" am Zahn 26 (#14)

15.2.1 Neue Restauration anlegen

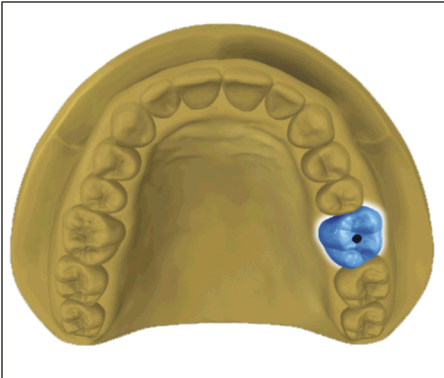

- ✓ Sie haben einen Fall ausgewählt oder neu angelegt.
- ✓ Sie befinden sich in der Phase ADMINISTRATION.
- 1. Wählen Sie die Restaurationsart "Abutment".
- 2. Wählen Sie den Restaurationstyp "Direkt verschraubte Krone".
- 3. Wählen Sie den Designmodus "Biogenerik individuell".
- 4. Wählen Sie ein Material des gewünschten Herstellers aus, aus dem die Krone gefertigt werden soll.
- 5. Optional: Falls Sie mehrere Fertigungseinheiten verwenden, können Sie im Schritt "Gerät" wählen, welche Fertigungseinheit Sie für den Fall verwenden wollen.
- 6. Wählen Sie die gewünschte TiBase aus.

WICHTIG

Nicht alle TiBase auswählbar

In Abhängigkeit vom gewählten Gerüstmaterial und für welches Land Ihre Installation aufgesetzt wurde, kann es sein, dass nicht alle TiBase auswählbar sind.

- 7. Wählen Sie aus, ob Sie TiBase oder ScanPost zum Scannen verwenden.


WICHTIG

Bei intraoraler Anwendung: ScanPost empfohlen

Bei intraoraler Anwendung ist die Verwendung eines ScanPosts zu empfehlen, weil nur dann der korrekte Sitz des Scanbodys überprüft werden kann.

- 8. Wählen Sie den Zahn aus, für den die Restauration angelegt werden soll.
 - ↳ Der gewählte Zahn wird markiert.
- 9. Wechseln Sie in die Phase AUFNAHME.

15.2.2 Präparation aufnehmen

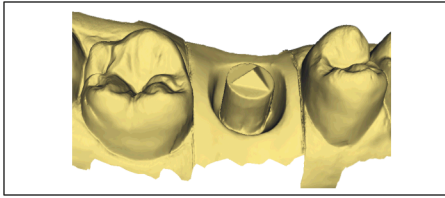


1. Nehmen Sie die Präparation auf (siehe „Phase AUFNAHME“).
2. Wenn Sie ein Emergenzprofil ausgeformt haben, empfiehlt es sich, unmittelbar nach dem Entfernen des Gingivaformers mit der Aufnahme dieses Bereichs zu beginnen.
3. Optional können Sie Aufnahmen des Gegenkiefers und zur bukkalen Bissregistrierung durchführen.
4. Setzen Sie nun den ScanPost mit Scanbody ein. Wechseln Sie in den Bildkatalog *“Scanbody”* für den jeweiligen Kiefer und nehmen Sie den Scanbody auf. **ACHTUNG! Achten Sie darauf, dass der ScanPost selbst, als auch der Übergang von der Gingiva zum ScanPost gut erfasst wurde und keine Unterbrechung aufweist.**
5. Achten Sie darauf, dass Sie auch bezahnte Bereiche mit aufnehmen (immer zwei Zähne zusätzlich), um die Registrierung zur Aufnahme der Präparation zu gewährleisten.
6. Wenn alle erforderlichen Aufnahmen vorliegen, wechseln Sie in die Phase MODELL.

15.2.3 Modell bearbeiten (optional)

Dieser Schritt ist optional. Um in diesen Schritt zu gelangen, müssen Sie ihn anklicken.

- ✓ Der Schritt *“Modell bearbeiten”* ist aktiv.
- 1. Schneiden Sie mit dem Werkzeug *“Ausschneiden”* unnötige Bildbereiche aus (siehe „Modellbereiche wegschneiden [-> 128]“).
- 2. Korrigieren Sie Defekte mit dem Werkzeug *“Ersetzen”* (siehe „Defekte korrigieren [-> 78]“).

15.2.4 Bissregistrierung (optional)

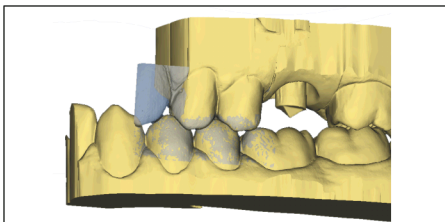

- ✓ Der Schritt *“Bissregistrierung”* ist optional. Die Bissregistrierung erfolgt in der Regel automatisch.
- Führen Sie gegebenenfalls eine manuelle bukkale Registrierung durch (siehe „Bukkale Registrierung“).


15.2.5 Modellachse festlegen (optional)

- ✓ Der Schritt *“Modellachse einstellen”* ist aktiv.
- Legen Sie die Achsen für die Modell-Ausrichtung fest (siehe Modellachse festlegen). Achten Sie dabei auf eine stimmige Darstellung.

15.2.6 Bereiche ausblenden (optional)

WICHTIG

Diese Funktion ist aus Präzisionsgründen ausschließlich mit dem Trackball oder Touchpad bedienbar.

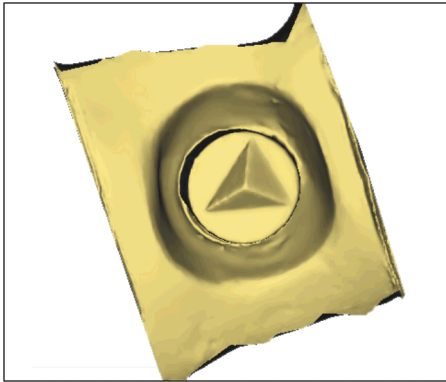

- ✓ Der Schritt "*Trimmen*" ist aktiv.
- Schneiden Sie den distalen und mesialen Nachbarn weg, indem Sie jeweils eine offene Linie eingeben (siehe „Trimmen [-> 79]“).

15.2.7 Scanbody auswählen


- ✓ Der Schritt "*Scanbody anklicken*" ist aktiv.
- Der Scanbody wird automatisch erkannt. Sollte dies nicht korrekt sein, tippen oder klicken Sie doppelt auf den Scanbody, den Sie bearbeiten.

15.2.8 Basislinie bearbeiten

WICHTIG

Diese Funktion ist aus Präzisionsgründen ausschließlich mit dem Trackball oder Touchpad bedienbar.

Der Schritt "*Basislinie bearbeiten*" ist aktiv.

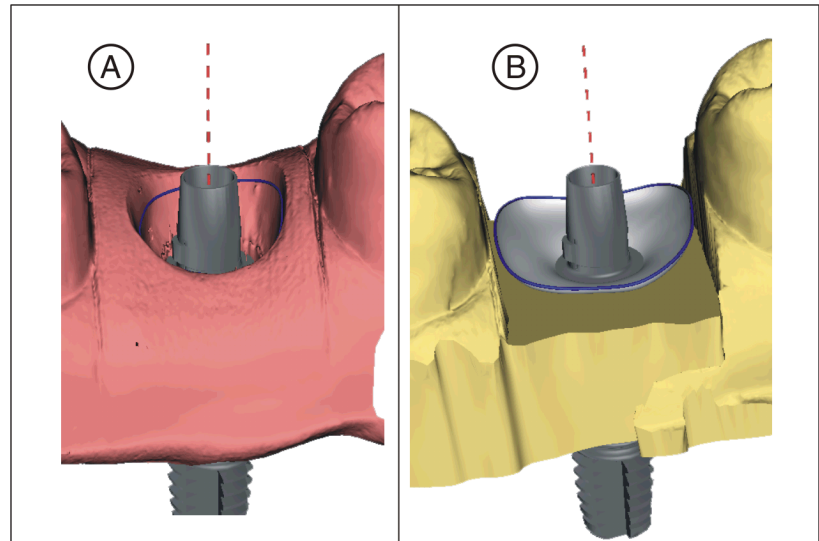

Die Basislinie (Emergenzlinie, blau) wird automatisch vorgeschlagen (A).

Wenn Sie die Option "*Gingivamaske verwenden*" abwählen, wird automatisch ein Emergenzprofil vorgeschlagen (B).

Passen Sie gegebenenfalls die Basislinie wie folgt an.

1. Starten Sie die Eingabe mit einem Doppelklick an einer beliebigen Stelle der Basislinie. Zeichnen Sie eine neue Basislinie durch Klicks entlang des gewünschten Pfades.
2. Beenden Sie die Eingabe mit einem Doppelklick auf einen Punkt der alten Basislinie.

WICHTIG

Das Bearbeiten der Basislinie ist beim automatischen Emergenzprofil, wie auch beim auf der Gingiva basierenden Emergenzprofil möglich.

Die Basislinie für Zwischenglieder kann auch auf der Gingivamaske eingegeben werden. Dazu muss die entsprechende Option im Werkzeug aktiviert werden.

15.2.9 Restauraionsachse definieren

Dieser Arbeitsschritt kann übersprungen werden.

15.2.10 Parameter anpassen

✓ Der Schritt "*Restauraionsparameter*" ist optional.

1. Passen Sie gegebenenfalls die Parameter an.
2. Bestätigen Sie die Änderungen mit "Ok".
 - ↳ Der Erstvorschlag wird anschließend automatisch berechnet.

15.2.11 Restauration bearbeiten

Das virtuelle Modell dient zur Visualisierung und Konstruktion einer Restauration in 3D.

Nachdem die Restauration berechnet wurde, können Sie die Restauration mit den Werkzeugen der Werkzeugeiste ändern.

Die einzelnen Werkzeuge und ihre Anwendung sind im Abschnitt „Seitenpalette“ beschrieben.

Beginnen Sie zunächst mit den groben Werkzeugen und positionieren Sie die Restauration. Führen Sie dann kleinere Korrekturen aus. Für den Bereich der Krone gelten die selben Bearbeitungsempfehlungen wie für Kronen auch.

Zur Anpassung des Emergenzprofils empfiehlt sich die Anwendung des Werkzeuges *"Gestalten" / "Kreisförmig"*.

- ✓ Der Schritt *"Restauration bearbeiten"* ist aktiv.
- > Bearbeiten Sie die Restauration mit den Werkzeugen aus der Seitenpalette.

Um die Dicke ihrer Restauration einschätzen zu können, wählen Sie das Analysewerkzeug *"Schichtachse"*.

15.2.12 Restauration schleifen

1. Wählen Sie im Schritt *"Schleifeinheit"* das Gerät, mit dem die Restauration geschliffen werden soll.
2. Ändern Sie im Schritt *"Blockgröße ändern"* gegebenenfalls die Blockgröße.
3. Positionieren Sie im Schritt *"Schleifposition einstellen"* gegebenenfalls die Position der Restauration im Block.
4. Starten Sie den Schleifvorgang.

16 Tastenkürzel

Tipp: Um Tastenkürzel zu erfahren, drücken und halten Sie die Taste „Alt“ auf der Tastatur. Es werden alle verfügbaren Funktionen, die via Tastenkürzel erreichbar sind, auf den entsprechenden Schaltflächen sichtbar.

Systemmenü

Tastenkürzel	Bedeutung
Strg + N	Schließt den aktuellen Fall und die Anwendung kehrt in den Startscreen zurück.
Strg + S	Speichert den aktuellen Fall.
Strg + Alt + S	Speichert den aktuellen Fall unter einem neuen Patienten ab.
Strg + I	Öffnet den Datei-Importdialog zum importieren einer Datei.
Strg + E	Öffnet den Datei-Exportdialog zum exportieren des aktuellen Falls.
Strg + Q, Alt + F4	Beendet die Anwendung.
F1	Öffnet die Hilfe.
Alt + F2	Öffnet die Konfiguration
F11	Vollbildmodus

Phasen

Tastenkürzel	Bedeutung
Strg + F1	Wechselt in die Phase ADMINISTRATION, wenn verfügbar.
Strg + F2	Wechselt in die Phase SCAN, wenn verfügbar.
Strg + F3	Wechselt in die Phase MODELL, wenn verfügbar.
Strg + F4	Wechselt in die Phase DESIGN, wenn verfügbar.
Strg + F5	Wechselt in die Phase HERSTELLUNG, wenn verfügbar.
Strg + F2	Öffnet die Konfiguration, wenn sie verfügbar ist.

Werkzeugrad und Seitenpalette aufrufen

Tastenkürzel	Bedeutung
Alt + V	Öffnet das Menü <i>"Ansichtsoptionen"</i> in der Seitenpalette.
Alt+ T	Öffnet das Menü <i>"Werkzeuge"</i> in der Seitenpalette.
Alt + D	Öffnet das Menü <i>"Objekte anzeigen"</i> in der Seitenpalette.
Alt +A	Öffnet das Menü <i>"Analysewerkzeuge"</i> in der Seitenpalette.
Alt +L	Öffnet das Menü <i>"Linkoptionen"</i> .

Tastenkürzel	Bedeutung
Strg + Num 3	Wechselt in die bukkale Ansicht, Links
Strg + Num 5	Wechselt in die zentrierte Ansicht
Strg + Num 2	Wechselt in die zervikale Ansicht, Unten
Strg + Num 9	Wechselt in die distale Ansicht, Hinten
Strg + Num 7	Wechselt in die linguale Ansicht, Rechts
Strg + Num 1	Wechselt in die mesiale Ansicht, Vorne
Strg + Num 8	Wechselt in die okklusale Ansicht, Oben

Analysewerkzeuge

Tastenkürzel	Bedeutung
Strg + O	Blendet die okklusale Kontakte ein oder aus.
Strg + B	Blendet den Kasten des Modells ein oder aus.
Strg + C	Startet/Beendet das "Schnitt"-Analysewerkzeug.
Strg + D	Blendet die Details am Maus-Zeiger (Cursor) ein oder aus
Strg + T	Startet/Beendet das Distanz-Analysewerkzeug.
Strg + G	Blendet das Gitter ein oder aus.
Strg + Alt + M	Blendet die Modellfarbe ein und aus.

Aufnahmen

Tastenkürzel	Bedeutung
1	In den Bildkatalog Unterkiefer wechseln
2	In den Bildkatalog Oberkiefer wechseln
3	In den Bildkatalog Bukkal wechseln
4-9	Fügt Bildkataloge nach ihrer Reihenfolge der Seitenpalette hinzu und wählt diese direkt aus.
Pfeil rechts	Wechselt nach rechts zum nächsten Bildkatalog. Falls dieser noch nicht vorhanden ist, wird der entsprechende Bildkatalog angelegt.
Pfeil links	Wechselt nach links zum nächsten Bildkatalog. Falls dieser noch nicht vorhanden ist, wird der entsprechende Bildkatalog angelegt.
Leertaste	Schaltet die Kamera ein oder aus
Return	Wechselt in den manuellen Modus bzw. löst eine Aufnahme aus
+	Startet die Aufnahmen im Modus für die automatische Aufnahme
-	Beendet die Aufnahmen im Modus für die automatische Aufnahme

Werkzeuge – Restauration bearbeiten

Tastenkürzel	Bedeutung
Alt + F	Öffnet das Werkzeug <i>"Formen"</i> .
Alt + S	Öffnet das Werkzeug <i>"Gestalten"</i> .
Alt + R	Öffnet das Werkzeug <i>"Reduzieren"</i> .
Alt + B	Öffnet das Werkzeug <i>"Biogenerische Variation"</i> .
Alt + C	Öffnet das Werkzeug <i>"Kontakte"</i> .
Alt + M	Öffnet das Werkzeug <i>"Positionieren und Rotieren"</i> .
Alt + X	Öffnet das Werkzeug <i>"Neu berechnen"</i> .
Alt + L	Öffnet das Werkzeug <i>"Verbinderlinien"</i> .
Alt + O	Öffnet das Werkzeug <i>"Verbinder verschieben"</i> .
Alt + I	Öffnet das Werkzeug <i>"Labiale Variation"</i> .
Alt + E	Öffnet das Werkzeug <i>"Basislinie bearbeiten"</i> .
Strg + C	Aktiviert das Analysewerkzeug <i>"Schnitt"</i> .

Werkzeuge – Modell bearbeiten

Tastenkürzel	Bedeutung
Alt + C	Öffnet das Werkzeug <i>"Ausschneiden"</i> .
Alt + E	Öffnet das Werkzeug <i>"Werkzeug ersetzen..."</i> .
Alt + F	Öffnet das Werkzeug <i>"Formen"</i> .
Alt + R	Öffnet das Werkzeug <i>"Modell zurücksetzen"</i> .
Strg + Z	Rückgängig
Strg + Y	Wiederholen
Strg + Alt + Z	Setzt die Änderungen, die mit dem Werkzeug gemacht wurden, zurück.
Strg + C	Kopieren
Strg + V	Einfügen
Strg + X	Ausschneiden
Strg + A	Alles markieren

Werkzeuge – Objekte anzeigen

Tastenkürzel	Bedeutung
Strg + B	Blendet den Kasten des Modells ein oder aus.
Strg + M	Öffnet das Werkzeug <i>"Mindeststärke"</i> .
Strg + U	Blendet den Kiefer aus, in dem die aktive Restauration liegt.

17 Portal Connect Case Center

17.1 Portal Connect Case Center starten

- ✓ Das Startfenster ist aktiv.
- > Betätigen Sie im Schrittmnü die Schaltfläche "*Sirona Connect-Portal*".
 - ↳ Es erscheint das Anmeldefenster.

Hier können Sie sich am Portal Connect Case Center anmelden. Dafür müssen Sie auf der Homepage Connect Case Center als Praxis registriert sein.

17.2 Registrierung und Funktionen des Portals Connect Case Center

1. Gehen Sie auf die Homepage Connect Case Center und klicken auf "*Praxisregistrierung*".
 - ↳ Die Anwendungssoftware leitet Sie nun durch den Anmeldeprozess.
2. Geben Sie dort alle erforderlichen Informationen ein.
 - ↳ Nach erfolgreicher Registrierung erhalten Sie von dem Portal Connect Case Center eine E-Mail mit einem Aktivierungslink.
3. Folgen Sie dem Link in der E-Mail, um Ihr Konto zu aktivieren.

Unter "*Mein Konto*" haben Sie die Möglichkeit, ihre Nutzerdaten zu ändern und zusätzliche Informationen wie Ihren Skype™-Benutzernamen zu hinterlegen.

Unter "*Meine bevorzugten Labore*" lassen sich bis zu 5 Labore hinzufügen, mit denen Sie über das Portal Connect Case Center arbeiten können. Wählen Sie dafür "*Labore suchen*" und geben Sie mindestens Ihre Postleitzahl und einen Umkreis der Suche ein. Über die Schaltflächen "*Hinzufügen*" und "*Entfernen*", können Sie Ihre bevorzugten Labore anpassen.

Unter dem Link "*Externe Portale*" haben Sie die Möglichkeit das Portal Connect Case Center mit anderen Portalen zu verknüpfen. Wenn Sie sich mit anderen Portalen verbinden, gelten die datenschutzrechtlichen Bedingungen des anderen verbundenen Portals. Je nach externem Portal benötigen Sie deren Zugangsdaten, um sich anzumelden.

Zusätzlich können Sie in diesem Bereich Ihr Passwort ändern und Ihre Auftragsliste anzeigen lassen.

Unter der Option "*Benutzerverwaltung*" können Sie neue Benutzer anlegen, wenn z. B. mehrere Anwender in einer Praxis arbeiten, und deren Zugriffsrechte verwalten.

17.3 Modell an das Portal Connect Case Center senden

Modell-Daten im Portal Connect Case Center

Innerhalb des Portals Connect Case Center werden die Kontaktdaten der Nutzer gespeichert und gegebenenfalls zur Kontaktaufnahme seitens Dentsply Sirona verwendet. Die Nutzer sollen Patientendaten möglichst nur in anonymisierter Form über das Portal Connect Case Center versenden. Diese Daten werden im Portal in regelmäßigen Intervallen gelöscht.

- ✓ Sie sind auf "<https://customer.connectcasecenter.com/>" als Zahnarzt registriert.
- ✓ In Ihren Kontoeinstellungen ist mindestens ein favorisiertes Labor ausgewählt.
- > Klicken Sie auf die Schaltfläche "*Connect Case Center*".

17.4 Aus der Connect-Software am Portal anmelden

1. Geben Sie Benutzername und Passwort ein.
2. Wenn Sie wollen, dass Benutzername und Passwort gespeichert werden, aktivieren Sie die entsprechende Option.
3. Klicken Sie im Schrittmenü auf "*Ok*".
 - ↳ Das Hochladen der Daten erfolgt parallel zur Eingabe der Informationen im Portal.

17.5 Restaurationsinformationen überprüfen

Im ersten Schritt können Sie die Restaurationsinformationen überprüfen.

Links in der Übersicht werden die Restaurationsinformationen zu jeder Restauration dargestellt, die in der Phase "*ADMINISTRATION*" angelegt wurden.

Wenn die Daten nicht korrekt sind, müssen Sie sie in der Phase "*ADMINISTRATION*" ändern. Sie können das Portal über die Schaltfläche mit dem Kreuz rechts oben im Fenster verlassen.

Wenn die Daten korrekt sind, können Sie "*Bestelldaten eingeben*" betätigen, um zum nächsten Schritt zu gelangen.

17.6 Bestelldaten eingeben

In diesem Schritt können Sie das Labor auswählen, an das der Fall gesendet werden soll, sowie das gewünschte Lieferdatum eingeben.

WICHTIG

Maximal 5 Labore

Sie können maximal 5 Labore in der Liste Ihrer favorisierten Labore speichern.

Über *"Bearbeiten Sie Ihre bevorzugten Labore"* können Sie neue Labore hinzufügen oder Labore aus der Liste löschen.

Unter *"Rückgabedatum"* können Sie das Lieferdatum auswählen, indem Sie auf den gewünschten Tag im Kalender klicken. Unter *"Zeit"* können Sie ebenfalls eine Lieferzeit angeben.

Anschließend können Sie auf *"Zusätzliche Informationen hinzufügen"* klicken, um zum nächsten Schritt zu gelangen. Ihr bevorzugtes Labor hat gegebenenfalls individuelle Bestellinformationen hinterlegt, die zusätzlich zum Rückgabedatum eingetragen werden müssen.

17.7 Zusätzliche Informationen hinzufügen

In diesem Schritt müssen Sie das Geschlecht des Patienten und die Versicherungsart (nur Deutschland) angeben.

Unter *"Zusätzliche Anweisungen"* steht entweder ein Freitextfeld zur Verfügung oder es werden individuelle Felder für weitere Informationen angezeigt, die von Ihrem Labor erstellt wurden.

Mit der Funktion *"Zusätzliche Dateien"* können Sie zusätzliche Dateien (Fotos) mitsenden.

Anschließend können Sie auf die Schaltfläche *"In den Warenkorb"* klicken, um zum Warenkorb zu gelangen oder auf *"Versenden"* klicken, um den Auftrag sofort zu verschicken.

17.8 Warenkorb

Im Warenkorb können Sie die Auftragsdetails überprüfen, verändern oder den Auftrag aus dem Warenkorb löschen.

Sobald die Datei komplett hochgeladen ist und alle Angaben korrekt sind, können Sie den Auftrag über *"Warenkorb senden"* an Ihr Labor senden. Dazu müssen Sie unter *"Überprüfung"* Ihr Passwort eingeben und dieses mit *"Ok"* bestätigen. Im Anschluss wird automatisch die Auftragsliste eingeblendet.

17.9 Auftragsliste

In der Auftragsliste werden alle gesendeten Aufträge angezeigt. Der zuletzt gesendete Auftrag steht immer oben.

Über die Filter neben der Liste können die Aufträge nach den verschiedenen Status gefiltert werden.

Um die Auftragsdetails einzusehen, müssen Sie den entsprechenden Auftrag in der Liste anklicken, sodass er orangefarben markiert ist. Dann können Sie die Details ansehen, indem Sie im Schrittmenu auf *"Bestellung anzeigen"* klicken.

Über das Schrittmenu können einzelne Informationen zum markierten Auftrag abgerufen werden.

18 Herstellung eines CEREC Guide 2

18.1 Optische Abformung

18.1.1 ADMINISTRATION

1. Wählen Sie als Restaurationstyp "*CEREC Guide*" aus.
↳ Das Häkchen "*Prothetische Planung*" ist automatisch gesetzt.
2. Wählen Sie diese Option ab, wenn Sie keinen prothetischen Vorschlag erzeugen möchten. Beachten Sie aber, dass ein Export der Daten ohne prothetische Planung nur im Format *.SIXD möglich ist.
3. Klicken Sie im Zahnschema auf die Zahnposition, für die ein CEREC Guide und ein prothetischer Vorschlag erzeugt werden soll.
4. Wechseln Sie in die Phase AUFNAHME.

18.1.2 AUFNAHME

- > Scannen Sie die Mundsituation entweder intraoral oder vom Modell. Nehmen Sie dabei mindestens alle Bereiche auf, die später als Abstützung für den CEREC Guide verwendet werden sollen. Der Oberflächenscan wird auch zur Überlagerung mit dem Röntgenvolumen verwendet.

ACHTUNG

Beachten Sie, dass die Bohrschablone nicht größer sein kann, als der gescannte Bereich.

Vermeiden Sie Löcher im Scan. An diesen Stellen kann ansonsten keine Auflagefläche für den CEREC Guide bestimmt werden.

18.1.3 DESIGN

Mit Eintritt in die Phase DESIGN wird automatisch eine Basislinie berechnet und darauf ein prothetischer Vorschlag generiert. Zur Anpassung können Sie die Basislinie editieren oder die anderen Werkzeuge zur Bearbeitung für Kronen verwenden.

Im Schritt "*Exportieren/Importieren*" können Sie den Datensatz im Format *.SIXD oder *.SSI exportieren.

Wählen Sie bevorzugt das Datenformat *.SIXD, um auch Textur und Farbe des Scans exportieren zu können als auch keine, einen oder mehrere prothetische Vorschläge. Die Weiterverarbeitung ist nur in Sicat Implant 2.0 oder höher möglich.

Wählen Sie die Option *.SSI nur dann aus, wenn die Implantatplanung in Galileos Implant ausgeführt werden soll oder die Bohrschablone mit inLab SW 20.0 oder kleiner designt und ausgearbeitet werden soll.

18.2 3D-Röntgen und Implantatplanung

Eine DVT-Aufnahme kann vor oder nach der optischen Abformung durchgeführt werden. Achten Sie darauf, dass der Scan keine Metallartefakte enthält. Diese können eine Überlagerung von optischen Daten mit dem Röntgenvolumen erschweren oder unmöglich machen. Scannen Sie den Patienten nicht in Schlussbissstellung sondern mit leicht geöffnetem Kiefer. Entfernen Sie alle abnehmbaren Metallteile im Gegenkiefer (z.B. Prothesen). Nehmen Sie wenn möglich 3/4 eines Kieferbogens auf. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, artefaktfreie Zähne zur Registrierung verwenden zu können.

Zur Implantatplanung in Sicut Implant muss der zuvor erzeugte *.SIXD- oder *.SSI-Datensatz importiert werden. Zur Implantatplanung in Galileos Implant kann ausschließlich *.SSI verwendet werden. Der optische Oberflächenscan wird dem Röntgenvolumen überlagert. Dadurch wird es möglich, die Implantatlage auch unter Berücksichtigung des Weichgewebes und der prothetischen Planung festzulegen.

VORSICHT

Überprüfen Sie, dass die optische Abformung korrekt zum Röntgendatensatz ausgerichtet ist.


Wenn *.SSI als Datenformat verwendet wird und mehrere prothetische Vorschläge berücksichtigt werden sollen, müssen mehrere *.SSI Datensätze importiert werden.

Befolgen Sie zum Planen des Implantats die Anweisungen im Anwenderhandbuch der entsprechenden Software (Sicut Implant oder Galileos Implant).

Wählen Sie als Hülsensystem Sirona - CEREC Guide Drill Keys (CEREC Guide 2, SICAT Surgical Guides) aus. Ihnen stehen dann drei verschiedene Hülsen zur Auswahl, die den jeweiligen CEREC Guide Drill Keys S, M oder L entsprechen.

Wenn z.B. nur eine Pilotbohrung geführt werden soll, ist die Auswahl der Größe S ausreichend (außer Camlog).

Die Festlegung des Tiefenstopps orientiert sich an der Länge des verwendeten Bohrers. Die geplante Position wird beim Bohren dann erreicht, wenn der mechanische Stopp des Bohrers auf dem Bohrschlüssel aufsetzt oder (wenn der Bohrer keinen Anschlag besitzt) die Längenmarkierung auf dem Bohrer bis zur Oberseite des Bohrschlüssels abgesenkt ist.

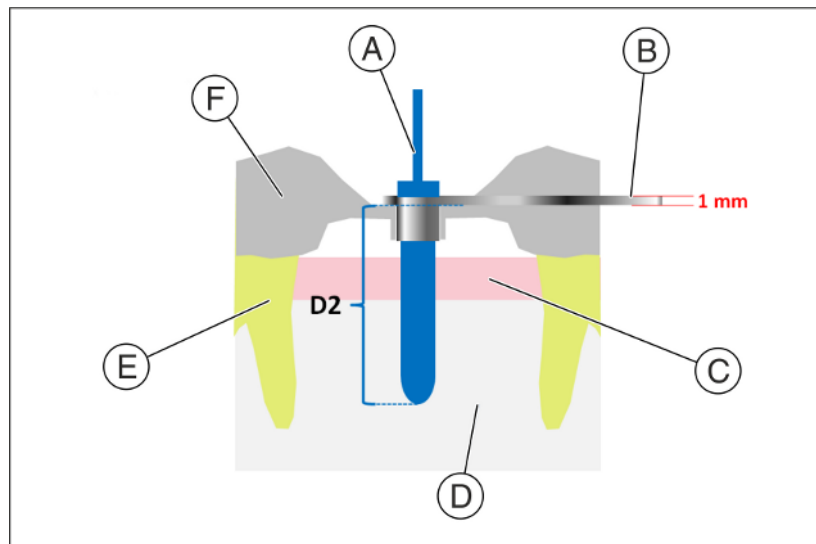

A	Bohrer	D	Knochen
B	CEREC Guide Drill Key	E	Zahn
C	Gingiva	F	CEREC Guide 2

In der Implantatplanungssoftware ist der Tiefenstopp über den D2-Wert einzugeben. Der D2-Wert ist als Abstand der Bohrschablonenoberseite zur apikalen Spitze des Implantats definiert. Da der Bohrer auf dem 1 mm dicken Bohrschlüssel anschlägt, ergibt sich der einzustellende D2-Wert aus der Bohrerlänge abzüglich eines Millimeter ($D2 = \text{Bohrerlänge} - 1 \text{ mm}$).

Die Angabe des D1-Wertes ist zu ignorieren.

Nach Eingabe des D2-Wertes wird die Hülse in der entsprechenden Höhe über dem Implantat visualisiert.

ACHTUNG

Achten Sie bei der Auswahl darauf, dass die Hülse nicht mit benachbarten Zähnen kollidiert und auch ein kollisionsfreies Einführen des Bohrschlüssels und des Bohrers möglich ist. Beachten Sie, dass die Auswahl einer kleineren Hülse die Verwendung größerer Bohrer Durchmesser limitieren kann. Das Camlog Guided System ist nur mit der Hülse L kompatibel.

Wenn die Darstellung der Hülseunterseite den als gelbe Linie dargestellten optischen Scan schneidet, deutet dies darauf hin, dass die Position des Bohrschlüssels mindestens teilweise subgingival liegen wird.

Mehrere Implantate und Hülsepositionen werden auf analoge Weise geplant. Der Export ist in einer Datei möglich. Exportieren Sie die Planung zur „Verarbeitung durch Drittanbieter mittels optischer Abdrücke“ als *.CMG.DXD Datei.

18.3 Design und Ausarbeitung des CEREC Guide 2

Ihnen stehen zwei Wege zur Verfügung, um die Implantatplanungsdaten zu importieren:

1. Wenn der Fall, wie in Kapitel „Optische Abformung [→ 168]“ beschrieben, auf demselben Gerät angelegt wurde, fahren Sie unmittelbar im Schritt *"Exportieren/Importieren"* fort, indem Sie im Werkzeugfenster auf *"Planungsdaten importieren"* klicken und die *.CMG.DXD-Planungsdatei laden.
2. Wenn Sie auf einem anderen Gerät fortfahren, können Sie die *.CMG.DXD-Planungsdatei über die Auswahl *"Importieren"* im Systemmenü direkt laden.

18.3.1 Phase DESIGN

Mit dem Import der Planungsdaten wechseln Sie in die Phase DESIGN und die Berechnung der Bohrschablone wird automatisch gestartet.

Die Position und Form der Hülse kann nicht mit den allgemeinen Designwerkzeugen verändert werden.

Werden Bereiche oberhalb der Supportgeometrie rot dargestellt, können Sie versuchen die Dicke der Schablone im Schritt *"CEREC Guide-Parameter"* zu verringern. Wenn dies nicht möglich ist, sollten Sie die Position des Implantats in der Planungssoftware anpassen.

Werden Bereiche unterhalb der Supportgeometrie rot dargestellt, liegen Teile davon subgingival. Legen Sie fest, ob diese Bereiche abgeschnitten werden sollen (z. B. um ein störungsfreies Aufsetzen auf ein Modell zu ermöglichen) oder so belassen werden sollen.

Ihnen stehen im Schritt *"CEREC Guide editieren"* drei Werkzeuge zur Verfügung, um das Design anzupassen.

Wählen Sie *"Auflagefläche anpassen"*, um die Größe der Schablone zu verändern und um bestimmte Bereiche als Auflagebereich hinzuzufügen oder zu entfernen.

Mit dem Werkzeug *"Supportgeometrie anpassen"* können Sie den Durchmesser der Supportgeometrie ändern oder Schlitze für einen seitlichen Bohrerzugang anlegen.

Mit dem Werkzeug *"Inspektionsfenster"* erzeugen Sie Fenster, um den Sitz der Schablone kontrollieren zu können.

Im Schritt *"Finalisieren"* können Sie das Design der Schablone noch anpassen, indem Sie eventuell störende Bereiche wegschneiden oder lokal Material auf- oder abtragen.

18.3.2 Phase HERSTELLUNG

Damit der Fräsvorgang ohne Unterbrechung abläuft, sorgen Sie gegebenenfalls dafür, dass Fräswerkzeuge mit ausreichender Standzeit eingesetzt sind, der Wasserfilter gereinigt ist und ausreichend Wasser im Tank ist.

Achten Sie nach dem Fräsen darauf, dass beim Reinigen keine Späne in den Tank geraten, da diese den Wasserfilter schnell zusetzen können.

Hinweise für Anwender von CEREC MC X und CEREC MC XL:

Wir empfehlen, das als Ersatzteil erhältliche „Obere Sieb“ (REF 6645886) in die Fräsmaschine einzusetzen.

18.4 Hinweise zur Anwendung

- Sämtliche Materialien, die intraoral eingesetzt werden, müssen vor dem Einsatz desinfiziert und beim Einsatz gegen Aspiration gesichert werden.
- Die Materialien „CEREC Guide Blocs“ und „inCoris PMMA guide disc 22“ (siehe „Materialien“) dienen nur zum Einmalgebrauch und sind nicht steril verpackt, siehe auch Abschnitt „Reinigung, Desinfektion und Sterilisation“ in der Gebrauchsanweisung für CEREC Guide 2.

ACHTUNG

Verformungsgefahr der Bohrschablone

Um eine Verformung der Bohrschablone zu vermeiden, schützen Sie diese vor direkter Sonneneinstrahlung, höheren Temperaturen (> 35°C/95°F) und hoher Luftfeuchte (> 80%). Überprüfen Sie die Bohrschablone vor der OP. Verwenden Sie keine auf Wärme basierenden Methoden zur Desinfektion oder Sterilisation (z. B. Autoklaven). Hierdurch kann sich die Bohrschablone verformen.

Beachten Sie die separate Gebrauchsanweisung für CEREC Guide 2.

19 Herstellung eines CEREC Guide 3

19.1 Optische Abformung

19.1.1 ADMINISTRATION

1. Wählen Sie als Restaurationstyp "*CEREC Guide*" aus.
↳ Das Häkchen "*Prothetische Planung*" ist automatisch gesetzt.
2. Wählen Sie diese Option ab, wenn Sie keinen prothetischen Vorschlag erzeugen möchten. Beachten Sie aber, dass ein Export der Daten ohne prothetische Planung nur im Format *.SIXD möglich ist.
3. Klicken Sie im Zahnschema auf die Zahnposition, für die ein CEREC Guide und ein prothetischer Vorschlag erzeugt werden soll.
4. Wechseln Sie in die Phase AUFNAHME.

19.1.2 AUFNAHME

- > Scannen Sie die Mundsituation entweder intraoral oder vom Modell. Nehmen Sie dabei mindestens alle Bereiche auf, die später als Abstützung für den CEREC Guide verwendet werden sollen. Der Oberflächenscan wird auch zur Überlagerung mit dem Röntgenvolumen verwendet.

ACHTUNG

Beachten Sie, dass die Bohrschablone nicht größer sein kann, als der gescannte Bereich.

Vermeiden Sie Löcher im Scan. An diesen Stellen kann ansonsten keine Auflagefläche für den CEREC Guide bestimmt werden.

19.1.3 DESIGN

Mit Eintritt in die Phase DESIGN wird automatisch eine Basislinie berechnet und darauf ein prothetischer Vorschlag generiert. Zur Anpassung können Sie die Basislinie editieren oder die anderen Werkzeuge zur Bearbeitung für Kronen verwenden.

Im Schritt "*Exportieren/Importieren*" können Sie den Datensatz im Format *.SIXD oder *.SSI exportieren.

Wählen Sie bevorzugt das Datenformat *.SIXD, um auch Textur und Farbe des Scans exportieren zu können als auch keine, einen oder mehrere prothetische Vorschläge. Die Weiterverarbeitung ist nur in Sicat Implant 2.0 oder höher möglich.

Wählen Sie die Option *.SSI nur dann aus, wenn die Implantatplanung in Galileos Implant ausgeführt werden soll oder die Bohrschablone mit inLab SW 20.0 oder kleiner designt und ausgearbeitet werden soll.

19.2 3D-Röntgen und Implantatplanung

Eine DVT-Aufnahme kann vor oder nach der optischen Abformung durchgeführt werden. Achten Sie darauf, dass der Scan keine Metallartefakte enthält. Diese können eine Überlagerung von optischen Daten mit dem Röntgenvolumen erschweren oder unmöglich machen. Scannen Sie den Patienten nicht in Schlussbissstellung sondern mit leicht geöffnetem Kiefer. Entfernen Sie alle abnehmbaren Metallteile im Gegenkiefer (z.B. Prothesen). Nehmen Sie wenn möglich 3/4 eines Kieferbogens auf. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, artefaktfreie Zähne zur Registrierung verwenden zu können.

Zur Implantatplanung in Sicat Implant muss der zuvor erzeugte *.SIXD- oder *.SSI-Datensatz importiert werden. Zur Implantatplanung in Galileos Implant kann ausschließlich *.SSI verwendet werden. Der optische Oberflächenscan wird dem Röntgenvolumen überlagert. Dadurch wird es möglich, die Implantatlage auch unter Berücksichtigung des Weichgewebes und der prothetischen Planung festzulegen.

VORSICHT

Überprüfen Sie, dass die optische Abformung korrekt zum Röntgendatensatz ausgerichtet ist.

Wenn *.SSI als Datenformat verwendet wird und mehrere prothetische Vorschläge berücksichtigt werden sollen, müssen mehrere *.SSI Datensätze importiert werden.

Befolgen Sie zum Planen des Implantats die Anweisungen im Anwenderhandbuch der entsprechenden Software (Sicat Implant oder Galileos Implant).

ACHTUNG

Halten Sie einen Mindestabstand des Implantats zu kritischen anatomischen Strukturen (z. B. Nerv, Wurzeln, Sinus) von mindestens 2mm ein.

Wählen Sie als Bohrschlüsselsystem Sirona - CEREC Guide Drill Keys (CEREC Guide 2, SICAT Surgical Guides) aus. Ihnen stehen dann drei verschiedene Bohrschlüssel zur Auswahl, die den jeweiligen CEREC Guide Drill Keys S, M oder L entsprechen.

Wenn z.B. nur eine Pilotbohrung geführt werden soll, ist die Auswahl der Größe S ausreichend (außer Camlog).

Hinweise zur Verarbeitung in GALILEOS Implant

In GALILEOS Implant können nur *.SSI-Daten importiert werden. Sollen mehrere prothetische Vorschläge berücksichtigt werden, müssen mehrere *.SSI-Datensätze importiert werden. Gehen Sie grundsätzlich nach der Beschreibung aus Anhang C.2 „Pläne exportieren für die Verarbeitung durch Drittanbieter mittels optischer Abdrücke“ vor.

Hinweise zur Verarbeitung in Sicat Implant

Importieren Sie Scandaten bevorzugt im *.SIXD-Format, da hier auch Farbe und mehrere prothetische Vorschläge transferiert werden können. Ein Import im *.SSI-Format ist dennoch möglich. Befolgen Sie

zum Export die Anweisungen in Kapitel 35 des Anwenderhandbuchs für Sicut Implant.

Hinweise zur Verarbeitung in Simplant Pro


In Simplant Pro können nur *.SSI-Daten verarbeitet werden. Sollen mehrere prothetische Vorschläge berücksichtigt werden, müssen mehrere *.SSI-Datensätze erzeugt werden.

Die in der *.SSI-Datei enthaltenen Daten müssen zunächst mit dem Tool CEREC meets Simplant Converter in ein von Simplant Pro lesbares Format umgewandelt werden. Lesen Sie dazu auch die Anleitung dieser Anwendung.

Tiefenstopp

Die Festlegung des Tiefenstopps orientiert sich an der Länge des verwendeten Bohrers. Die geplante Position wird beim Bohren dann erreicht, wenn der mechanische Stopp des Bohrers auf dem Bohrschlüssel aufsetzt oder (wenn der Bohrer keinen Anschlag besitzt) die Längenmarkierung auf dem Bohrer bis zur Oberseite des Bohrschlüssels abgesenkt ist.

Hinweise zur Planung in Galileos Implant und Sicat Implant

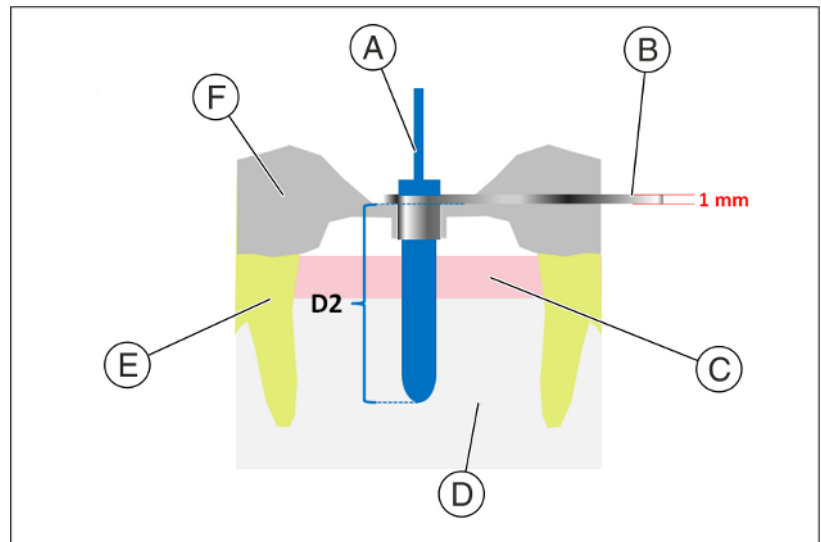

A	Bohrer	D	Knochen
B	CEREC Guide Drill Key	E	Zahn
C	Gingiva	F	CEREC Guide 2

In der Implantatplanungssoftware ist der Tiefenstopp über den D2-Wert einzugeben. Der D2-Wert ist als Abstand der Bohrschablonenoberseite zur apikalen Spitze des Implantats definiert. Da der Bohrer auf dem 1 mm dicken Bohrschlüssel anschlägt, ergibt sich der einzustellende D2-Wert aus der Bohrerlänge abzüglich eines Millimeter ($D2 = \text{Bohrerlänge} - 1 \text{ mm}$).

Die Angabe des D1-Wertes ist zu ignorieren.

Nach Eingabe des D2-Wertes wird die Hülse in der entsprechenden Höhe über dem Implantat visualisiert.

ACHTUNG

Achten Sie bei der Auswahl darauf, dass der Bohrschlüssel nicht mit benachbarten Zähnen kollidiert und auch ein kollisionsfreies Einführen des Bohrschlüssels und des Bohrers möglich ist. Beachten Sie, dass die Auswahl eines kleineren Schlüsseldurchmessers die Verwendung größerer Bohrerdurchmesser limitieren kann. Das Camlog Guided System ist nur mit der Hülse L kompatibel.

Wenn die Darstellung der Schlüsselunterseite den als gelbe Linie dargestellten optischen Scan schneidet, deutet dies darauf hin, dass die Position des Bohrschlüssels mindestens teilweise subgingival liegen wird.

Mehrere Implantate und Bohrschlüsselpositionen werden auf analoge Weise geplant. Der Export ist in einer Datei möglich. Exportieren Sie die Planung als *.CMG.DXD-Datei.

Wählen Sie das Original-Hülsensystem für ihr Implantatsystem aus. Beachten Sie, dass nicht für alle Implantat-Durchmesser eine Hülse verfügbar ist. In diesem Fall können Sie keinen CEREC Guide 3 erstellen.

ACHTUNG

Achten Sie bei der Auswahl darauf, dass die Hülse nicht mit benachbarten Zähnen kollidiert und auch ein kollisionsfreies Einführen des Bohrers möglich ist. Passen Sie Ihre Implantatplanung gegebenenfalls entsprechend an.

Wenn die Darstellung der Hülsenunterseite den als gelbe Linie dargestellten optischen Scan schneidet, deutet dies darauf hin, dass die Position der Hülse mindestens teilweise subgingival liegen wird.

Hinweise zum Export

Wenn Sie den optischen Datensatz im Format *.SIXD importiert haben, können Sie die Planung direkt als *.cmg.dxd Datei exportieren.

Nur dann, wenn Sie den optischen Datensatz im Format *.SSI importiert haben, müssen vor dem Export zusätzlich noch folgende Schritte befolgt werden:

1. Wenn für Implantat und Hülse die gewünschte Position geplant wurde, wechseln Sie auf das Hülsensystem für CEREC Guide 2. An der Implantatposition darf nun nichts mehr geändert werden!
2. Verändern Sie den D1- oder D2-Wert auf einen beliebigen Wert (Es genügt ein Klick auf eine Pfeiltaste zum Einstellen der Hülsenposition).
3. Exportieren Sie die Planung als *.cmg.dxd-Datei.

19.3 Design und Ausarbeitung des CEREC Guide 3

Ihnen stehen zwei Wege zur Verfügung, um die Implantatplanungsdaten zu importieren:

1. Wenn der Fall, wie in Kapitel „Optische Abformung [→ 174]“ beschrieben, auf demselben Gerät angelegt wurde, fahren Sie unmittelbar im Schritt *"Exportieren/Importieren"* fort, indem Sie im Werkzeugfenster auf *"Planungsdaten importieren"* klicken und die *.CMG.DXD-Planungsdatei laden.
2. Wenn Sie auf einem anderen Gerät fortfahren, können Sie die *.CMG.DXD-Planungsdatei über die Auswahl *"Importieren"* im Systemmenü direkt laden.

19.3.1 Phase DESIGN

Die Software CEREC SW 5 erkennt den CEREC Guide 3 automatisch!

WICHTIG

Wenn kein von CEREC Guide 3 unterstütztes Implantat ausgewählt wurde, werden automatisch die Parameter für Hüsendurchmesser (S, M oder L) und D2-Wert aus der Implantatplanung übernommen und es wird ein CEREC Guide 2 erzeugt.

Die Position und Form der Hülse kann nicht mit den allgemeinen Designwerkzeugen verändert werden.

Werden Bereiche oberhalb der Supportgeometrie rot dargestellt, muss die Position des Implantats in der Galileos Implant-Software angepasst werden.

Werden Bereiche unterhalb der Supportgeometrie rot dargestellt, liegen Teile davon subgingival oder es liegt eine Durchdringung mit einem Nachbarzahn vor.

Werden Bereiche unterhalb der Supportgeometrie rot dargestellt, kann der CEREC Guide 3 trotzdem hergestellt werden. Allerdings kollidiert die Bohrschablone an diesen Bereichen mit den Zähnen oder dem Modell. Diese Bereiche müssen dann manuell an der ausgearbeiteten Bohrschablone entfernt werden.

Ihnen stehen im Schritt *"CEREC Guide editieren"* drei Werkzeuge zur Verfügung, um das Design anzupassen.

Wählen Sie *"Auflagefläche anpassen"*, um die Größe der Schablone zu verändern und um bestimmte Bereiche als Auflagebereich hinzuzufügen oder zu entfernen.

Mit dem Werkzeug *"Supportgeometrie anpassen"* können Sie den Durchmesser der Supportgeometrie ändern oder Schlitz für einen seitlichen Bohrerzugang anlegen.

Mit dem Werkzeug *"Inspektionsfenster"* erzeugen Sie Fenster, um den Sitz der Schablone kontrollieren zu können.

Im Schritt *"Finalisieren"* können Sie das Design der Schablone noch anpassen, indem Sie eventuell störende Bereiche wegschneiden oder lokal Material auf- oder abtragen.

19.3.2 Phase HERSTELLUNG

Damit der Fräsvorgang ohne Unterbrechung abläuft, sorgen Sie gegebenenfalls dafür, dass Fräswerkzeuge mit ausreichender Standzeit eingesetzt sind, der Wasserfilter gereinigt ist und ausreichend Wasser im Tank ist.

Achten Sie nach dem Fräsen darauf, dass beim Reinigen keine Späne in den Tank geraten, da diese den Wasserfilter schnell zusetzen können.

Hinweise für Anwender von CEREC MC X und CEREC MC XL:

Wir empfehlen, das als Ersatzteil erhältliche „Obere Sieb“ (REF 6645886) in die Fräsmaschine einzusetzen.

19.3.3 Nachbearbeitung

Nach Beendigung des Schleif-/Fräsprozesses muss die Restauration mit einem Diamantschleifinstrument abgetrennt werden.

Entfernen Sie Grate und verrunden Sie spitze Ecken am Schablonenkörper.

VORSICHT

Gesundheitsschädigung durch Schleifstäube

Das Einatmen der Schleifstäube kann gesundheitsschädlich sein.

- > Achten Sie darauf, dass Sie die Schleifstäube nicht einatmen.
- > Arbeiten Sie mit einer Absauganlage und tragen Sie einen Mundschutz.

Die verbleibenden Blockreste und der Blockhalter müssen nicht gesondert entsorgt werden. Sie können im normalen Hausmüll entsorgt werden.

19.4 Hülsen einkleben

Verwendung von Calibra® Universal Self-Adhesive Resin Cement zur extraoralen Zementierung von Guide Sleeves in das Bohrloch des Schablonenkörpers von CEREC Guide 3:

- ✓ Der Bohrschablonenkörper und die Hülse müssen sauber und trocken sein. Hülse mit Ethanol reinigen.
- 1. Stecken Sie die Hülse auf den beiliegenden Haltestift.
- 2. Bereiten Sie die Calibra® Universal-Spritze entsprechend der Gebrauchsanweisung vor und verwenden Sie sie.
- 3. Sofort mit leichtem Druck eine dünne, gleichmäßige Zementschicht direkt von der Mischspitze in die zirkulär verlaufende Vertiefung der Hülse auftragen. Calibra® Universal Cement bietet bei Raumtemperatur eine minimale Arbeitszeit von 2 Minuten.
- 4. Drücken Sie die Hülse mit Haltestift sofort in die Bohrung im Bohrschablonenkörper.
- 5. Überprüfen Sie den richtigen Sitz der Hülse mit einer Lupe oder einem Mikroskop.
- 6. Entfernen Sie überschüssigen Zement. Überschüssiger Zement erreicht den „gelierten“ Zustand nach etwa 2-3 Minuten bei Raumtemperatur oder nach einer kurzen Exposition mit einem Polymerisationslicht, was eine leichte Entfernung ermöglicht. Wenn es einem gerichteten Operationslicht ausgesetzt wird, kann der „Gel“-Zustand früher erreicht werden und für eine kürzere Zeit „geliert“ bleiben.

WICHTIG

Der Zement ist noch nicht ausgehärtet. Bewegen Sie die Hülse nicht, während die Zementüberschüsse entfernt werden. Nach Entfernung der Überschüsse kann der Zement 20 bis 40 Sekunden lichtgehärtet werden, um die Stabilisierung der Hülse zu unterstützen.

- 7. Lassen Sie Calibra® Universal Cement nach der Stabilisierung 10 Minuten aushärten. Schützen Sie Hülse und Schablonenkörper während der Aushärtung vor Kontamination und Bewegung.
- 8. Entfernen Sie nach der Aushärtung den Haltestift vorsichtig.

19.5 Hinweise zur Lagerung

ACHTUNG

Verformungsgefahr der Bohrschablone

Um eine Verformung der Bohrschablone zu vermeiden, schützen Sie diese vor direkter Sonneneinstrahlung, höheren Temperaturen (> 35°C/95°F) und hoher Luftfeuchte (> 80%). Überprüfen Sie die Bohrschablone vor der OP. Verwenden Sie keine auf Wärme basierenden Methoden zur Desinfektion oder Sterilisation (z. B. Autoklaven). Hierdurch kann sich die Bohrschablone verformen.

Beachten Sie die separate Gebrauchsanweisung für CEREC Guide 3.

Stichwortverzeichnis

A

- Artikulation, 105
 - Bezugsebene, 105
- Artikulator
 - Artikulatorparameter, 105
 - FGP, 106

B

- Bewegen
 - Drehen, 87
 - Verschieben, 87
- Bildschirm, 18
- Biogenerische Morphologie, 84
- Boden einblenden, 94
- Bukkale Registrierung
 - Aufnahme drehen, 74
 - Aufnahme korrigieren, 74

C

- CE-Kennzeichen, 11

D

- Dentsply Sirona Produktservice, 9
- Design-Modus
 - Anatomic, 71
 - Biogenerik individuell, 71
 - Biogenerik-Kopie, 71
 - Intersection, 71
 - Kopieren & Spiegeln, 71
- Drehen
 - Bukkale Aufnahme, 132
 - Unterkiefer und Oberkiefer, 131

F

- Fall
 - importieren, 61
- Farbschema, 93

Formen

- Glätten, 75
- Größe verändern, 76
- Material abtragen, 75
- Material auftragen, 75

G

- Gestalten
 - Anatomisch, 83
 - Größe, 83
 - Manuell, 83

H

- Herstelleranschrift, 9

K

- Konformitätserklärung, 11
- Kontakte, 86
- Kontaktflächen
 - Restauration, 93
 - Virtuelles Modell, 93
- Kontaktflächen zurücksetzen, 86
- Kundendienst, 9

M

- Multi-Touch, 18
 - 3D-Modell bearbeiten, 18, 21
 - 3D-Modell drehen, 18, 21
 - 3D-Modell vergrößern, 18, 21
 - 3D-Modell verkleinern, 18, 21
- Navigation, 18

O

- Objekte anzeigen
 - BioKopie OK, 91
 - BioKopie UK, 91
 - Getrimmtes Modell, 91
 - Gingivamaske OK, 91
 - Gingivamaske UK, 92
 - Implantat, 92

Mindeststärke, 91
Oberkiefer, 91
Restauration, 91
Transparenz, 91
Unterkiefer, 91

P

Pfeiltasten, 27
Phase
 MODELL, 130
Positionieren
 Drehen, 81
 Skalieren, 82
 Verschieben, 81
Präparationsrand eingeben
 Automatisch, 80
 Manuell, 80
Produktsicherheit, 14

R

Restauration
 Distanz messen, 96
 Dynamik, 105
 exportieren, 62
 Höhe und Dicke anzeigen, 96
 Schnitt, 95
 speichern, 61
 Speichern unter, 61
Restauration in Modellfarbe darstellen, 94
Restaurationstyp
 Brücken-Restauration, 69
 Einzelzahn-Restauration, 68
 Fehlt, 68, 69
 Inlay/Onlay, 68, 69
 Krone, 68, 69
 Pontic, 69
 Veneer, 68, 69
 Verbinder, 69

S

Scanner
 Aufwärmzeit, 109
Schnitt
 Modellbereich umkehren, 77
Schrittmenu, 27
Seiteflächen einblenden, 94
Sicherheitshinweise, 16
Smile Design, 102
 Auflösung, 102
 Formate, 102
 Referenzbild, 102
Software
 Deinstallation, 30

T

Trimmen
 Auswahl umkehren, 79

W

Werkzeug
 Abstichstelle, 86
 Bewegen, 87
 Biogenerische Variation, 84
 Bukkale Registrierung, 74
 Ersetzen, 78
 Formen, 75
 Gestalten, 83
 Kontakte, 86
 Modell zurücksetzen, 78
 Positionieren, 81
 Präparationsrand eingeben, 80
 Schnitt, 77
 Trimmen, 79
 Verbinder anpassen, 88
Werkzeuge, 72
Werkzeug-Rad, 26, 73

Z

Zahnschema

ADA, 19

FDI, 19

Änderungen im Zuge technischer Weiterentwicklung vorbehalten.

© SIRONA Dental Systems GmbH
D3700.208.01.08F1.01 2024-08

Sprache: deutsch
Ä.-Nr.: 135 652

Printed in Germany
Imprimé en Allemagne

SIRONA Dental Systems GmbH



Fabrikstraße 31
64625 Bensheim
Germany
www.dentsplysirona.com

Bestell-Nr. **66 85 288 D3700**